

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO 053/2024

A empresa, B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, estabelecida à AV: Marechal Mascarenhas de Moraes nº. 88, sala 4, nesta cidade de Araçatuba, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ. nº 52.496.119/0001-09 e Inscrição Estadual nº 177.614.741.116, por intermédio de seu representante legal/procurador o Sr. **Marcos Ribeiro Junior**, portador da Carteira de Identidade 27.601.292-6 SSP/SP e do CPF nº. 226.722.708-80, tem os seguintes custos para formação do preço do material abaixo discriminado, de forma a reiterar a exequibilidade da proposta de preços:

ITEM	8 e 131
DESCRIÇÃO	BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL; MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL, CAPACIDADE DE PESAGEM: DE 200KG, MATERIAL DE CONFECÇÃO: ESTRUTURA EM AÇO PESO LÍQUIDO BALANÇA: 6K, GDISPLAY INTEGRADO: POSSUI TARA: POSSUI
MARCA	LIDER
PREÇO CUSTO	R\$ 430,00
IMPOSTOS	R\$ 144,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 120,00
FRETE (R\$)	R\$ 150,00
MARGEM LÍQUIDA	R\$ 356,00
PREÇO VENDA	R\$ 1.200,00

Declaro, sob as penas da lei, que os preços cotados não são inexequíveis e que serão cumpridos conforme prever o Edital e seus anexos.

Declaro ainda que nos preços cotados estão incluídos todas as despesas, tributos e encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste Pregão.

Araçatuba, (SP), 26 de Novembro de 2024.

B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
MARCOS RIBEIRO JÚNIOR
CARGO: PROCURADOR/REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 226.722.708-80 RG: 27.601.292-6

MARCOS
RIBEIRO
JUNIOR:
2267227
0880

Assinado de
forma digital
por MARCOS
RIBEIRO
JUNIOR:226722
70880
Dados:
2024.11.26
12:05:37 -03'00'

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO 053/2024

A empresa, B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, estabelecida à AV: Marechal Mascarenhas de Moraes nº. 88, sala 4, nesta cidade de Araçatuba, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ. nº 52.496.119/0001-09 e Inscrição Estadual nº 177.614.741.116, por intermédio de seu representante legal/procurador o Sr. **Marcos Ribeiro Junior**, portador da Carteira de Identidade 27.601.292-6 SSP/SP e do CPF nº. 226.722.708-80, tem os seguintes custos para formação do preço do material abaixo discriminado, de forma a reiterar a exequibilidade da proposta de preços:

ITEM	49
DESCRIÇÃO	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL; EQUIPAMENTO EM AÇO PARA PESAGEM PROJETADO ESPECIFICAMENTE PARA MEDIR O PESO DE BEBÊS E CRIANÇAS PEQUENAS COM MEDIDOR DE ALTURA
MARCA	LIDER
PREÇO CUSTO	R\$ 390,00
IMPOSTOS	R\$ 93,60
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 75,00
FRETE (R\$)	R\$ 120,00
MARGEM LIQUIDA	R\$ 101,40
PREÇO VENDA	R\$ 780,00

Declaro, sob as penas da lei, que os preços cotados não são inexequíveis e que serão cumpridos conforme prever o Edital e seus anexos.

Declaro ainda que nos preços cotados estão incluídos todas as despesas, tributos e encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste Pregão.

Araçatuba, (SP), 26 de Novembro de 2024.


B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
MARCOS RIBEIRO JÚNIOR
CARGO: PROCURADOR/REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 226.722.708-80 RG: 27.601.292-6

MARCOS
RIBEIRO
JUNIOR: 2267227
0880
Assinado de
forma digital
por MARCOS
RIBEIRO
JUNIOR: 226722
70880
Dados:
2024.11.26
12:03:58 -03'00'

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO 053/2024

A empresa, B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, estabelecida à AV: Marechal Mascarenhas de Moraes nº. 88, sala 4, nesta cidade de Araçatuba, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ. nº 52.496.119/0001-09 e Inscrição Estadual nº 177.614.741.116, por intermédio de seu representante legal/procurador o Sr. **Marcos Ribeiro Junior**, portador da Carteira de Identidade 27.601.292-6 SSP/SP e do CPF nº. 226.722.708-80, tem os seguintes custos para formação do preço do material abaixo discriminado, de forma a reiterar a exequibilidade da proposta de preços:

ITEM	50
DESCRIÇÃO	BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL; MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL, CAPACIDADE DE PESAGEM: DE 200KG, MATERIAL DE CONFECÇÃO: ESTRUTURA EM AÇO PESO LÍQUIDO BALANÇA: 6K, GDISPLAY INTEGRADO: POSSUI TARA: POSSUI
MARCA	LIDER
PREÇO CUSTO	R\$ 430,00
IMPOSTOS	R\$ 168,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 140,00
FRETE (R\$)	R\$ 150,00
MARGEM LÍQUIDA	R\$ 512,00
PREÇO VENDA	R\$ 1.400,00

Declaro, sob as penas da lei, que os preços cotados não são inexequíveis e que serão cumpridos conforme prever o Edital e seus anexos.

Declaro ainda que nos preços cotados estão incluídos todas as despesas, tributos e encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste Pregão.

Araçatuba, (SP), 26 de Novembro de 2024.

B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
MARCOS RIBEIRO JÚNIOR
CARGO: PROCURADOR/REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 226.722.708-80 RG: 27.601.292-6

MARCOS
RIBEIRO
JUNIOR:2
26722708
80

Assinado de
forma digital por
MARCOS RIBEIRO
JUNIOR:2267227
0880
Dados:
2024.11.26
12:07:03 -03'00'

COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

PREGÃO ELETRÔNICO 053/2024

A empresa, B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, estabelecida à AV: Marechal Mascarenhas de Moraes nº. 88, sala 4, nesta cidade de Araçatuba, estado de São Paulo, inscrita no CNPJ. nº 52.496.119/0001-09 e Inscrição Estadual nº 177.614.741.116, por intermédio de seu representante legal/procurador o Sr. **Marcos Ribeiro Junior**, portador da Carteira de Identidade 27.601.292-6 SSP/SP e do CPF nº. 226.722.708-80, tem os seguintes custos para formação do preço do material abaixo discriminado, de forma a reiterar a exequibilidade da proposta de preços:

ITEM	94
DESCRIÇÃO	BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL; MODO DE OPERAÇÃO: DIGITAL, CAPACIDADE DE PESAGEM: DE 200KG, MATERIAL DE CONFEÇÃO: ESTRUTURA EM AÇO PESO LÍQUIDO BALANÇA: 6K, DISPLAY INTEGRADO: POSSUI TARA: POSSUI
MARCA	LIDER
PREÇO CUSTO	R\$ 430,00
IMPOSTOS	R\$ 156,00
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 130,00
FRETE (R\$)	R\$ 150,00
MARGEM LIQUIDA	R\$ 434,00
PREÇO VENDA	R\$ 1.300,00

Declaro, sob as penas da lei, que os preços cotados não são inexequíveis e que serão cumpridos conforme prever o Edital e seus anexos.

Declaro ainda que nos preços cotados estão incluídos todas as despesas, tributos e encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto deste Pregão.

Araçatuba, (SP), 26 de Novembro de 2024.

B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA
MARCOS RIBEIRO JÚNIOR
CARGO: PROCURADOR/REPRESENTANTE LEGAL
CPF: 226.722.708-80 RG: 27.601.292-6

MARCOS
RIBEIRO
JUNIOR:
2267227
0880

Assinado de
forma digital
por MARCOS
RIBEIRO
JUNIOR:226722
70880
Dados:
2024.11.26
12:09:45 -03'00'

IDENTIFICACAO DO EMITENTE MARCOS RIBEIRO E CIA. LTDA. RUA Jorge Mellem Rezek, no 3411, , Parque Industrial, 16075-300 ARACATUBA, SP Fone: (18) 2102-5500		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0-ENTRADA 1-SAIDA 1 No: 000.075.537 SERIE: 001 FOLHA: 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3524 1046 6861 1900 0160 5500 1000 0755 3715 3817 2901 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DA OPERACAO REMESSA DE MERCADORIA OU BEM PARA DEMONSTRACAO				PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135242254695892 08/10/2024 09:39:03										
INSCRICAO ESTADUAL 177139644117		INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ 46.686.119/0001-60										
DESTINATARIO / REMETENTE														
NOME / RAZAO SOCIAL B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA				CNPJ / CPF 52.496.119/0001-09										
ENDERECO RUA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, no 88, SALA 4				DT. DA EMISSAO 08/10/2024										
Bairro / Distrito PARQUE INDUSTRIAL		CEP 16075-370		DT. DA SAIDA 08/10/2024										
MUNICIPIO ARACATUBA		UF SP		HORA DA SAIDA 09:47:00										
FONE / FAX (18) 2102-5500		INSCR. ESTADUAL 177614741116												
FATURA / DUPLICATA														
CALCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 820,00										
BASE DE CALC. DO ICMS S.T. 0,00		VALOR DO ICMS S.T. 0,00												
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 53,30										
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESP. ACESSORIAS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 873,30										
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZAO SOCIAL		FRETE/CONTA 1-Destinatario		CNPJ / CPF										
ENDERECO		MUNICIPIO		INSCRICAO ESTADUAL										
QUANTIDADE 2		ESPECIE CX		PESO LIQUIDO 12,000										
MARCA		NUMERACAO 0		PESO BRUTO 12,000										
DADOS DOS PRODUTOS / SERVICOS														
COD.	DESCR.PRODUTO/SERVICO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QD	VR.UNIT.	VR.TOTAL	BS.ICMS	VR.ICMS	IPI	%ICMS	%IPI	TRIB.
2306.4	BALANCA ELETRONICA, MARCA LIDER, MOD. LD230 BABY CAP. 15 KG DIV. 5 G PLASTICO ABS DISPLAY CRISTAL LIQUIDO NUMERO DE SERIE 136892.	84231000	050	5912	UN	1,00	390,00	390,00	0,00	0,00	25,35	0,00	6,50	143,52
013.12	BALANCA ELETRONICA, MARCA LIDER, MOD. P-200M CAP. 200 KG DIV. 100 G ACO CARBONO 0,28 x 0,32 M DISPLAY CRISTAL LIQUIDO NUMERO DE SERIE 131150.	84231000	050	5912	UN	1,00	430,00	430,00	0,00	0,00	27,95	0,00	6,50	158,24
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO								
ICMS: Suspensao de acordo com o art. 319 do RICMS/2000. Emitida nos termos do Art. 320 do RICMS/2000. Ajuste SINIEF 02/2018, Devendo retornar no prazo de ate 30 dias, sob pena de o nao recebimento no prazo legal gerar imediato faturamento. Orgao Publico: Retencao na forma da Instrucao Normativa RFB n 1.234, de 11 de janeiro de 2012 alterada pela Instrucao Normativa (IN) n 2145 de 2023**CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES, NA DUVIDA CONTATE ANTES DO ACEITE.** COND.DE PAGAMENTO A PRAZO: BOLETO BANCARIO ANEXADO A ESTA NOTA FISCAL. NAO AUTORIZADO PAGAMENTO VIA DEPOSITO/TRANSFERENCIA BANCARIA SEM AUTORIZACAO DO FINANCEIRO@LIDERBALANCAS.COM.BR														
RECEBEMOS DE MARCOS RIBEIRO E CIA. LTDA. OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA AO LADO. EMISSAO: 08/10/2024 VALOR TOTAL: 873,30 DESTINATARIO: B. D. R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA - RUA MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 88, PARQUE INDUSTRIAL, ARACATUBA, SP						NF-e No: 000.075.537 SERIE: 001								
Data de Recebimento		Identificacao e Assinatura do Recebedor												

RECEBEMOS DE B.D.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		CCL FLS. 455 NF-e Nº. 000000003 SÉRIE 1											
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
B.D.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA R MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES 88 SALA 4 PARQUE INDUSTRIAL ARACATUBA - SP CEP: 16075-370 FONE/FAX: ()		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº. 000000003 SÉRIE 1 FOLHA 1 DE 1											
													
		CHAVE DE ACESSO 3524 1052 4961 1900 0109 5500 1000 0000 0310 0000 2628											
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora											
NATUREZA DA OPERAÇÃO REMESSA DE MERCADORIA OU BEM PARA DEMONSTRACAO - FORA SP		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242255196360 08/10/2024 10:15:25											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 177614741116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 52.496.119/0001-09										
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL HOSPITAL DE CLINICAS DE PORTO ALEGRE		CNPJ / CPF 87.020.517/0001-20	DATA EMISSÃO 08/10/2024										
ENDEREÇO RAMIRO BARCELOS 2350	BAIRRO / DISTRITO BOM FIM	CEP 90035-003	DATA ENTRADA/SAÍDA 08/10/2024										
MUNICÍPIO PORTO ALEGRE	FONE / FAX 5133316699	UF RS	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA 10:15:15										
FATURA / DUPLICATAS Número Vencimento Valor													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.800,00									
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.800,00								
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS SA		FRETE POR CONTA Emitente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF CNPJ / CPF 80.227.796/0067-85								
ENDEREÇO CAMBAI 104 LOTE 05 QUADRAG		MUNICÍPIO SUMARE	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 671.579.336.114									
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 12,000	PESO LIQUIDO 12,000								
DADOS DOS PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
36P	BALANCA ELETRONICA MARCA LIDER M OD P-200M ACO CARBONO CAP. 200 KG DIV. 100 G ACO CARBONO 0, 28 X 0,32 M DISPLAY CRISTAL LIQUIDO - NUMERO DE SERIE 131150.	84231000	0400	6912	UN	1,0000	1.000,0000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
426P	BALANCA ELETRONICA, MARCA LIDER, MOD. LD230 BABY BALANCA ELETRONICA, MARCA LIDER, MOD. LD230 BABY - NUMERO DE SERIE 136892.	84231000	0400	6912	UN	1,0000	800,000000	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CALCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Fisco: LOCAL DE ENTREGA RUA SAO MANOEAL 603 SERVICIO DE PATRIMONIO - FUNDOS HCPA RIO BRA NCO PORTO ALEGRE/RS CEP: Inf. Complementar: **CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO. NAO ACEITAMOS RECLAMACOES POSTERIORES, NA DUVIDA CONTATE ANTES DO ACEITE.** DOCUMENTO EMITIDO PO R EMPRESA ME/EPP OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL. DECLARACAO DE OPTANTE DO SIMPLES NACIONAL ANEXA . NOTA FISCAL NAO SUJEITA A RETENCAO . NAO GERA DIREITO A CREDITO DE ICMS/IPI. AMOSTRA REFERE NTE AO PREGAO ELETRONICO 0701/24 CODIGO CLIENTE: 48323								RESERVADO AO FISCO					

FLS. 756

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI EST SAO JUDAS, 325 ESPLANADA EMBU DAS ARTES - SP - 06817-170 Telefone: (11) 4781-8001 - Email: contato@mikatos.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 000.062.041 SÉRIE 0 FOLHA 01/01		 CHAVE DE ACESSO 3524 1005 0305 0100 0134 5500 0000 0620 4116 9410 4198 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135242331913643 16/10/2024 10:53:01										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 298140270110		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ/CPF 05.030.501/0001-34										
DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF 39.346.590/0001-44										
NOME/RAZÃO SOCIAL KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA				DATA DA EMISSÃO 16/10/2024										
ENDEREÇO R DA LUZ, 51 - *****		BAIRRO/DISTRITO JARDIM MORUMBI		CEP 86191-770										
MUNICÍPIO CAMBE		UF PR		FONE/FAX (43) 9954-6831										
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9086460537		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		HORA DA SAÍDA 10:52:44										
INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA				CNPJ/CPF 39.346.590/0001-44										
NOME/RAZÃO SOCIAL				INSCRIÇÃO ESTADUAL 9086460537										
ENDEREÇO R DA LUZ, 51		BAIRRO/DISTRITO JARDIM MORUMBI		CEP 86191-770										
MUNICÍPIO CAMBE		UF PR		FONE/FAX (43) 9954-6831										
FATURA/DUPLICATA														
NÚMERO		VENCIMENTO		VALOR										
0/62041-001		18/11/2024		799,60										
NÚMERO		VENCIMENTO		VALOR										
0/62041-002		02/12/2024		799,71										
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS ST										
1.520,26		182,43		0,00										
VALOR DO PIS		VALOR DO ICMS ST		VALOR DO PIS										
9,88		0,00		9,88										
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO COFINS										
41,16		0,00		45,61										
DESCONTO		OUTRAS DESP. ACES.		VALOR TOTAL DO IPI										
0,00		0,00		79,05										
VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS										
1.599,31		79,05		1.479,10										
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME/RAZÃO SOCIAL CORREIO SEDEX PAGO		FRETE POR CONTA 1-Destinatario-FOB		CÓDIGO ANTT										
ENDEREÇO R CERQUEIRA CESAR,217		MUNICÍPIO EMBU DAS ARTES		PLACA DO VEÍCULO										
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE VOLUME		UF SP										
MARCA MIKATOS		NÚMERO		INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO										
PESO BRUTO 2,520		PESO LÍQUIDO 2,520												
DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
2709	OTOSCOPIO MISSOURI C/5 ESPECULOS 001	90189099	000	6101	un	5,0000	291,82	1.459,10	1.499,70	179,96	0,00	77,98	12,00	5,20
2047	LANTERNA CLINICA MIKATOS (PRATA) 022PPR	90189099	000	6101	un	1,0000	20,00	20,00	20,56	2,47	0,00	1,07	12,00	5,20
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO								
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES														
RECEBEMOS DE MIKATOS INDUSTRIA COMERCIO SERVICOS E IMPORTACAO EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES NA NF-E INDICADA AO LADO. EMISSION: 16/10/2024 VALOR TOTAL: R\$ 1.599,31 DESTINATÁRIO: KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA - R DA LUZ, 51 - JARDIM MORUMBI, CAMBE - PR						NF-e Nº 000.062.041 SÉRIE 0								
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR				CONTROLE INTERNO								

RECEBEMOS DE 53.077.195 LUANA BARBOSA PENCI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.002.422 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 53.077.195 LUANA BARBOSA PENCI Rua Parazinho, 120, Nao consta - Jardim Modelo, Sao Paulo, SP - CEP: 02261000 Fone: 00000000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.002.422 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	
	CHAVE DE ACESSO 3524 0353 0771 9500 0134 5500 2000 0024 2215 3305 9625	
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240586858 19/03/2024 14:55:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 132532746115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 53.077.195/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J. / C.P.F. 39.346.590/0001-44	DATA DA EMISSÃO 19/03/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA		CEP 86191770	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 19/03/2024
ENDEREÇO Rua da Luz, 51 - Referencia: HORARIO DE ENTREGA : 8:30 AS		BAIRRO/DISTRITO Jardim Morumbi	HORA DE SAÍDA 14:53:55
MUNICÍPIO Cambe	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9086460537

FATURA/DUPPLICATA			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 395,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 395,60

TRANSPORTADOR/VOLUME		FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA		MUNICÍPIO OSASCO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116	
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003		PESO BRUTO 0,180		PESO LÍQUIDO 0,180		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO			

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA		C.N.P.J. / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME/RAZÃO SOCIAL			
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE/FAX


DOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
Doppler Azul	Doppler Fetal Monitoramento Portatil Batimentos Coracao Bebe	90181980	7102	6106	UN	4	98,90	395,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		

DADOS ADICIONAIS Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereco: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 2421, emitida em 19/03/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$113,58. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.	RESERVADO AO FISCO
---	---------------------------

Plano de Pagto: ORCAMENTO	Prazo de Entrega : 05/12/2024	Horas:	Valor dos Itens	3.700,00
	Validade : 09/12/2024		Desconto	
Entrada :			Acres. Financeiro	
Parcelas : x	Vendedor: INES		T O T A L	3.700,00

DYNAMIC MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
CNPJ: 02.770.479/0001-70
RUA DA PIÇARREIRA N 30 BAIRRO FUMO VERDE
CAXIAS - MA | CEP: 65.602-080
+ [55] 99 9 82722663



À
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS / MA
PE SRP Nº 053/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 03208/2024
OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE PARA UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE SAÚDE DE CAXIAS - MA.

A EMPRESA **DYNAMIC MED - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**, INSCRITA NO CNPJ Nº 02.770.479/0001-70, POR INTERMÉDIO DE SEU REPRESENTANTE LEGAL O **SR ACACIO BARBOSA MOURA**, PORTADOR DA CARTEIRA DE IDENTIDADE 0637300282017-0, EXPEDIDA PELA SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANÇA PÚBLICA DO MARANHÃO, INSCRITO NO CPF SOB O N.º 125.087.053-49 VEM MUITO RESPEITOSAMENTE SUBMETER À APRECIÇÃO DE VOSSA SENHORIA:

PEDIDO DE DESISTÊNCIA DE ITENS ARREMATADOS **(ITENS 12, 111, 113 E 134)**

PREZADO SENHOR PREGOEIRO,

VENHO, POR MEIO DESTES, FORMALIZAR O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DOS SEGUINTE ITENS ARREMATADOS NO PROCESSO LICITATÓRIO EM REFERÊNCIA:

- **ITEM 12, 134** – CARRO MACA SIMPLES (MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO INOXIDÁVEL OU ALUMÍNIO, COM GRADES LATERAIS).
- **ITEM 111** - ESTETOSCÓPIO ADULTO - APARELHO PORTÁTIL PARA AUSCULTAÇÃO DE SONS CARDÍACOS E PULMONARES DE PACIENTES, MATERIAL DE CONFECÇÃO DO AUSCULTADOR AÇO INOXIDÁVEL | TIPO [TECNOLOGIA:] DUPLO !DIGITAL
- **ITEM 113** - ESTANTE (MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO/FERRO PINTADO, CAPACIDADE DAS PRATELEIRAS/REFORÇO: DE 101 A 200 KG/POSSUI).

APÓS ANÁLISE DETALHADA, CONSTATOU-SE QUE O PREÇO OFERTADO NÃO CORRESPONDE AO VALOR COMERCIAL DO PRODUTO, CONFORME ESPECIFICADO NA DESCRIÇÃO DO EDITAL, O QUE INVIABILIZA O CUMPRIMENTO ADEQUADO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL.

COM O OBJETIVO DE ZELAR PELA CELERIDADE E O BOM ANDAMENTO PROCESSUAL DA LICITAÇÃO, APRESENTO, DESDE JÁ, MINHAS SINCERAS DESCULPAS POR QUALQUER TRANSTORNO CAUSADO. REAFIRMO MEU COMPROMISSO COM A INTEGRIDADE E TRANSPARÊNCIA DOS ATOS ADMINISTRATIVOS E COLOCO-ME À DISPOSIÇÃO PARA EVENTUAIS ESCLARECIMENTOS.

ATENCIOSAMENTE,

Caxias (MA), 16 de Dezembro de 2024

DYNAMIC MED
DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS HOSPITALARES
PROD:02770479000170

Assinado digitalmente por DYNAMIC
MED DISTRIBUIDORA DE
MEDICAMENTOS E
PRODUTOS HOSPITALARES
DN: cn=DYNAMIC MED
E PRODU:02770479000170, c=BR,
o=CPF-Brasil, ou=videoconferencia,
email=DYNAMICMED.ADM@GMAIL.COM
Data: 2024.12.16 12:45:22 -03'00'

DYNAMIC MED
CNPJ: 02.770.479/0001-70
Acácio Barbosa Moura
CPF: 125.087.053-49 | RG: 0637300282017-0 SSP | MA
Socio Administrador

dynamicmed.adm@gmail.com

@dynamic.med



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03208/2024

CAD. ICMS:90808293-10
ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA
RUA GRAÇA ARANHA, 875 - BRÇÃO 02 - SALA A
VARGEM GRANDE - CEP 83321-020
PINHAIS - PR



DEMONSTRAÇÃO DE CUSTOS

A empresa Asclépios Equipamentos Hospitalares Eireli, inscrita no CNPJ sob nº 33.068.320-0001-32, com sede na Rua Graça Aranha, nº 875, Brção 2, Sala A, Bairro Vargem Grande, Pinhais/PR, CEP 83.321-020, vem por meio desta apresentar a composição dos custos que compõem a proposta de preços:

Item	Produto	Frete	Impostos	Valor unitário	Valor total do item
20	Esfigmomanômetro Adulto	Varia de acordo com as medidas e peso.	22%	R\$80,00	R\$240,00
65	Esfigmomanômetro Adulto	Varia de acordo com as medidas e peso.	22%	R\$80,00	R\$240,00
67	Esfigmomanômetro Adulto grande	Varia de acordo com as medidas e peso.	22%	R\$95,00	R\$190,00
107	Esfigmomanômetro Adulto	Varia de acordo com as medidas e peso.	22%	R\$82,50	R\$165,00
110	Estetoscópio	Varia de acordo com as medidas e peso.	22%	R\$21,14	R\$42,28



ASCLÉPIOS
Equipamentos Hospitalares

CAD. ICMS:90808293-10
ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA
RUA GRAÇA ARANHA, 875 - BRCÃO 02 - SALA A
VARGEM GRANDE - CEP 83321-020
PINHAIS - PR

CCF
FLS. 762

140	Eletrocardiógrafo	Varia de acordo com as medidas e peso.	22%	R\$4.200,00	R\$4200,00
-----	-------------------	--	-----	-------------	------------

O valor do frete sofre variação de acordo com o pedido da instituição, devido a este ser cobrado sobre o tamanho da embalagem e sobre o seu peso, para assim, termos o valor de frete. Assim, nos valores ofertados estão inclusos todos os custos para o fornecimento dos itens, tais como: tributos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais, embalagens, fretes e lucro.

Pinhais, 13 de dezembro de 2024.

Patricia
Bach:03130961984

Assinado de forma digital por
Patricia Bach:03130961984
Dados: 2024.12.13 11:32:01
-03'00'

RECEBEMOS DE ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 4.656

SÉRIE

63



ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

R: Graça Aranha, 875 BRCAO 02 Sala A

Vargem Grande

Pinhais PR

83321-020

(41) 3699-4237

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 4.656

SÉRIE 1

Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4124 1233 0683 2000 0132 5500 1000 0046 5617 4287 9105

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribuir

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240382601185

11/12/24 07:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9080829318

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

33.068.320/0001-32

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE PIRACAIA

ENDEREÇO

AV DR CANDIDO RODRIGUES 120

MUNICÍPIO

Piracaia

FONE/FAX

(11) 4036-2020

U.F.

SP

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

C.N.P.J.

45.279.627/0001-61

INSCRIÇÃO ESTADUAL

12970-000

DATA DA EMISSÃO

11/12/2024

DATA DA SAÍDA/ENTRA

HORA DA SAÍDA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
56/1	10/01/25	400,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
400,00	16,00	0,00	0,00	0,00	400,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

NOME/RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEIC.

U.F.

C.N.P.J./C.P.F.

34.028.316/0020-76

ENDEREÇO

R JOAO NEGRAO 1251

MUNICÍPIO

Curitiba / PR

U.F.

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1,00

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

2

PESO LÍQUIDO

2

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
51	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO PREMIUM	9018.90.69	200	6.108	PC	5,00	80,00	400,00	400,00	16,00	0,00	4,00	0,00
	Lote: 392301 x5												

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

:: Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino:56,00 :: Valor aproximado dos tributos R\$ (0.00%) Fonte: IBPT :: Valor do IRRF: R\$ 4,80 - Aliquota 1.2% :: Pedido:2937 :: OC:1340/24 :: End de Entrega:DEP. DE SAUD, RUA JAN ANTONIN BATA, 06, CENTRO, PIRACAIA/SP, HORARIO DAS 08H AS 12H E DAS 13H30 AS 16H, FONE:(11) 4036-2720. :: Nota de Empenho:PEDIDO 1340/24, PE 28/2024, PROCESSO 879/24, SOLICITACAO 1328/24, RESERVA 2202. | BANCO BRASIL AG: 1622-5, C/C: 20.327-0 | CEF AG: 1630 OP. 003, C/C 3128-6 | BRADESCO AG: 1205, C/C: 14344-8 | SANTANDER AG: 1258 C/C: 130033035 | PIX: CNPJ 33.068.320/0001-32

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 4.645
CERTE 164
FLS.

ASCLEPIOS
EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA



R: Graça Aranha, 875 BRCAO 02 Sala A
Vargem Grande
Pinhais PR
83321-020
(41) 3699-4237

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 4.645
SÉRIE 1
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4124 1233 0683 2000 0132 5500 1000 0046 4516 3641 2416

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141240380333582 09/12/24 16:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9080829318

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
33.068.320/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANÓPOLIS

C.N.P.J.
08.935.681/0001-91

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
09/12/2024

ENDEREÇO
AV PROFESSOR HENRIQUE DA SILVA FONTES 6100 CONJ SALAS

CEP
88036-700

DATA DA SAÍDA/ENTRA

MUNICÍPIO
Florianópolis

FONE/FAX

U.F.
SC

BAIRRO/DISTRITO
TRINDADE

HORA DA SAÍDA

PATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
5/1	08/01/25	2.700,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.700,00	VALOR DO ICMS 108,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.700,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. 00.428.307/0012-40
ENDEREÇO RUA ANGELA GABARDO PAROLIN 201 BLOCO 3	MUNICÍPIO Curitiba / PR	U.F. PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9067123937		
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 13	PESO LÍQUIDO 13

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UNTD.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
60	ESFIGMOMANOMETRO OBESO	9018.90.69	200	6.108	PC	30,00	90,00	2.700,00	2.700,00	ICMS	IPI	ICMS	IPI
	Lote: 132401 x3, Lote: 232301 x27									108,00	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino:351,00 | :: Valor aproximado dos tributos R\$ (0.00%) Fonte: IBPT | :: Valor do IRRF: R\$ 32,40 - Aliquota 1.2% | :: Pedido:2918 | :: OC:2566/2024 | :: End de Entrega:AGENDAMENTO CIADFPOLIS@BRANETLOGISTICA. COM.BR, BRANET- RUA FIRENZE BUSINESS PERK 475, PACHECOS- PALHOÇA/ SC- CEP: 88135-010, EM FRENTE Á ARENA R1. FONE: 48- 3380-7428, 3380-7429, HORARIO SEG A QUI DE 08 A 12 HRS E DE 13:30 AS 16 HRS. | :: Nota de Empenho:2566/2024, P.E: 93/2024 | BANCO BRASIL AG: 1622-5, C/C: 20.327-0 | CEF AG: 1630 OP. 003, C/C 3128-6 | BRADESCO AG: 1205, C/C: 14344-8 | SANTANDER AG: 1258 C/C: 130033035 | PIX: CNPJ 33.068.320/0001-32

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 4.433 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

R: Graça Aranha, 875 BRCAO 02 Sala A

Vargem Grande

Pinhais PR

83321-020

(41) 3699-4237

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 4.433
SÉRIE 1
Folha 1 de 1



FLS. 165

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribuir		CHAVE DE ACESSO 4124 1033 0683 2000 0132 5500 1000 0044 3318 2582 7371	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9080829318		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240318615264 18/10/24 13:50	
INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 33.068.320/0001-32	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE SANTO ÂNGELO		87.613.071/0001-48		18/10/2024
ENDEREÇO R ANTUNES RIBAS 1001 ESQ ANTONIO MANOEL		CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRA
		98801-630		
MUNICÍPIO Santo Ângelo	FONE/FAX (55) 3312-0100	U.F. RS	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	HORA DA SAÍDA

FATURA											
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
33/1	18/11/24	166,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
166,00	6,64	0,00	0,00	0,00	166,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.
ENDEREÇO R JOÃO NEGRAO 1251		MUNICÍPIO Curitiba / PR			U.F. PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
					1	1

DADOS DO PRODUTO											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR	
51	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO	9018.90.69	200	6.108	PC	2,00	83,00	166,00	166,00	ICMS	ALIQUOTAS
	Lote: 322301 x2									6,64	0,00
										4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES :: Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino:21,58 :: Valor aproximado dos tributos R\$ (0.00%) Fonte: IBPT :: Pedido:2763 :: OC:008139/2024 :: End de Entrega:ALMOX DA SEC DE SAUDE, R. TIRADENTES, 1398, CENTRO, SANTO ANGELO/RS, A/C LETICIA (55) 99664-6279 :: Nota de Empenho:DESPESA 008139/2024, PE 42/2024, PEDIDO 11641/2024, SES 1098/2023 "Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI." para as vendas do optante do Simples Nacional. BANCO BRASIL AG: 1622-5, C/C: 20.327-0 CEF AG: 1630 OP. 003, C/C 3128-6 BRADESCO AG: 1205, C/C: 14344-8 SANTANDER AG: 1258 C/C: 130033035 PIX: CNPJ 33.068.320/0001-32	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 3.577

SÉRIE 1

CEP 14540-000

FLS. 166



ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

R: Graça Aranha, 875 BRCAO 02 Sala A

Vargem Grande

Pinhais PR

83321-020

(41) 3699-4237

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 3.577

SÉRIE 1

Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4124 0433 0683 2000 0132 5500 1000 0035 7712 2696 3127

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribuir

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240097077279 02/04/24 11:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9080829318

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

33.068.320/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE IGARAPAVA

ENDEREÇO

R DOUTOR GABRIEL VILELA 413

MUNICÍPIO

Igarapava

FONE/FAX

(16) 31731000

U.F.

SP

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

C.N.P.J.

45.324.290/0001-67

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

14540-000

DATA DA EMISSÃO

02/04/2024

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
77/1	02/05/24	2.134,90												

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.134,90	85,40	0,00	0,00	0,00	2.134,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC.

U.F.

C.N.P.J./C.P.F.

89.823.918/0005-78

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO MUNOZ MADRID 1001

MUNICÍPIO

São José dos Pinhais / PR

U.F.

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9016258323

QUANTIDADE

1,00

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
1698	KIT DE ELETRODO - CHINMED	9018.19.80	100	6.108	PC	1,00	164,00	164,00	164,00	6,56	0,00	4,00	0,00
	Lote: BRL20230630CSF001 x1												
1126	ESTETOSCOPIO PEDIATRICO	9018.90.99	100	6.108	PC	2,00	14,95	29,90	29,90	1,20	0,00	4,00	0,00
	Lote: 2021-KTK10 x2												
311	DETECTOR FETAL- JUMPER	9018.12.90	100	6.108	PC	1,00	437,00	437,00	437,00	17,48	0,00	4,00	0,00
	Lote: 9030100B054166 Sér.: 9030100B054166 x1												
120	OFTALMOSCOPIO	9018.50.90	200	6.108	PC	2,00	752,00	1.504,00	1.504,00	60,16	0,00	4,00	0,00
	Lote: FA722433 x2												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

:: Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino:298,89 | :: Valor aproximado dos tributos R\$0,00 (0.00%) Fonte: IBPT | :: Pedido:2178 | :: OC:01080/24 | :: End de Entrega:AV. 22 DE MAIO, 3394, CENTRO, IGARAPAVA - SP , CEP: 1454-000, HORÁRIO: DIAS ÚTEIS DAS 7H AS 16H. | :: Nota de Empenho:REQUISIÇÃO 01080/24, PE 089/2023. | "Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI." para as vendas do optante do Simples Nacional. | BANCO BRASIL AG: 1622-5, C/C: 20.327-0 | CEF AG: 1630 OP. 003, C/C 3128-6 | BRADESCO AG: 1205, C/C: 14344-8 | SANTANDER AG: 1258 C/C: 130033035 | PIX: CNPJ 33.068.320/0001-32

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 4.120

SÉRIE 1



ASCLEPIOS

EQUIPAMENTOS

HOSPITALARES LTDA

R: Graça Aranha, 875 BRCAO 02 Sala A

Vargem Grande

Pinhais PR

83321-020

(41) 3699-4237

DANFE

DOCUMENTO

AUXILIAR

DE NOTA FISCAL

ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 4.120

SÉRIE 1

Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4124 0833 0683 2000 0132 5500 1000 0041 2019 3098 4181

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9080829318

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

141240235120843

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

07/08/24 11:46

CNPJ

33.068.320/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CATURITE

ENDEREÇO

R JOAO QUEIROGA 44 TERREO

MUNICÍPIO

Caturité

FONE/FAX

(83) 3345-1071

U.F.

PB

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

C.N.P.J.

11.457.024/0001-90

INSCRIÇÃO ESTADUAL

58455-000

DATA DA EMISSÃO

07/08/2024

DATA DA SAÍDA/ENTRA

HORA DA SAÍDA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
20/1	06/09/24	11.120,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.120,00	551,00	0,00	0,00	0,00	11.120,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

JAMEF TRANSPORTES LTDA-CWB

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC.

U.F.

C.N.P.J./C.P.F.

20.147.617/0019-70

ENDEREÇO

RUA MARIALVA 1340

MUNICÍPIO

Curitiba / PR

U.F.

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1017624322

QUANTIDADE

5,00

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

25

PESO LÍQUIDO

25

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
545	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO	9019.20.20	000	6.108	UN	3,00	1.180,00	3.540,00	3.540,00	247,80	0,00	7,00	0,00
	Lote: 24-07-02545 Sér.: 41147 à 41149 x3												
1301	ELETROCARDIOGRAFO	9018.11.00	100	6.108	PC	2,00	3.790,00	7.580,00	7.580,00	303,20	0,00	4,00	0,00
	Lote: ECG5503B2405071 Sér.: ECG5503B2405071 x1, Lote: ECG5503B2405072 Sér.: ECG5503B2405072 x1												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino:1.673,00 | :: Valor aproximado dos tributos R\$ (0.00%) Fonte: IBPT | :: Pedido:2553 |

End de Entrega:PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ, RUA JOÃO QUEIROGA, 44, CENTRO, CATURITÉ - PB, CEP: 58455-000, HORÁRIO: 8H00 AS 13H. | :: Nota de Empenho:PE00002/2024, CONTRATO 10027/2024. | "Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI." para as vendas do optante do Simples Nacional. | BANCO BRASIL AG: 1622-5, C/C: 20.327-0 | CEF AG: 1630 OP. 003, C/C 3128-6 | BRADESCO AG: 1205, C/C: 14344-8 | SANTANDER AG: 1258 C/C: 130033035 | PIX: CNPJ 33.068.320/0001-32

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 4.656 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

R: Graça Aranha, 875 BRCAO 02 Sala A

Vargem Grande

Pinhais PR

83321-020

(41) 3699-4237

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 4.656
SÉRIE 1
Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4124 1233 0683 2000 0132 5500 1000 0046 5617 4287 9105

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribuir

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9080829318

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141240382601185 **11/12/24 07:52**

CNPJ
33.068.320/0001-32

NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE PIRACAIA		C.N.P.J. 45.279.627/0001-61	INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO 11/12/2024
ENDEREÇO AV DR CANDIDO RODRIGUES 120		CEP 12970-000		DATA DA SAÍDA/ENTRA	
MUNICÍPIO Piracaia	FONE/FAX (11) 4036-2020	U.F. SP	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		HORA DA SAÍDA

FATURA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
56/1	10/01/25	400,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
400,00	16,00	0,00	0,00	0,00	400,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEIC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F. 34.028.316/0020-76
ENDEREÇO R JOÃO NEGRAO 1251		MUNICÍPIO Curitiba / PR		U.F. PR		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
				2	2	

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
51	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO PREMIUM	9018.90.69	200	6.108	PC	5,00	80,00	400,00	400,00	16,00	0,00	4,00	0,00
Lote: 392301 x5													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

:: Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino:56,00 :: Valor aproximado dos tributos R\$ (0.00%) Fonte: IBPT :: Valor do IRRF: R\$ 4,80 - Aliquota 1.2% :: Pedido:2937 :: OC:1340/24 :: End de Entrega:DEP. DE SAUD, RUA JAN ANTONIN BATA, 06, CENTRO, PIRACAIA/SP, HORARIO DAS 08H AS 12H E DAS 13H30 AS 16H, FONE:(11) 4036-2720. :: Nota de Empenho:PEDIDO 1340/24, PE 28/2024, PROCESSO 879/24, SOLICITACAO 1328/24, RESERVA 2202. | BANCO BRASIL AG: 1622-5, C/C: 20.327-0 | CEF AG: 1630 OP. 003, C/C 3128-6 | BRADESCO AG: 1205, C/C: 14344-8 | SANTANDER AG: 1258 C/C: 130033035 | PIX: CNPJ 33.068.320/0001-32

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 4.645 SÉRIE 1	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		



ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

R: Graça Aranha, 875 BRCAO 02 Sala A

Vargem Grande

Pinhais PR

83321-020

(41) 3699-4237

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA **1**

Nº 4.645

SÉRIE 1

Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4124 1233 0683 2000 0132 5500 1000 0046 4516 3641 2416

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240380333582 09/12/24 16:16	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9080829318	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 33.068.320/0001-32	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANÓPOLIS		08.935.681/0001-91		09/12/2024
ENDEREÇO AV PROFESSOR HENRIQUE DA SILVA FONTES 6100 CONJ SALAS		CEP 88036-700	DATA DA SAÍDA/ENTRA	
MUNICÍPIO Florianópolis	FONE/FAX	U.F. SC	BAIRRO/DISTRITO TRINDADE	HORA DA SAÍDA

Nº	TERMO	VENCIMENTO	VALOR	Nº	TERMO	VENCIMENTO	VALOR	Nº	TERMO	VENCIMENTO	VALOR	Nº	TERMO	VENCIMENTO	VALOR	Nº	TERMO	VENCIMENTO	VALOR
5/1		08/01/25	2.700,00																

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.700,00	VALOR DO ICMS 108,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.700,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME/RAZÃO SOCIAL EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC.	U.F.
ENDEREÇO RUA ANGELA GABARDO PAROLIN 201 BLOCO 3		MUNICÍPIO Curitiba / PR			U.F. PR
QUANTIDADE 1,00	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 13	PESO LÍQUIDO 13

DADOS DO PRODUTO												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/ CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS
60	ESFIGMOMANOMETRO OBESO	9018.90.69	200	6.108	PC	30,00	90,00	2.700,00	2.700,00	108,00	0,00	4,00 0,00
Lote: 132401 x3, Lote: 232301 x27												

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES :: Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino:351,00 :: Valor aproximado dos tributos R\$ (0.00%) Fonte: IBPT :: Valor do IRRF: R\$ 32,40 - Aliquota 1.2% :: Pedido:2918 :: OC:2566/2024 :: End de Entrega:AGENDAMENTO CIADFPOLIS@BRANETLOGISTICA. COM.BR. BRANET- RUA FIRENZE BUSINESS PERK 475, PACHECOS- PALHOÇA/ SC- CEP: 88135-010, EM FRENTE À ARENA R1. FONE: 48- 3380-7428, 3380-7429, HORARIO SEG A QUI DE 08 A 12 HRS E DE 13:30 AS 16 HRS. :: Nota de Empenho:2566/2024, P.E: 93/2024 BANCO BRASIL AG: 1622-5, C/C: 20.327-0 CEF AG: 1630 OP. 003, C/C 3128-6 BRADESCO AG: 1205, C/C: 14344-8 SANTANDER AG: 1258 C/C: 130033035 PIX: CNPJ 33.068.320/0001-32	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 4.433

SÉRIE 1



ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

R: Graça Aranha, 875 BRCAO 02 Sala A

Vargem Grande

Pinhais PR

83321-020

(41) 3699-4237

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 4.433

SÉRIE 1

Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4124 1033 0683 2000 0132 5500 1000 0044 3318 2582 7371

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu

PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240318615264

18/10/24 13:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9080829318

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

33.068.320/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE SANTO ÂNGELO

ENDEREÇO

R ANTUNES RIBAS 1001 ESQ ANTONIO MANOEL

MUNICÍPIO

Santo Ângelo

FONE/FAX

(55) 3312-0100

U.F.

RS

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

C.N.P.J.

87.613.071/0001-48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

98801-630

DATA DA EMISSÃO

18/10/2024

DATA DA SAÍDA/ENTRA

HORA DA SAÍDA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
3/1	18/11/24	166,00									

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
166,00	6,64	0,00	0,00	0,00	166,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC.

U.F.

C.N.P.J./C.P.F.

34.028.316/0020-76

ENDEREÇO

R JOÃO NEGRAO 1251

MUNICÍPIO

Curitiba / PR

U.F.

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1,00

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	IPI	ICMS	IPI
51	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO	9018.90.69	200	6.108	PC	2,00	83,00	166,00	166,00	6,64	0,00	4,00	0,00
	Lote: 322301 x2												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Reservado ao Fisco

RECEBEMOS DE ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

No 3.577

SERIE 1

FLS.



ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

R: Graça Aranha, 875 BRCAO 02 Sala A

Vargem Grande

Pinhais PR

83321-020

(41) 3699-4237

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 3.577

SÉRIE 1

Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4124 0433 0683 2000 0132 5500 1000 0035 7712 2696 3127

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribuinte

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240097077279

02/04/24 11:17

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9080829318

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

33.068.320/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE IGARAPAVA

ENDEREÇO

R DOUTOR GABRIEL VILELA 413

MUNICÍPIO

Igarapava

FONE/FAX

(16) 31731000

U.F.

SP

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

C.N.P.J.

45.324.290/0001-67

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

14540-000

DATA DA EMISSÃO

02/04/2024

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA

DATA	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
7/1	02/05/24	2.134,90											

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.134,90	85,40	0,00	0,00	0,00	2.134,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.134,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

TRANSPORTES TRANSLOVATO LTDA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC.

U.F.

C.N.P.J./C.P.F.

89.823.918/0005-78

ENDEREÇO

RUA FRANCISCO MUNOZ MADRID 1001

MUNICÍPIO

São José dos Pinhais / PR

U.F.

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9016258323

QUANTIDADE

1,00

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

1

PESO LÍQUIDO

1

DADOS DO PRODUTO													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
1698	KIT DE ELETRODO - CHINMED	9018.19.80	100	6.108	PC	1,00	164,00	164,00	164,00	6,56	0,00	4,00	0,00
	Lote: BRL20230630CSF001 x1												
1126	ESTETOSCOPIO PEDIATRICO	9018.90.99	100	6.108	PC	2,00	14,95	29,90	29,90	1,20	0,00	4,00	0,00
	Lote: 2021-KTK10 x2												
311	DETECTOR FETAL- JUMPER	9018.12.90	100	6.108	PC	1,00	437,00	437,00	437,00	17,48	0,00	4,00	0,00
	Lote: 9030100B054166 Sér.: 9030100B054166 x1												
120	OFTALMOSCOPIO	9018.50.90	200	6.108	PC	2,00	752,00	1.504,00	1.504,00	60,16	0,00	4,00	0,00
	Lote: FA722433 x2												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino:298,89 | Valor aproximado dos tributos R\$0,00 (0.00%) Fonte: IBPT | Pedido:2178 | OC:01080/24 | End de Entrega:AV. 22 DE MAIO, 3394, CENTRO, IGARAPAVA - SP , CEP: 1454-000, HORÁRIO: DIAS ÚTEIS DAS 7H AS 16H. | Nota de Empenho:REQUISIÇÃO 01080/24, PE 089/2023. | "Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI." para as vendas do optante do Simples Nacional. | BANCO BRASIL AG: 1622-5, C/C: 20.327-0 | CEF AG: 1630 OP. 003, C/C 3128-6 | BRADESCO AG: 1205, C/C: 14344-8 | SANTANDER AG: 1258 C/C: 130033035 | PIX: CNPJ 33.068.320/0001-32

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 4.120

SÉRIE 1

FLS.



ASCLEPIOS

EQUIPAMENTOS

HOSPITALARES LTDA

R: Graça Aranha, 875 BRCAO 02 Sala A

Vargem Grande

Pinhais PR

83321-020

(41) 3699-4237

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 4.120

SÉRIE 1

Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

4124 0833 0683 2000 0132 5500 1000 0041 2019 3098 4181

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9080829318

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240235120843

07/08/24 11:46

CNPJ

33.068.320/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CATURITE

ENDEREÇO

R JOAO QUEIROGA 44 TERREO

MUNICÍPIO

Caturité

FONE/FAX

(83) 3345-1071

U.F.

PB

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

C.N.P.J.

11.457.024/0001-90

INSCRIÇÃO ESTADUAL

58455-000

DATA DA EMISSÃO

07/08/2024

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA

Nº	ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Nº	ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Nº	ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Nº	ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
0/1	06/09/24	11.120,00																					

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.120,00	551,00	0,00	0,00	0,00	11.120,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

JAMEF TRANSPORTES LTDA-CWB

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC.

U.F.

C.N.P.J./C.P.F.

20.147.617/0019-70

ENDEREÇO

RUA MARIALVA 1340

MUNICÍPIO

Curitiba / PR

U.F.

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

1017624322

QUANTIDADE

5,00

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

25

PESO LÍQUIDO

25

DADOS DO PRODUTO													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
545	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO	9019.20.20	000	6.108	UN	3,00	1.180,00	3.540,00	3.540,00	247,80	0,00	7,00	0,00
Lote: 24-07-02545 Sér.: 41147 à 41149 x3													
1301	ELETROCARDIOGRAFO	9018.11.00	100	6.108	PC	2,00	3.790,00	7.580,00	7.580,00	303,20	0,00	4,00	0,00
Lote: ECG5503B2405071 Sér.: ECG5503B2405071 x1, Lote: ECG5503B2405072 Sér.: ECG5503B2405072 x1													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino: 1.673,00

Valor aproximado dos tributos R\$ (0.00%) Fonte: IBPT

Pedido: 2553

End de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ, RUA JOÃO QUEIROGA, 44, CENTRO, CATURITÉ - PB, CEP: 58455-000, HORÁRIO: 8H00 AS 13H.

Nota de Empenho: PE00002/2024, CONTRATO 10027/2024.

Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI.

para as vendas do optante do Simples Nacional.

BANCO BRASIL AG: 1622-5, C/C: 20.327-0 | CEF AG: 1630 OP. 003, C/C 3128-6 | BRADESCO AG: 1205, C/C: 14344-8 | SANTANDER AG: 1258 C/C: 130033035 | PIX: CNPJ 33.068.320/0001-32

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 4.656 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA R: Graça Aranha, 875 BRCAO 02 Sala A Vargem Grande Pinhais PR 83321-020 (41) 3699-4237	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 4.656 SÉRIE 1 Folha 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 4124 1233 0683 2000 0132 5500 1000 0046 5617 4287 9105 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora
---	---	---

NATUREZA DE OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribuinte	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240382601185 11/12/24 07:52
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9080829318	CNPJ 33.068.320/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE		C.N.P.J.		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL MUNICÍPIO DE PIRACAIA		45.279.627/0001-61		12970-000		11/12/2024	
ENDEREÇO AV DR CANDIDO RODRIGUES 120		CEP 12970-000		DATA DA SAÍDA/ENTRADA			
MUNICÍPIO Piracaia		FONE/FAX (11) 4036-2020		U.F. SP		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	
				HORA DA SAÍDA			

Nº	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	Nº	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	Nº	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	Nº	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	Nº	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
6/1	10/01/25	400,00																	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
400,00	16,00	0,00	0,00	0,00	400,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		NOME/RAZÃO SOCIAL EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍC.		U.F.		C.N.P.J./C.P.F.	
		R JOÃO NEGRAO 1251		MUNICÍPIO Curitiba / PR						PR		34.028.316/0020-76	
QUANTIDADE 1,00		ESPÉCIE VOLUMES		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		2		PESO LÍQUIDO	
												2	

DADOS DO PRODUTO													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
51	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO PREMIUM	9018.90.69	200	6.108	PC	5,00	80,00	400,00	400,00	ICMS	IPI	ICMS	IPI
	Lote: 392301 x5									16,00	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES :: Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino:56,00 :: Valor aproximado dos tributos R\$ (0.00%) Fonte: IBPT :: Valor do IRRF: R\$ 4,80 - Aliquota 1.2% :: Pedido:2937 :: OC:1340/24 :: End de Entrega:DEP. DE SAUD, RUA JAN ANTONIN BATA, 06, CENTRO, PIRACAIA/SP, HORARIO DAS 08H AS 12H E DAS 13H30 AS 16H, FONE:(11) 4036-2720. :: Nota de Empenho:PEDIDO 1340/24, PE 28/2024, PROCESSO 879/24, SOLICITACAO 1328/24, RESERVA 2202. BANCO BRASIL AG: 1622-5, C/C: 20.327-0 CEF AG: 1630 OP. 003, C/C 3128-6 BRADESCO AG: 1205, C/C: 14344-8 SANTANDER AG: 1258 C/C: 130033035 PIX: CNPJ 33.068.320/0001-32	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03208/2024

CAD. ICMS:90808293-10
ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA
RUA GRAÇA ARANHA, 875 - BRÇÃO 02 - SALA A
VARGEM GRANDE - CEP 83321-020
PINHAIS - PR

FLS. 74

DEMONSTRAÇÃO DE CUSTOS

A empresa Asclépios Equipamentos Hospitalares Eireli, inscrita no CNPJ sob nº 33.068.320-0001-32, com sede na Rua Graça Aranha, nº 875, Brção 2, Sala A, Bairro Vargem Grande, Pinhais/PR, CEP 83.321-020, vem por meio desta apresentar a composição dos custos que compõem a proposta de preços:

Item	Produto	Frete	Impostos	Valor unitário	Valor total do item
20	Esfigmomanômetro Adulto	Varia de acordo com as medidas e peso.	22%	R\$80,00	R\$240,00
65	Esfigmomanômetro Adulto	Varia de acordo com as medidas e peso.	22%	R\$80,00	R\$240,00
67	Esfigmomanômetro Adulto grande	Varia de acordo com as medidas e peso.	22%	R\$95,00	R\$190,00
107	Esfigmomanômetro Adulto	Varia de acordo com as medidas e peso.	22%	R\$82,50	R\$165,00
110	Estetoscópio	Varia de acordo com as medidas e peso.	22%	R\$21,14	R\$42,28



ASCLÉPIOS
Equipamentos Hospitalares

CAD. ICMS:90808293-10
ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA
RUA GRAÇA ARANHA, 875 - BRCÃO 02 - SALAA
VARGEM GRANDE - CEP 83321-020
PINHAIS - PR
FLS. **CC4** 25

140	Eletrocardiógrafo	Varia de acordo com as medidas e peso.	22%	R\$4.200,00	R\$4200,00
-----	-------------------	--	-----	-------------	------------

O valor do frete sofre variação de acordo com o pedido da instituição, devido a este ser cobrado sobre o tamanho da embalagem e sobre o seu peso, para assim, termos o valor de frete. Assim, nos valores ofertados estão inclusos todos os custos para o fornecimento dos itens, tais como: tributos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais, embalagens, fretes e lucro.

Pinhais, 13 de dezembro de 2024.


Patricia
Bach:03130961984

Assinado de forma digital por
Patricia Bach:03130961984
Dados: 2024.12.13 11:32:01
-03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAXIAS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 053/2024
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 03208/2024

CAD. ICMS:90808293-10
ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA
RUA GRAÇA ARANHA, 875 - BRÇÃO 02 - SALAA
VARGEM GRANDE - CEP 83321-020
PINHAIS - PR



DEMONSTRAÇÃO DE CUSTOS

A empresa Asclépios Equipamentos Hospitalares Eireli, inscrita no CNPJ sob nº 33.068.320-0001-32, com sede na Rua Graça Aranha, nº 875, Brção 2, Sala A, Bairro Vargem Grande, Pinhais/PR, CEP 83.321-020, vem por meio desta apresentar a composição dos custos que compõem a proposta de preços:

Item	Produto	Frete	Impostos	Valor unitário	Valor total do item
20	Esfigmomanômetro Adulto	Varia de acordo com as medidas e peso.	22%	R\$80,00	R\$240,00
65	Esfigmomanômetro Adulto	Varia de acordo com as medidas e peso.	22%	R\$80,00	R\$240,00
67	Esfigmomanômetro Adulto grande	Varia de acordo com as medidas e peso.	22%	R\$95,00	R\$190,00
107	Esfigmomanômetro Adulto	Varia de acordo com as medidas e peso.	22%	R\$82,50	R\$165,00
110	Estetoscópio	Varia de acordo com as medidas e peso.	22%	R\$21,14	R\$42,28



ASCLÉPIOS
Equipamentos Hospitalares

CAD. ICMS:90808293-10

ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS

HOSPITALARES LTDA

RUA GRAÇA ARANHA, 875 - BRCÃO 02 - SALA A

VARGEM GRANDE - CEP 83321-020

PINHAIS - PR

FLS. 77

140	Eletrocardiógrafo	Varia de acordo com as medidas e peso.	22%	R\$4.200,00	R\$4200,00
-----	-------------------	--	-----	-------------	------------

O valor do frete sofre variação de acordo com o pedido da instituição, devido a este ser cobrado sobre o tamanho da embalagem e sobre o seu peso, para assim, termos o valor de frete. Assim, nos valores ofertados estão inclusos todos os custos para o fornecimento dos itens, tais como: tributos fiscais, sociais, trabalhistas, previdenciários, comerciais, embalagens, fretes e lucro.

Pinhais, 13 de dezembro de 2024.

Patricia
Bach:03130961984

Assinado de forma digital por

Patricia Bach:03130961984

Dados: 2024.12.13 11:32:01

-03'00'

RECEBEMOS DE ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 4.656

SÉRIE 1

FLS.



ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA

R: Graça Aranha, 875 BRCAO 02 Sala A

Vargem Grande

Pinhais PR

83321-020

(41) 3699-4237

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 4.656

SÉRIE 1

Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

4124 1233 0683 2000 0132 5500 1000 0046 5617 4287 9105

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9080829318

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240382601185

11/12/24 07:52

CNPJ

33.068.320/0001-32

NOME/RAZÃO SOCIAL

MUNICÍPIO DE PIRACAIA

ENDEREÇO

AV DR CANDIDO RODRIGUES 120

MUNICÍPIO

Piracaia

FONE/FAX

(11) 4036-2020

U.F.

SP

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

C.N.P.J.

45.279.627/0001-61

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP

12970-000

DATA DA EMISSÃO

11/12/2024

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
6/1	10/01/25	400,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
400,00	16,00	0,00	0,00	0,00	400,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00

NOME/RAZÃO SOCIAL

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF

ENDEREÇO

R JOÃO NEGRAO 1251

QUANTIDADE

1,00

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

2

PESO LÍQUIDO

2

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC.

U.F.

C.N.P.J./C.P.F.

34.028.316/0020-76

U.F.

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DO PRODUTO													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST/CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
51	ESFIGMOMANOMETRO ADULTO PREMIUM	9018.90.69	200	6.108	PC	5,00	80,00	400,00	400,00	ICMS	IPI	ICMS	IPI
	Lote: 392301 x5									16,00	0,00	4,00	0,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RS 4,80 - Aliquota 1.2% | :: Pedido:2937 | :: OC:1340/24 | :: End de Entrega:DEP. DE SAUD. RUA JAN ANTONIN BATA, 06, CENTRO, PIRACAIA/SP, HORARIO DAS 08H AS 12H E DAS 13H30 AS 16H, FONE:(11) 4036-2720. | :: Nota de Empenho:PEDIDO 1340/24, PE 28/2024, PROCESSO 879/24, SOLICITACAO 1328/24, RESERVA 2202. | BANCO BRASIL AG: 1622-5, C/C: 20.327-0 | CEF AG: 1630 OP. 003, C/C 3128-6 | BRADESCO AG: 1205, C/C: 14344-8 | SANTANDER AG: 1258 C/C: 130033035 | PIX: CNPJ 33.068.320/0001-32

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 4.645

SÉRIE 1

ASCLEPIOS

EQUIPAMENTOS

HOSPITALARES LTDA

R: Graça Aranha, 875 BRCAO 02 Sala A

Vargem Grande

Pinhais PR

83321-020

(41) 3699-4237

DANFE

DOCUMENTO

AUXILIAR

DE NOTA FISCAL

ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 4.645

SÉRIE 1

Folha 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

4124 1233 0683 2000 0132 5500 1000 0046 4516 3641 2416

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9080829318

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

33.068.320/0001-32

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141240380333582

09/12/24 16:16

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FLORIANÓPOLIS

C.N.P.J.

08.935.681/0001-91

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO

09/12/2024

ENDEREÇO

AV PROFESSOR HENRIQUE DA SILVA FONTES 6100 CONJ SALAS

CEP

88036-700

DATA DA SAÍDA/ENTRA

MUNICÍPIO

Florianópolis

FONE/FAX

U.F.

SC

BAIRRO/DISTRITO

TRINDADE

HORA DA SAÍDA

FATURA

Nº	ITEM	QUANTIDADE	UNIDADE	VALOR
5/1	08/01/25	2.700,00		

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.700,00	108,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL

EXPRESSO SAO MIGUEL LTDA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC.

U.F.

C.N.P.J./C.P.F.

00.428.307/0012-40

ENDEREÇO

RUA ANGELA GABARDO PAROLIN 201 BLOCO 3

MUNICÍPIO

Curitiba / PR

U.F.

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

9067123937

QUANTIDADE

1,00

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

13

PESO LÍQUIDO

13

DADOS DO PRODUTO

CÓDIGO	PRODUTO	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR	ALÍQUOTAS		
60	ESFIGMOMANOMETRO OBESO	9018.90.69	200	6.108	PC	30,00	90,00	2.700,00	2.700,00	108,00	0,00	4,00	0,00

Lote: 132401 x3, Lote: 232301 x27

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
:: Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino:351,00 :: Valor aproximado dos tributos R\$ (0.00%) Fonte: IBPT :: Valor do IRRF: R\$ 32,40 - Aliquota 1.2% :: Pedido:2918 :: OC:2566/2024 :: End de Entrega:AGENDAMENTO CIADEPOLIS@BRANETLOGISTICA. COM.BR, BRANET- RUA FIRENZE BUSINESS PERK 475, PACHECOS- PALHOÇA/ SC- CEP: 88135-010, EM FRENTE À ARENA R1. FONE: 48- 3380-7428, 3380-7429, HORARIO SEG A QUI DE 08 A 12 HRS E DE 13:30 AS 16 HRS. :: Nota de Empenho:2566/2024, P.E: 93/2024 | BANCO BRASIL AG: 1622-5, C/C: 20.327-0 | CEF AG: 1630 OP. 003, C/C 3128-6 | BRADESCO AG: 1205, C/C: 14344-8 | SANTANDER AG: 1258 C/C: 130033035 | PIX: CNPJ 33.068.320/0001-32

RECEBEMOS DE ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 4.433 SÉRIE 1											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		FLS. 780										
 ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA R: Graça Aranha, 875 BRCAO 02 Sala A Vargem Grande Pinhais PR 83321-020 (41) 3699-4237 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DE NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 4.433 SÉRIE 1 Folha 1 de 1 		CHAVE DE ACESSO 4124 1033 0683 2000 0132 5500 1000 0044 3318 2582 7371 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizadora											
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO											
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribu		141240318615264 18/10/24 13:50											
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ											
9080829318		33.068.320/0001-32											
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL		C.N.P.J.	INSCRIÇÃO ESTADUAL										
MUNICÍPIO DE SANTO ÂNGELO		87.613.071/0001-48											
ENDEREÇO		CEP	DATA DA EMISSÃO										
R ANTUNES RIBAS 1001 ESQ ANTONIO MANOEL		98801-630	18/10/2024										
MUNICÍPIO	FONE/FAX	U.F.	BAIRRO/DISTRITO										
Santo Ângelo	(55) 3312-0100	RS	CENTRO										
HORA DA SAÍDA													
FATURA													
Nº/MERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR		
3/1	18/11/24	166,00											
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO		BASE DE CÁLCULO ICMS S.T		VALOR DO ICMS ST		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS				
166,00		6,64	0,00		0,00		0,00		166,00				
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00		0,00	0,00		0,00		0,00		166,00				
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍC.	U.F.	C.N.P.J./C.P.F.						
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAF		0-EMITENTE					34.028.316/0020-76						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		U.F.		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
R JOÃO NEGRAO 1251		Curitiba / PR		PR									
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO							
1,00	VOLUMES			1		1							
DADOS DO PRODUTO													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
51	APARELHO DE PRESSÃO ADULTO	9018.90.69	200	6.108	PC	2,00	83,00	166,00	166,00	ICMS	IPI	ICMS	IPI
	Lote: 322301 x2									6,64	0,00	4,00	0,00
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES								RESERVADO AO FISCO					
:: Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino:21,58 :: Valor aproximado dos tributos R\$ (0.00%) Fonte: IBPT :: Pedido:2763 :: OC:008139/2024 :: End de Entrega:ALMOX DA SEC DE SAUDE, R. TIRADENTES, 1398, CENTRO, SANTO ANGELO/RS, A/C LETICIA (55) 99664-6279 :: Nota de Empenho:DESPESA 008139/2024, PE 42/2024, PEDIDO 11641/2024, SES 1098/2023 "Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI." para as vendas do optante do Simples Nacional. BANCO BRASIL AG: 1622-5, C/C: 20.327-0 CEF AG: 1630 OP. 003, C/C 3128-6 BRADESCO AG: 1205, C/C: 14344-8 SANTANDER AG: 1258 C/C: 130033035 PIX: CNPJ 33.068.320/0001-32													

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES :: Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino:298,89 :: Valor aproximado dos tributos R\$50,00 (0.00%) Fonte: IBPT :: Pedido:2178 :: OC:01080/24 :: End de Entrega:AV. 22 DE MAIO, 3394, CENTRO, IGARAPAVA - SP, CEP: 1454-000, HORÁRIO: DIAS ÚTEIS DAS 7H AS 16H. :: Nota de Empenho:REQUISIÇÃO 01080/24, PE 089/2023. "Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI." para as vendas do optante do Simples Nacional. BANCO BRASIL AG: 1622-5, C/C: 20.327-0 CEF AG: 1630 OP. 003, C/C 3128-6 BRADESCO AG: 1205, C/C: 14344-8 SANTANDER AG: 1258 C/C: 130033035 PIX: CNPJ 33.068.320/0001-32	RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE ASCLEPIOS EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 4.120

COSMOS

FLS. 182



ASCLEPIOS
EQUIPAMENTOS
HOSPITALARES LTDA

R: Graça Aranha, 875 BRCAO 02 Sala A
Vargem Grande
Pinhais PR
83321-020
(41) 3699-4237

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR
DE NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 4.120

SÉRIE 1

Folha 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4124 0833 0683 2000 0132 5500 1000 0041 2019 3098 4181

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e:
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da SEFAZ Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, destinada a não contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9080829318

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141240235120843 07/08/24 11:46

CNPJ
33.068.320/0001-32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CATURITE

C.N.P.J.
11.457.024/0001-90

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO
07/08/2024

ENDEREÇO
R JOAO QUEIROGA 44 TERREO

CEP
58455-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
Caturité

FONE/FAX
(83) 3345-1071

U.F.
PB

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

HORA DA SAÍDA

NT/MERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
0/1	06/09/24	11.120,00												

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR ICMS DESONERADO	BASE DE CÁLCULO ICMS S.T	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
11.120,00	551,00	0,00	0,00	0,00	11.120,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.120,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL
JAMEF TRANSPORTES LTDA-CWB

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍC.

U.F.

C.N.P.J./C.P.F.
20.147.617/0019-70

ENDEREÇO
RUA MARIALVA 1340

MUNICÍPIO
Curitiba / PR

U.F.
PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1017624322

QUANTIDADE
5,00

ESPÉCIE
VOLUMES

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO
25

PESO LÍQUIDO
25

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM/SH	CST / CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR		ALÍQUOTAS	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
545	CENTRAL DE NEBULIZAÇÃO	9019.20.20	000	6.108	UN	3,00	1.180,00	3.540,00	3.540,00	247,80	0,00	7,00	0,00
	Lote: 24-07-02545 Sér.: 41147 à 41149 x3												
1301	ELETROCARDIOGRAFO	9018.11.00	100	6.108	PC	2,00	3.790,00	7.580,00	7.580,00	303,20	0,00	4,00	0,00
	Lote: ECG5503B2405071 Sér.: ECG5503B2405072 x1, Lote: ECG5503B2405072 Sér.: ECG5503B2405072 x1												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

Valor total do ICMS Interestadual para a UF de destino: 1.673,00 | Valor aproximado dos tributos R\$ (0.00%) Fonte: IBPT | Pedido: 2553 | End de Entrega: PREFEITURA MUNICIPAL DE CATURITÉ, RUA JOÃO QUEIROGA, 44, CENTRO, CATURITÉ - PB, CEP: 58455-000, HORÁRIO: 8H00 AS 13H. | Nota de Empenho: PE00002/2024. CONTRATO 10027/2024. | "Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional. Não gera direito a crédito fiscal de ICMS e IPI." para as vendas do optante do Simples Nacional. | BANCO BRASIL AG: 1622-5, C/C: 20.327-0 | CEF AG: 1630 OP. 003, C/C 3128-6 | BRADESCO AG: 1205, C/C: 14344-8 | SANTANDER AG: 1258 C/C: 130033035 | PIX: CNPJ 33.068.320/0001-32

Plano de Pagto: ORCAMENTO	Prazo de Entrega : 05/12/2024	Horas:	Valor dos Itens	3.700,00
	Validade : 09/12/2024		Desconto	
Entrada :			Acres. Financeiro	
Parcelas : x	Vendedor: INES		T O T A L	3.700,00

MODELO FILIAL		ORCAMENTO N° 0030807
AV SAO FRANCISCO 1920 TANCREDO NEVES TERESINA-PI CEP: 64075-520		Data : 12/12/2024
Fone: (86) 3237-0864 Fax: () - CNPJ: 23.511.454/0002-03 I.E.: 195401930		Loja : 02

Cliente : DYNAMIC MED DIST.DE MEDIC.E PROD.HOSP.LTD	Codigo : 02006108	CNPJ/CPF : 02.770.479/0001-70
Endereco : RUA DA PICARREIRA 30	BAIRRO : FUMO VERDE	Insc.Est/Ident: 127550968
Cidade : CAXIAS-MA	CEP : 65607-760	FONE: (99)98272-2663

Codig Und	Qtde	Descricao do Item	Referencia	Valor Unit. Desc%	Valor Total
00117 UN	1,000	NEGATOSCOPIO DE 02 CORPO PINTADO	MMH-196	551,000	551,00

Plano de Pagto: ORCAMENTO	Prazo de Entrega : 12/12/2024	Horas:	Valor dos Itens	551,00
	Validade : 16/12/2024		Desconto	
Entrada :			Acres. Financeiro	
Parcelas : x	Vendedor: INES		T O T A L	551,00

CCF 485
FLS.

ACUMED

ACUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA
Av civil: 1795 Gárgara modelo 4 e 5 sala 33
Bairro Branco
Serra - ES
CEP 29170-740 - 2121261600

DATA E
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 0070943 FL 1 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3224 0606 1053 6200 0395 5500 1000 0709 4313 0894 6473
Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADO OU REC DE TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
083815562 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
232240014433831 21/06/2024 10-10-09
CNPJ / CPF
06.105.362/0003-95

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA
ENDERECO
R DA LUZ 51
MUNICIPIO
CAMBE
FONE / FAX
4333167108
BAIRRO / DISTRITO
JARDIM MORUMBI
UF
PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL
9086460537
CNPJ / CPF
39.346.590/0001-44
CEP
86191-770
DATA EMISSÃO
21/06/2024
DI ENTADA/SAÍDA
HORA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA / DUPLICATA	VENCIMENTO	VALOR
0070943/001	21/07/2024	1.381,73	0070943/002	31/07/2024	1.206,38	0070943/003	10/08/2024	1.206,74
CÁLCULO DO IMPOSTO		3.619,50	VALOR DO ICMS		171,18	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		0,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		3.619,50	VALOR DO ICMS		171,18	OUTRAS DESPESAS		0,00
VALOR DO FRETE		0,00	VALOR DO SEGURO		0,00	VALOR DO IP		175,35
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		0,00	VALOR DO DESCONTO		0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO		0,00
NOME / RAZÃO SOCIAL		ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA		0 - Por conta do emitente	PLACA DO VEICULO		01.125.797/0031-31
ENDERECO		AV. SETECENTOS S/N	MUNICIPIO		SERRA	UF		ES
QUANTIDADE		2,00	MARCA		2	CNPJ		083919945
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS		2,00	NÚMERO		2	PESO BRUTO		30,765
						PESO LÍQUIDO		30,765

ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA										UF		CNPJ																													
ENDERECO										01.125.797/0031-31																															
AV. SETECENTOS S/N										UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL																													
QUANTIDADE		ESPECIE		MARCA		MUNICIPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL																															
2,00						SERRA		ES		083919945																															
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO																													
CÓDIGO										2		30,765																													
DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO																																									
ESFHC201N_V										LOTE/QT		NCM / SH		CST		CFOP		UN		QUANT.		VALOR		B. CALC.		B. CALC.		VALOR		VALOR		VALOR		VALOR		ALÍQUOTAS					
ESFHC201N_V										362301/5		90189069		100		6102		un				5,00		62,50		312,50		312,50		0,00		12,50		0,00		16,25		4,00		5,20	
ESHS201N_V										392301/10		90189069		100		6102		un				10,00		46,30		463,00		463,00		0,00		18,52		0,00		24,08		4,00		5,20	
NEBRCOMDC1										492301/5		90192020		600		6102		UN				5,00		66,00		330,00		330,00		0,00		39,60		0,00		4,29		12,00		1,30	
Federal e 56,83 Estadual Fonte: IBPT/empresamento.co 691A69.																																									

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	-----------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO RISCO
Trib aprax R\$. 924,22 Federal e 645,12 Estadual Fonte: IBPT/empresamento.com.br 091A69 E-mail: kdn.produtoshospitalares@journal.com PEDIDO VENDA: 631459 / REPRES: BRUNA BAISSO		

ACQUMED
Identificação do emitente
ACQUMED PRODUTOS MED.HOSPITALARES LTDA
Rod. Washington Luiz 4370 Galp E, h, j, k, l
Vila Sebastião
Duque de Caxias - RJ
CNPJ 25055-009 - 2121261600



DANFE
DOCUMENTO AUTUÁRIO DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 0633281 FL. 2 / 2
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
3374 1006 1053 6200 0123 5500 1000 6332 8113 9882 3245
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERCADORIA ADQ OU REC DE TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO
77701290

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
CNPJ
233240190253727 21/10/2024 10:47:17
06.105.362/0001-23

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	LOTE/QT	NCM / SH	CST	CHOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B.CALC. ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPT	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPT
ESP250N_V	ESFÍG EM NYLON FECHIO VELCRO S/EST C/MAN COM SELO PREMIUM Trib apu. a RS. 179,88 Federal e 142,70 Estadual Fonte: IBPT/empresamento.co AB35A7.	262401/13	90189069	100	6102	un	13,00	52,173	678,25	678,25	0,00	27,13	0,00	35,27	4,00	5,20
ESP250N_V	ESF. INFANTIL EM NYLON VELCRO S/EST C/MAN COM SELO PREMIUM Trib apu. a RS. 131,28 Federal e 104,13 Estadual Fonte: IBPT/empresamento.co AB35A7.	332401/10	90189069	100	6102	un	10,00	49,50	495,00	495,00	0,00	19,80	0,00	25,74	4,00	5,20
NERCOMDCI	Nebulizador/Inalador de Ar Comprimido G-Tech Med Compact DCI	242402/1	90192020	600	6910	UN	1,00	35,2935	35,29	35,29	0,00	4,23	0,00	0,46	12,00	1,30

RECEBEMOS DE JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		N. 000171844 SÉRIE 1											
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR												
 Identificação do emitente JOAOMED COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS S/A RUA WILSON LUIS KOEHLER JUNIOR, 405 XAXIM Cep: 81630-280 CURITIBA/PR Fone: 4121084545		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA N. 000171844 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	 CHAVE DE ACESSO DANF-E 4124 1078 7424 9100 0133 6500 1000 1716 4412 8342 9864 Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada										
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141240324010239 23/10/2024 15:44:36-03:00											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 1016122447		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 78.742.491/0001-33										
DESTINATÁRIO/REMETENTE													
NOME/RAZÃO SOCIAL KON COMERCIO ATACADISTA LTDA		CNPJ/CNP	DATA DE EMISSÃO 23/10/2024										
ENDEREÇO RUA DA LUZ, N° 51, SN		BAIRRO/DISTRITO JARDIM MORUMBI	CEP 86191-770										
MUNICÍPIO CAMBE	FONE/FAX 4333167108	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9086480537										
FATURA 001 23/10/2024 945,56													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BAI CÁLCULO DO ICMS 945,56		VALOR DO ICMS 113,47	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00										
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 945,56											
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00										
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 945,56											
TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS													
RAZÃO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA		FRETE POR CONTA 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CNP										
ENDEREÇO RUA JOAO BETTEGA, N° 3802		MUNICÍPIO CURITIBA	UF PR INSCRIÇÃO ESTADUAL 9030546625										
QUANTIDADE 1	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO PESO BRUTO 15,000 PESO LÍQUIDO 15,000										
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD ESTUOACP R004	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. ESTETO DUO ADL O/PROT PRETO - ADVANTIVE - LT 251022 - VAL: 01/01/40	NCM/SH 90189099	CST 051	CFOP 5102	UN UN	QUANT. 100,00	V.UNITARIO 9,45564000	V.TOTAL 945,56	BC.ICMS 945,56	V.ICMS 113,47	V.IPI 0,00	A.ICMS 19,50%	A.IPI 0,00%
CÁLCULO DO ISSQN													
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN							
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Diferimento Parcial conforme Anexo VIII, Art. 28 do RICMS/PR - Decreto 7871/2017. ICMS Diferido em 38,46% no valor de R\$70.91. Protocolo: 141240324010239 DIFERIMENTO PARCIAL ART. 28 DO ANEXO VIII DO RICMS-PR Pedido: 746704 Nota Fiscal: 171644 Dt. Impressão: 23/10/24 Local de Entrega : RUA DA LUZ, N° 51 CEP: 86191-770 JARDIM MORUMBI, CAMBE-PR CEP: 86191-770 JARDIM MORUMBI CAMBE-PR ***CONFIRA O NUMERO DE VOLUMES NO ATO DA DESCARGA. NO CASO DE FALTA DE VOLUME COBRAR DA TRANSPORTADORA. RECLAMAÇÕES SERÃO ACEITAS NO PRAZO MÁXIMO DE 24 HORAS APÓS A ENTREGA DO MATERIAL.								RESERVADO AO FISCO					

RECEBEMOS DE 53.077.195 LUANA BARBOSA PENCI OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		Nº 000.002.422	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 002	

 53.077.195 LUANA BARBOSA PENCI Rua Parazinho, 120, Nao consta - Jardim Modelo, Sao Paulo, SP - CEP: 02261000 Fone: 00000000	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída Nº 000.002.422 SÉRIE:002 Folha 1 d 1	 CHAVE DE ACESSO 3524 0353 0771 9500 0134 5500 2000 0024 2215 3305 9625 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135240586858 19/03/2024 14:55:22	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 132532746115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 53.077.195/0001-34

DESTINATÁRIO / REMETENTE		C.N.P.J / C.P.F. 39.346.590/0001-44	DATA DA EMISSÃO 19/03/2024
NOME/RAZÃO SOCIAL KDN COMERCIO ATACADISTA LTDA		CEP 86191770	DATA DA ENTRADA / SAÍDA 19/03/2024
ENDEREÇO Rua da Luz, 51 - Referencia: HORARIO DE ENTREGA : 8:30 AS		BAIRRO/DISTRITO Jardim Morumbi	HORA DE SAÍDA 14:53:55
MUNICÍPIO Cambe	FONE/FAX	UF PR	INSCRIÇÃO ESTADUAL 9086460537

FATURA/DUPLICATA			

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 395,60	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 395,60

TRANSPORTADOR/VOLUME					
RAZÃO SOCIAL EBAZAR.COM.BR LTDA	FRETE POR CONTA 2 - Terceiros	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.007.331/0122-39
ENDEREÇO AVENIDA DAS NACOES UNIDAS 3000 3003	MUNICÍPIO OSASCO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 120519234116		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,180	PESO LÍQUIDO 0,180

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA				
NOME/RAZÃO SOCIAL	C.N.P.J / C.P.F.	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP		
MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
Doppler Azul	Doppler Fetal Monitoramento Portatil Batimentos Coracao Bebe	90181980	7102	6106	UN	4	98,90	395,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
Enviado diretamente do deposito temporario - operador logistico: EBAZAR.COM.BR LTDA, Cnpj: 03007331007405, Inscricao Estadual: 241174886113 saindo do endereço: Av. Antonio Candido Machado, Numero: 3100, Complemento: , Bairro: Empresarial Paineira (Jordanesia), Cidade: Cajamar, Cep: 07776037, Estado: SP, Pais: BR. Nota fiscal de retorno simbolico n 2421, emitida em 19/03/2024, serie 2, nos termos da Portaria CAT 31/2019 Valor aproximado dos tributos (IBPT) R\$113,58. Emitido por ME/EPP optante do Simples Nacional. Sem direito a credito fiscal de ICMS/ISS/IPI.		

ESPELHO DE NOTA FISCAL DE ENTRADA

Forneecedor: 373 - MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SIMILARES EIRELI - 07.760.277/0003-23

FORNECEDOR

Nfe: 19.409 Serie: 1 Modelo: 55 Emissão: 31/05/2024 Cadastro: 04/06/2024 Total: 75.975,00

Chave Nfe: 31240507760277000323550010000194091348802697

Código	Descrição	Un	Qtde	R\$ Unit	Subtotal	%Desc	R\$ Desc	Subtotal	%IPI	R\$ IPI	R\$ Total	CST	CFOP	ICMS	ST	PIS	COFINS
402	ELETROCARDIOGRAFO ECG 300G	UN	25	3.000,0000	75.000,0000	0,0000	0,00	75.000,0000	1,30	975,0000	75.975,0000	600	2102	9.000,00	0,00	429,00	1.980,00
Lote: 300023		Fab: 10/04/2024		Val: 10/08/2059		Qtde: 25											
Total produtos:				75.975,00	BC ICMS:		75.000,00										
Frete:				0,00	R\$ ICMS:		9.000,00										
Desconto:				0,00	BC ICMS ST:		0,00										
Despesas:				0,00	R\$ ICMS ST:		0,00										
Desp Rateio:				0,00													
Total Nota:				75.975,00													

Observações:

FLS. 189

ESPELHO DE NOTA FISCAL DE ENTRADA

Forneceador: 373 - MEDMAX - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS E SIMILARES EIRELI - 07.760.277/0003-23

FORNECEDOR

Nfe: 20.743 Serie: 1 Modelo: 55 Emissão: 31/10/2024 Cadastro: 07/11/2024 Total: 12.156,00

Chave Nfe: 31241007760277000323550010000207431143343084

Código Descrição	Un	Qtde	R\$ Unit	Subtotal	%Desc	R\$ Desc	Subtotal	%IPI	R\$ IPI	R\$ Total	CST	CFOP	ICMS	ST	PIS	COFINS
276 DETECTOR FETAL DE BOLSO - CONTEC 10C	UN	50	240,0000	12.000,0000	0,0000	0,00	12.000,0000	1,30	156,0000	12.156,0000	600	2102	1.440,00	0,00	68,64	316,80
Lota: 4984984 Fab: 10/09/2024 Val: 10/09/2059 Qtde: 50																
Total produtos:		12.156,00	BC ICMS:	12.000,00												
Frete:		0,00	R\$ ICMS:	1.440,00												
Desconto:		0,00	BC ICMS ST:	0,00												
Despesas:		0,00	R\$ ICMS ST:	0,00												
Desp Rateio:		0,00														
Total Nota:		12.156,00														

Observações:

FLS. 00790

MODELO FILIAL	ORCAMENTO N° 0030807
AV SAO FRANCISCO 1920 TANCREDO NEVES TERESINA-PI CEP: 64075-520	Data : 12/12/2024
Fone: (86) 3237-0864 Fax: () - CNPJ: 23.511.454/0002-03 I.E.: 195401930	Loja : 02

Cliente : DYNAMIC MED DIST.DE MEDIC.E PROD.HOSP.LTD	Codigo : 02006108	CNPJ/CPF : 02.770.479/0001-70
Endereco : RUA DA PICARREIRA 30	BAIRRO : FUMO VERDE	Insc.Est/Ident: 127550968
Cidade : CAXIAS-MA	CEP : 65607-760	FONE: (99)98272-2663

Codig Und	Qtde	Descricao do Item	Referencia	Valor Unit. Desc%	Valor Total
00117 UN	1,000	NEGATOSCOPIO DE 02 CORPO PINTADO	MMH-196	551,000	551,00

Plano de Pagto: ORCAMENTO	Prazo de Entrega : 12/12/2024	Horas:	Valor dos Itens	551,00
	Validade : 16/12/2024		Desconto	
Entrada :			Acred. Financeiro	
Parcelas : x	Vendedor: INES		T O T A L	551,00

DESPACHO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 03208/2024.

PREGÃO ELETRONICO Nº.0053/2024.

OBJETO: *Aquisição de equipamento e material permanente para as Unidades básicas de Saúde, pertencentes a Rede Municipal de Saúde de Caxias - MA..*

AO

SR. ELI MARCOS SANTANA FARIAS

COORDENADOR ADMINISTRATIVO


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Encaminhamos os autos do Processo Administrativo nº. 03207/2024, que deu origem ao Pregão Eletrônico nº.053/2024, para análise e parecer técnico na apresentação dos catálogos e folhetos se estão de acordo com Termo de Referência e do Setor solicitante da Secretaria Municipal de Saúde de caxias – MA.

Referente aos itens :

- 08, 049, 050,094 e 0131 da licitante: B.D.R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ: 52.496.119/0001-09, conforme segue.

Caxias – MA, 20 de dezembro de 2024.

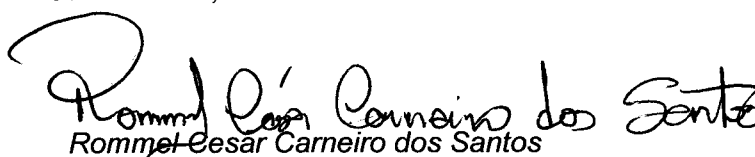

Rommel Cesar Carneiro dos Santos

Pregoeiro – Comissão de Contratação

DESPACHO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 03208/2024.

PREGÃO ELETRONICO Nº.0053/2024.

OBJETO: *Aquisição de equipamento e material permanente para as Unidades básicas de Saúde, pertencentes a Rede Municipal de Saúde de Caxias - MA..*

AO

SR. ELI MARCOS SANTANA FARIAS

COORDENADOR ADMINISTRATIVO


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Encaminhamos os autos do Processo Administrativo nº. 03207/2024, que deu origem ao Pregão Eletrônico nº.053/2024, para análise e parecer técnico na apresentação dos catálogos e folhetos se estão de acordo com Termo de Referência e do Setor solicitante da Secretaria Municipal de Saúde de caxias – MA.

Referente aos itens :

- 17, 25, 31 da licitante: VIMASI – DISTRIBUIDORA DE , CNPJ: 29.576.243 /0001- 54, conforme segue.

Caxias – MA, 20 de dezembro de 2024.

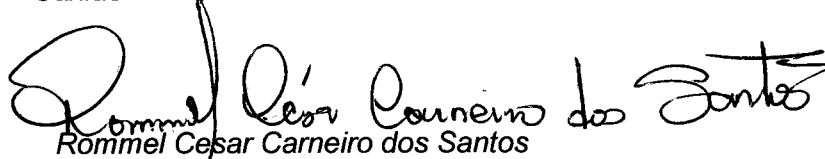
Rommel Cesar Carneiro dos Santos
Pregoeiro – Comissão de Contratação

DESPACHO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 03208/2024.

PREGÃO ELETRONICO Nº.0053/2024.

OBJETO: *Aquisição de equipamento e material permanente para as Unidades básicas de Saúde, pertencentes a Rede Municipal de Saúde de Caxias - MA..*

AO

SR. ELI MARCOS SANTANA FARIAS

COORDENADOR ADMINISTRATIVO


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Encaminhamos os autos do Processo Administrativo nº. 03207/2024, que deu origem ao Pregão Eletrônico nº.053/2024, para análise e parecer técnico na apresentação dos catálogos e folhetos se estão de acordo com Termo de Referência e do Setor solicitante da Secretaria Municipal de Saúde de caxias – MA.

Referente aos itens :

- 61,66,68,69,74,106,114,115,118,124,129 da licitante: K.N.D. COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ: 39.346.590/0001-44, conforme segue.

Caxias – MA, 20 de dezembro de 2024.

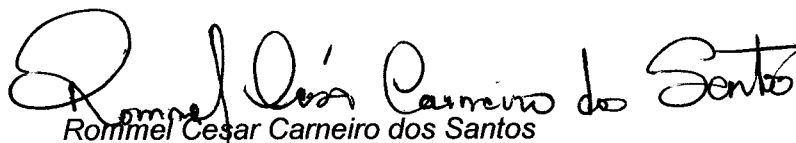
Rommel Cesar Carneiro dos Santos
Pregoeiro – Comissão de Contratação

DESPACHO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 03208/2024.

PREGÃO ELETRONICO Nº.0053/2024.

OBJETO: *Aquisição de equipamento e material permanente para as Unidades básicas de Saúde, pertencentes a Rede Municipal de Saúde de Caxias - MA..*

AO

SR. ELI MARCOS SANTANA FARIAS

COORDENADOR ADMINISTRATIVO


SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

Encaminhamos os autos do Processo Administrativo nº. 03207/2024, que deu origem ao Pregão Eletrônico nº.053 /2024, para análise e parecer técnico na apresentação dos catálogos e folhetos se estão de acordo com Termo de Referência e do Setor solicitante da Secretaria Municipal de Saúde de caxias – MA.

Referente aos itens :

- 07,16 da licitante: EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI, CNPJ: 39.346.590/0001-44, conforme segue.*

Caxias – MA, 20 de dezembro de 2024.

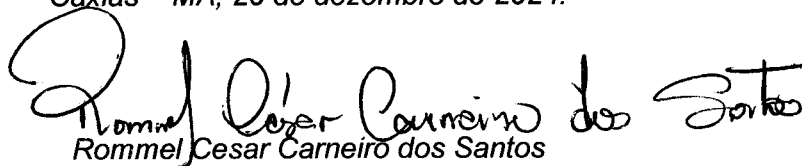
Rommel Cesar Carneiro dos Santos
Pregoeiro – Comissão de Contratação

ITEM 07

CCL
FLS. 986

Especificações Técnicas

MODELO: DPR CL BABY 15KGX5G PESADORA CRISTAL BRANCA

CÓDIGO: 4026


Código EAN: 7898579862197

NCM: 8423.1000

Garantia: 12 Meses

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS

Balança Pesadora BABY - 15kg x 5g - 1500g x 500g x 250g - São Inmetro - Ramuza;
Possui a capacidade de pesagem de 15kg;
Visor para a peso;
Display Cristal Líquido, ideal para ambientes industriais;
Balança totalmente instalada em uma única peça, com trava de segurança;
resistente a choques, economizando no frete;
Acabamento esmerilhado;
Cuba baby com dimensões C 380 x L 300 x A 250 (mm);
Não necessita de bateria;
Facilidade para design gracioso e de fácil operação;
Possui 4 teclas de fácil digitação e um botão para confirmar a operação.

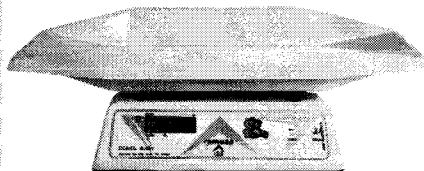

Capacidade (kg)	15 kg
Divisão (g)	5 g
Intervalo de pesagem (g)	100 g
Dimensão da balança (mm) - Completa	C 620 x L 420 x A 250
Peso	9,995 kg
Display	6 Dígitos
Alimentação	Fonte Externa - Entrada Bivolt Automático para 110/220 VCA com tolerância de -15% a + 10%; Saída de 7,7 VDC/500mA - Comprimento cabo de alimentação: 1 metro
Frequência	50/60Hz
Consumo (Watt) por hora	4W
Interface de Comunicação	Não se aplica
Temperatura de Operação	De 0° a 40°C
Teclado	4 Teclas de Fácil Digitação
Modelo	Modelo aprovado pela Portaria 236
Aferição	AFERIDA POR: Instituto de Pesos e Medidas do Estado de S. Paulo - IPEM
OBSERVAÇÃO	Pés reguláveis revestidos de material antiderrapante; Medida Régua Antropométrica: 540mm; Medida Colchão: 540mm x 265mm;
Tamanho e peso da caixa (LxLxA) (mm)	C 370 x L 350 x A 160 - 5 kg

RAMUZA IND COM BALANÇAS LTDA - C.N.P.J. 49.716.616/0001-52 - I.E. 623.002.413.112

Estrada Marica Marques, 746 - Santana de Parnaíba - SP - CEP 06529-210

E-mail ramuza@ramuza.com.br - Fone: 11 4156-9797

VISITE www.ramuza.com.br

ITEM 16

CCL	
FLS.	792



DOPPLER FETAL PORTÁTIL FD-200

Manual de Instruções

1. SEGURANÇA GERAL	4
1.1 AVISOS.....	4
2. VISÃO GERAL	6
3. CARACTERÍSTICAS	6
4. INDICAÇÃO DE USO.....	7
5. APRESENTAÇÃO GERAL	7
6. VISORES.....	7
6.1. VISOR MODELO FD-200A	7
6.2. VISOR MODELO FD-200C	8
6.3. VISOR MODELOS FD-200B E FD-200D	8
7. TECLAS E LUZES INDICADORAS.....	8
7.1. AJUSTE DO VOLUME	8
7.2. LIGA/DESLIGA.....	8
7.3. MODO DE CONFIGURAÇÃO	8
7.4. SELECIONANDO O MODO	8
7.5. LUZ DE INDICAÇÃO	9
7.6. TRANSDUTORES	9
8. INSTRUÇÕES DE USO	9
8.1. UTILIZANDO A PILHA OU BATERIA.....	9
8.1.1.SUBSTITUINDO OU CARREGANDO A BATERIA.....	9
8.2. OPERANDO O TRANSDUTOR	9
8.3. LIGANDO O EQUIPAMENTO	10
8.4. CONFIGURANDO OS MODOS DE OPERAÇÃO	10

8.4.1. MODOS DE OPERAÇÃO	10
8.4.2. SELECIONANDO OS MODOS	10
8.5. CONFIGURANDO PARÂMETROS	10
9. INSPECIONANDO A FHR.....	11
9.1. USO DO GEL	11
9.2. ENCONTRANDO A POSIÇÃO DO FETO	11
9.3. INSPECIONANDO A FHR	11
9.4. LIMPEZA APÓS O USO	11
9.5. GRAVAR, REPRODUZIR E TRANSFERIR.....	12
10. LIMPEZA	12
10.1. DESINFECÇÃO.....	12
11. MANUTENÇÃO	12
12. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS.....	12
13. ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO	13
13.1 CONDIÇÕES AMBIENTAIS	13
14. GARANTIA.....	13
15. ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA	14
16. ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO.....	14
17. SENSIBILIDADE GERAL	15
18. SIMBOLOGIA.....	16
18.1 SIMBOLOGIA NO EQUIPAMENTO.....	16
18.2. SIMBOLOGIA NA EMBALAGEM	17
19. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE ELETROMAGNÉTICA	18

1. SEGURANÇA GERAL

Antes de utilizar o **Doppler Fetal Portátil FD-200 MD**, leia cuidadosamente este manual e certifique-se de estar familiarizado com os controles, exibições do visor, recursos e técnicas de operação.

Examine cuidadosamente o **Doppler Fetal Portátil FD-200 MD** (referido adiante somente como equipamento) e seus acessórios para certificar que a unidade principal e acessórios não possuem nenhum dano visível que possa afetar a segurança do paciente e o desempenho do equipamento. O período recomendado para examiná-lo é uma vez por semana.

O equipamento não é compatível para uso em ambientes com equipamentos cirúrgicos elétricos.

O equipamento é usado para detecção da frequência cardíaca fetal e não é indicado para nenhum tratamento. Se o resultado do teste de FHR não for confiável ou útil, utilize outro método.

A instalação, ajuste, manutenção ou reparo somente pode ser realizado por equipe qualificada ou autorizada pelo fabricante.



1.1 AVISOS

ATENÇÃO

Contém informações importantes sobre um possível perigo para o operador do equipamento, ou para o paciente que está presente durante a operação normal do equipamento.

CUIDADO

Fornecer informações ou instruções que devem ser seguidas para garantir a operação e desempenho do equipamento adequadamente.

NOTA

Apresenta uma informação que ajudará a operar o equipamento ou os dispositivos conectados a ele.

ATENÇÃO!

- O **Doppler Fetal Portátil FD-200 MD** utiliza doppler ultrassônico de muito baixa energia. Isto é confirmado pelo projeto de cálculo, teste de laboratório, teste clínico e aplicação clínica que a energia do doppler é segura para fetos, gestantes e demais pessoas.
- Este equipamento não é à prova de explosão e não pode ser utilizado na presença de equipamentos anestésicos inflamáveis.
- Não jogue a bateria no fogo visto que pode explodir e causar dano.
- Não tente recarregar pilhas normais visto que podem vaziar e causar incêndio ou mesmo explosão.
- Utilize somente adaptadores em conformidade com a IEC 60950.
- Não toque simultaneamente na entrada/saída de sinal do conector e no paciente para evitar danos ao equipamento.
- Acessórios e equipamento conectados à interface analógica e digital devem ser certificados de acordo com a respectiva norma IEC.
- A bateria deve ser retirada do equipamento se este não for utilizado por um longo período de tempo.
- O operador não deve entrar em contato com o paciente quando estiver trocando a bateria ou abrindo a tampa de cobertura da bateria.

- O equipamento é um instrumento para auxiliar na detecção de FHR e não deve ser utilizado no lugar de monitoramento fetal normal.
- A substituição da bateria deve ser realizada somente em ambiente distante do paciente (pelo menos 1,5m de distância).
- Por favor, utilize somente transdutores fornecidos pelo fabricante.
- Não estenda o fio do transdutor mais que 2 metros visto que o transdutor pode se desprender do conector do equipamento.
- O equipamento está projetado para operação contínua e em condições habituais. Não imergir em nenhum líquido (não é à prova de gotejamento ou respingos).
- Mantenha o equipamento limpo. Evite vibrações.
- Não utilize nenhum processo de esterilização por alta temperatura ou esterilização por radiação gama.
- O equipamento não está sujeito a nenhuma fonte de interferência eletromagnética forte, como transmissores de rádio e telefones móveis devido à interferência eletromagnética.
- O usuário deve verificar se o equipamento não apresenta nenhum dano visível de modo que possa afetar a segurança do paciente ou capacidade de monitoramento antes do uso. O intervalo recomendado para inspeção é uma vez ao mês ou antes. Se o dano está evidente, é recomendada a substituição antes do uso.
- O equipamento não deve ser usado quando alguns equipamentos estão em uso como gerador elétrico de alta frequência, forno de micro-ondas e telefone móvel.
- Não use o equipamento na presença de mistura de anestésicos inflamáveis com oxigênio ou outros agentes inflamáveis.
- O equipamento está projetado para operação em curto intervalo de tempo.
- Por favor, pare de utilizar o equipamento para arrumar adequadamente se alguma parte do equipamento não está apropriadamente fixada, como por exemplo, a cobertura da bateria.
- O equipamento é adequado para uso domiciliar e instituições que não possuem responsáveis com habilidades especiais, treinamento e conhecimento.
- Este manual de operação está escrito em um nível descomplicado, de fácil compreensão, para pessoas que não possuem treinamento ou conhecimento especial. Para utilização em hospitais e clínicas, o operador precisa ter certificado de qualificação. Para uso doméstico, quando as informações são usadas para diagnóstico, é necessário que a análise seja feita por um médico pessoal especializado.
- Esta qualificação mínima de serviço deve ser familiar para a operação do aparelho e técnicas de serviço.
- A seguinte lista de verificação de segurança deve ser realizada a cada 6 (seis) meses ou como especificado nos testes e protocolos de inspeção da instituição por pessoal qualificado, com treinamento adequado, conhecimento e experiência prática para realização.
 1. Inspeção o equipamento para possíveis danos mecânicos e funcionais.
 2. Inspeção as etiquetas de segurança e legitimidade.
 3. Verifique se o equipamento funciona apropriadamente como descrito no manual de operação.
 4. O teste de corrente de fuga do paciente de acordo com a IEC 60601-1 é limitado até 100µA. A corrente de fuga nunca deve exceder o limite. Se o equipamento não funcionar adequadamente ou falhar em qualquer dos testes acima, o equipamento deve ser reparado.

! CUIDADOS

- As pilhas devem ser adequadamente descartadas de acordo com os regulamentos locais após o uso.
- As pilhas devem ser retiradas do equipamento se o mesmo não for utilizado por um longo período.
- O equipamento só deve ser usado quando a cobertura do compartimento da pilha estiver fechada.
- As pilhas devem ser armazenadas em lugar seco e fresco.
- Se utilizar baterias recarregáveis, certifique-se da capacidade e vida útil, carregue-as totalmente antes do primeiro uso. Normalmente as baterias podem ser carregadas continuamente por 2 horas ou conforme orientações dispostas na própria bateria.
- Por favor, não coloque os polos negativo e positivo da bateria incorretamente.
- As informações deste manual estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- Não utilize solventes fortes (acetona, por exemplo) e materiais abrasivos para limpar o equipamento.
- Não permita que nenhum líquido penetre no equipamento e não emergir nenhuma parte do equipamento em nenhum líquido.
- Por favor, escolha acessórios e extensões autorizados pelo fabricante.
- Nunca tente esterilizar o transdutor ou o equipamento por vapor a baixa temperatura ou outros métodos.

2. VISÃO GERAL

O Doppler Fetal Portátil FD-200 MD é um detector da frequência cardíaca fetal de alta performance que satisfaz as exigências para exame de FHR em hospitais, clínicas, comunidades e uso domiciliar.

O equipamento consiste em um emissor e receptor de sinal ultrassônico, unidade de processamento de computador, visor LCD, alto-falante, teclas operacionais e fonte de alimentação.

3. CARACTERÍSTICAS

Cada modelo do Doppler Fetal possuem diferentes características como indicadas abaixo.

Função	FD-200A	FD-200B	FD-200C	FD-200D
Visor de LCD	Não	P/B	Colorido	P/B
Luz de Fundo	Não	Sim	Sim	Sim
Alto-falante	Sim	Sim	Sim	Sim
Modos de Visualização	Não	Não	Sim	Não
Ajuste de Volume	Sim	Sim	Sim	Sim
Indicador de carga da bateria / pilha	Não	Sim	Sim	Sim
Visor da FHR	Não	Sim	Sim	Sim
Curva da FHR	Não	Não	Sim	Não
Desligamento automático	Não	Sim	Sim	Sim
Modos de operação	Não	Sim	Sim	Sim
Pilhas	Sim	Sim	Sim	Sim
Bateria recarregável	Não	Não	Sim	Sim
Carregador interno	Não	Não	Sim	Sim
Fones de ouvido	Opcional			
Bolsa de transporte	Opcional			
Transdutor 2.0 Mhz	Incluso			
Transdutor 2.5 Mhz	Opcional			
Transdutor 3.0 Mhz	Opcional			


4. INDICAÇÃO DE USO

O **Doppler Fetal Portátil FD-200 MD** é utilizado para detecção da frequência cardíaca fetal. O equipamento pode ser utilizado por profissionais da saúde com técnicas especializadas em hospitais, clínicas, comunidades e domiciliar.

Troca fácil do transdutor através da conexão de engate rápido. Transdutores de 2.0MHz, 2.5MHz e 3.0MHz são utilizados para detecção da FHR.

5. APRESENTAÇÃO GERAL

A	Doppler Fetal
B	Visor
C	Indicador de funcionamento
D	Tecla Liga/Desliga
E	Alto-falante
F	Transdutor
G	Indicador de carga*
H	Tecla diminuir volume
I	Tecla aumentar volume
J	Entrada DC*
K	Entrada para fones de ouvido
L	Conector do transdutor

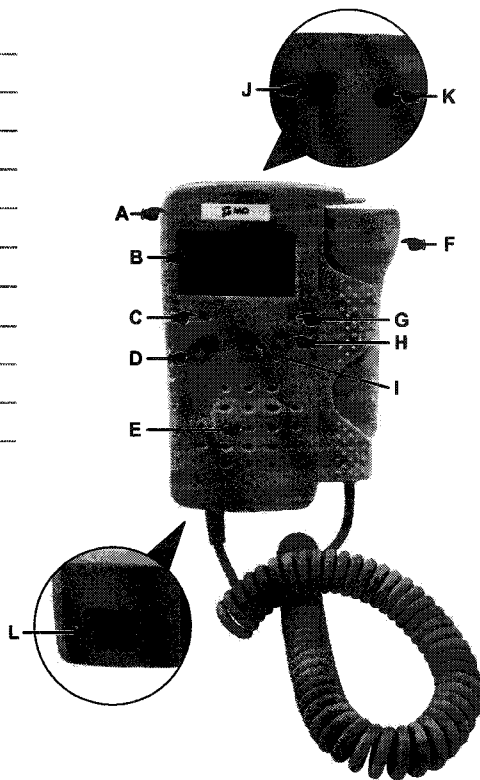

*disponíveis em alguns modelos, consultar modelo em tabela de características


6. VISORES

6.1. VISOR MODELO FD-200A

O modelo **Doppler Fetal Portátil FD-200A MD**, não possui visor com função.


6.2. VISOR MODELO FD-200C

- A Volume de Voz
- B Batimento por minuto da FHR.
- C Alarma Ligado/Desligado
- D Sinal da FHR. Este sinal pisca com o batimento cardíaco
- E Modo de trabalho
- F Frequência do transdutor
- G Carga da bateria

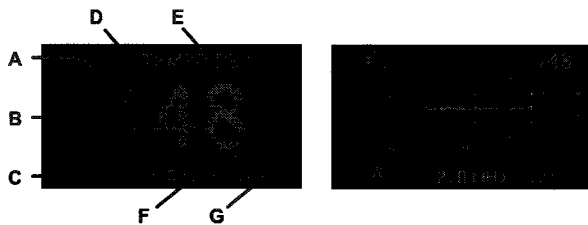

6.3. VISOR MODELOS FD-200B E FD-200D

- A Sinal da FHR. Este sinal pisca com o batimento cardíaco
- B Modo de trabalho
- C Unidade de batimento por minuto da FHR
- D Carga da bateria
- E Intensidade de sinal da FC
- F Alarma Ligado/Desligado
- G Batimento por minuto da FHR.

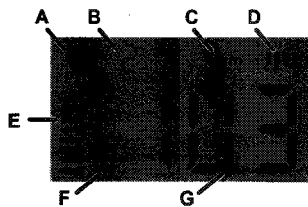

7. TECLAS E LUZES INDICADORAS

7.1. AJUSTE DO VOLUME

Diminuir Volume: Quando o equipamento está ligado, se o som está muito alto, pressione a tecla o volume será reduzido.

Aumentar Volume: Quando o equipamento está ligado, se o som está muito baixo, pressione a tecla o volume será aumentado.

7.2. LIGA/DESLIGA

Pressione a tecla para ligar o equipamento e pressione a mesma tecla por 3 segundos para desligar.

7.3. MODO DE CONFIGURAÇÃO

Quando o equipamento é ligado, pressione a tecla uma vez, o símbolo do código do modo de operação piscará, isso significa que o modo pode ser selecionado.

7.4. SELECIONANDO O MODO

Quando o símbolo do modo estiver piscando, pressione a tecla uma vez para selecionar o modo. O equipamento vai operar sob o modo configurado e exibido.

7.5. LUZ DE INDICAÇÃO

Luz indicadora de carga da bateria: Há uma luz indicadora de carga abaixo do visor com a indicação de uma pilha ao lado. Quando a bateria é carregada, a luz indicadora é exibida na cor laranja. Quando a carga da bateria está completa, a luz indicadora torna-se verde.

Luz indicadora de funcionamento: Quando o equipamento for ligado acenderá uma luz indicadora verde ou azul, dependendo do modelo, acima do botão Liga/Desliga.

7.6. TRANSDUTORES

A frequência básica do transdutor é 2.0MHz ($\pm 10\%$). As frequências de 2.5 MHz e 3.0MHz ($\pm 10\%$) são opcionais.

8. INSTRUÇÕES DE USO

Cuidadosamente verifique se o equipamento não tem nenhum dano e os acessórios estão íntegros. Se encontrar algum dano, contate imediatamente o fabricante ou distribuidor local autorizado.

8.1. UTILIZANDO A PILHA OU BATERIA

Troca das Pilhas ou Bateria: Vire o painel posterior para cima. Segure a unidade principal com uma das mãos. Pressione a tampa do compartimento da bateria com o polegar da outra mão. Deslize a tampa ao longo da unidade de modo a permitir a retirada das pilhas ou bateria.

Insira as Pilhas ou Bateria na porta de entrada,

Deslize a tampa da bateria, deslize a tampa em direção ao topo do corpo do dispositivo até fechar o compartimento.

8.1.1. SUBSTITUINDO OU CARREGANDO A BATERIA

Quando a carga da bateria do equipamento estiver baixa desligue o dispositivo e substitua ou carregue a bateria.

Para carregar a bateria recarregável, insira o plugue DC do carregador na porta de entrada de carga do equipamento e conecte o plugue AC na fonte de alimentação de 100-240 VAC, 50/60 Hz.

O tempo para a carga total da bateria levará cerca de 2 horas. Enquanto estiver carregando, a luz LED do carregador ficará laranja; quando a bateria estiver totalmente carregada a luz de LED ficará verde.

⚠ ATENÇÃO!

- Quando em funcionamento, as baterias recarregáveis não podem ser recarregadas. Quando as baterias recarregáveis estiverem recarregando o equipamento não pode operar.
- O equipamento somente pode ser utilizado quando o carregador for desconectado do equipamento.

8.2. OPERANDO O TRANSDUTOR

Segure a unidade principal do equipamento com uma das mãos, segure a parte de cima do transdutor e retire-o por completo do compartimento.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Dermatoscópio Missouri

ref.500/501




Imagem Ilustrativa

Dermatoscópio Missouri, é um aparelho médico utilizado na Dermatoscopia (também conhecido como Dermoscopia ou Microscopia Epiluminescência) é uma ferramenta essencial para Dermatologistas, Cirurgiões plásticos, Clínicos Gerais e outros profissionais de saúde que procuram obter o diagnóstico precoce de melanoma.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1. Dermatoscópio Missouri® com aumento de 8x ou 10x;
 1. Manual de instruções com validade do produto e Certificado de garantia;
- Acondicionado em estojo de papelão com berço de acomodação.
- Opcional: Suporte com lente graduada.

Acabamento:	Metal Cromado
Marca:	Missouri
Lâmpada:	LED
Temperatura de cor:	4.000 K (Kelvin) Branco Neutro
Fluxo Lumínoso:	18.000 mCd (milCandelas)
LUX:	7.500
Tensão Elétrica:	3,2V (Volts)
Corrente Elétrica:	20mA (milAmperes)
Vida útil:	20.000 horas
Funcionamento:	2 Pilhas Alcalinas (Tamanho C) *Não acompanha o produto
Visor:	Liso *Opcional: Graduado
Lente Zoom:	Até 8x *Opcional: 10x
Dimensões do Produto:	188mm x Ø30mm
Dimensões da embalagem:	225mm x 130mm x 50mm
Peso:	214g (sem pilhas)
Peso da embalagem:	269g
Registro Ministério da Saúde/ANVISA:	80218930002
Validade:	Indeterminada
Garantia:	01 Ano contra defeitos de fabricação



PREÇO SOB CONSULTA

DESCRIÇÃO GERAL**AVALIAÇÕES**

O Estadiômetro portátil Welmy é um equipamento utilizado para medir a estatura de adultos e crianças. É uma ferramenta de alta qualidade fabricada por brasileira com mais de 40 anos de experiência no mercado de equipamentos de pesagem e medição.

O Estadiômetro portátil Welmy é leve e fácil de transportar, permitindo que ele seja usado em diversos locais, como consultórios médicos, hospitais, etc, projetado para ser fixado na parede ou móvel em qualquer superfície, permitindo que o profissional de saúde realize medições precisas.

O estadiômetro tem uma régua graduada em centímetros, que vai de 20 a 200 cm, permitindo a medição da estatura de adultos e crianças. Além disso encaixe e desencaixe rápido, que facilita a montagem e desmontagem do equipamento.

O Estadiômetro portátil Welmy é uma excelente opção para profissionais da saúde que precisam realizar medições de estatura em diferentes locais. Ele usar, tornando-se uma escolha popular em todo o Brasil.

CARACTERÍSTICAS

- Campo de uso de 5cm até 2,00 m;
- Resolução em milímetros;
- Tolerância de ± 2 mm em 2,00 m;
- Matéria prima: Tubo Alumínio polido e anodizado;
- Escala litografada;
- Acompanha Manual de instruções para instalação;
- Garantia de 1 ano;
- Marca WELMY, fabricante WELMY, procedência nacional.

08, 50, 94, 131

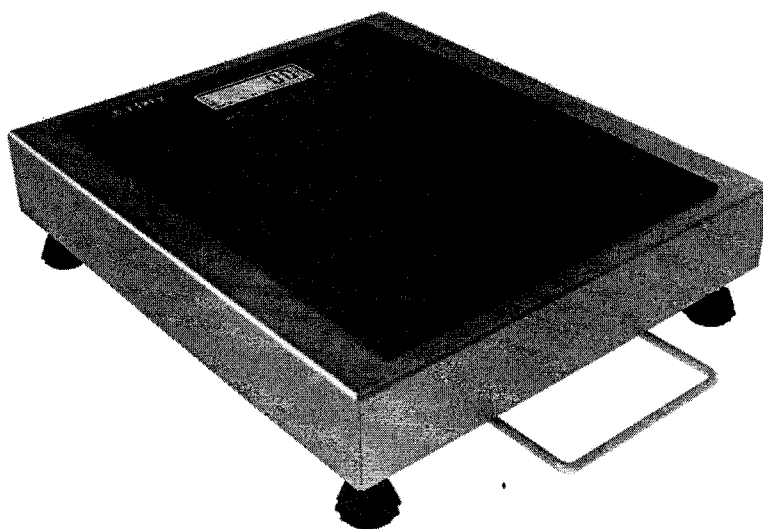


Imagem meramente ilustrativa.

Série P150M – P180M – P200M balanças portáteis, para 150kg, 180kg e 200kg.

A Líder Balanças traz as linhas P150M/P180M/P200M as quais são balanças portáteis digitais, como um produto de alta tecnologia, excelente qualidade e confiabilidade, além de possuir grande facilidade de uso e precisão. Nosso produto foi criado obedecendo as mais rigorosas normas técnicas e está aliado a uma experiência no mercado de mais de seis décadas, dedicadas exclusivamente à medição de massa e aplicadas à satisfação das necessidades de nossos clientes.

As balanças P150M/P180M/P200M são compostas por um sistema eletrônico dedicado a operações de pesagem de pessoas, e de fabricação nacional. Ela é ideal para ser utilizada em clínicas médicas, farmácias, drogarias, hospitais, academias, residências, etc. Possui bolsa para transporte do produto opcional.

Possui capacidades para 150, 180 e 200kg. É um equipamento construído com uma célula de carga central, com 5 limitadores de proteção contra sobrecarga podendo chegar até 150% da capacidade sem danos ao sensor, o sistema conta com correção automática de temperatura, inibindo totalmente possíveis erros na medição. É um produto fabricado em aço carbono ou aço inoxidável, equipada com pés de borrachas ajustáveis, possui tapete de borracha antiderrapante personalizado, alça de transporte, display de cristal líquido com 6 dígitos e altura de 15mm e alimentação interna por bateria de lítio com 3,6V.

Principais benefícios

- Facilidade de instalação e operação;
- Comodidade para transporte e locomoção por ser leve e compacta;
- Simplicidade, robustez e baixo custo de manutenção;
- Baixo consumo de energia;
- Longa autonomia em bateria e recarga rápida;
- Assistência técnica em todo o Brasil;

Este produto foi desenvolvido sob um rigoroso critério de precisão, conforme Portaria 236/94 do INMETRO.

Especificações Gerais

Classe de exatidão	Classe III, conforme portaria 236/94 do INMETRO.
Divisão mínima	50 a 100g
Capacidade	Modelo P150M 150kg Modelo P180M 180kg Modelo P200M 200kg
Display	Display de cristal líquido, com 6 dígitos, 7 segmentos mais ponto decimal e dígitos com dimensões de 15mm x 7,0mm.
Acabamento/Estrutura	Estrutura fabricada em aço carbono e plataforma em aço carbono ou alumínio* com piso em borracha antiderrapante, possuindo ainda alça de transporte para o produto.
Grau de Proteção	IP40 (NBR6146)
Alimentação	Bateria recarregável de Lítio de 3,6V @2600mA/h. A tensão da fonte de alimentação e recarga é universal (90 a 240Vca e 50/60Hz).
Consumo	1W Condições de uso normal; 7W Condições de uso com carregamento da bateria;
Autonomia em bateria	130 horas em uso contínuo.
Condições ambientais	Temperatura de operação -10° ~ 50°C Umidade relativa do ar 10% ~ 95% sem condensação
Indicações	Peso, zero, líquido, fixo e bateria.
Bolsa para transporte	Bolsa para transporte do produto opcional.
Dimensões	A 83 x L 300 x P 350 (Sem contar com a alça de transporte). A = Altura, L = Largura e P = Profundidade. Veja as dimensões detalhadas do produto no final deste folder.
Regulagem de altura	Pés com sistema de regulagem de altura para um perfeito nivelamento do produto.
Aprovação	Lacre de segurança emitido pelo INMETRO.


Características de Software e Funções

Manutenção de Zero	Auto Zero ao ligar
Sistema de pesagem	Possui o sistema de medida de peso central, o qual minimiza o erro de canto e variações de peso com a variação da temperatura.
Função de autodesligar	Quando a balança estiver funcionando apenas com bateria e sem peso por 5 minutos, ela é auto desligada para economizar bateria, porém, quando a balança estiver na tomada, esta função fica desativada e a balança permanecerá ligada permanentemente (até a chave liga/desliga ser pressionada).
Função mamãe bebê	Com esta função, o primeiro peso a subir na balança é zerado e o indicador de TARA fica ligado, assim que o segundo peso "entra" na pesagem o mesmo passa a ser exibido no display, sendo o processo reiniciado assim que o peso total é removido da balança.
Sobrepeso	Indicação de sobrecarga, quando o peso estiver acima da capacidade máxima calibrada mais nove divisões.
Subpeso	Indicação de subcarga, quando o peso estiver abaixo da capacidade máxima negativa calibrada, o display irá indicar subcarga.
Tipo de operação	Pesagem contínua ou Tara automática.

Principais aplicações e observações de uso

Pesagem	Pesagem de pessoas em clínicas, academias, farmácias, drogarias, hospitais, residências, etc.
Observações de uso	Para que o produto funcione corretamente, verifique todos os detalhes contidos nestas informações técnicas. Não deve haver nada encostado na parte inferior da balança nem em sua superfície durante a pesagem. Mantenha-a sempre limpa, evitando lugares úmidos, calor excessivo e produtos químicos. Recomendamos também nunca utilizar abrasivos, produtos corrosivos ou qualquer tipo de solvente químico para a limpeza do conjunto, pois isto poderá danificar o seu produto. Para limpá-la use pano umedecido e sabão neutro. Em caso de dúvidas, sempre consulte a nossa equipe técnica para auxiliá-lo.

O produto não pode ser utilizado em ambientes com atmosferas explosivas e/ou inflamáveis e também não deve ser instalado em outros ambientes que estejam fora de suas especificações nominais contidas neste folder ou manual do produto. Nunca deixe um peso sob a plataforma da balança, quando a mesma não estiver sendo utilizada.

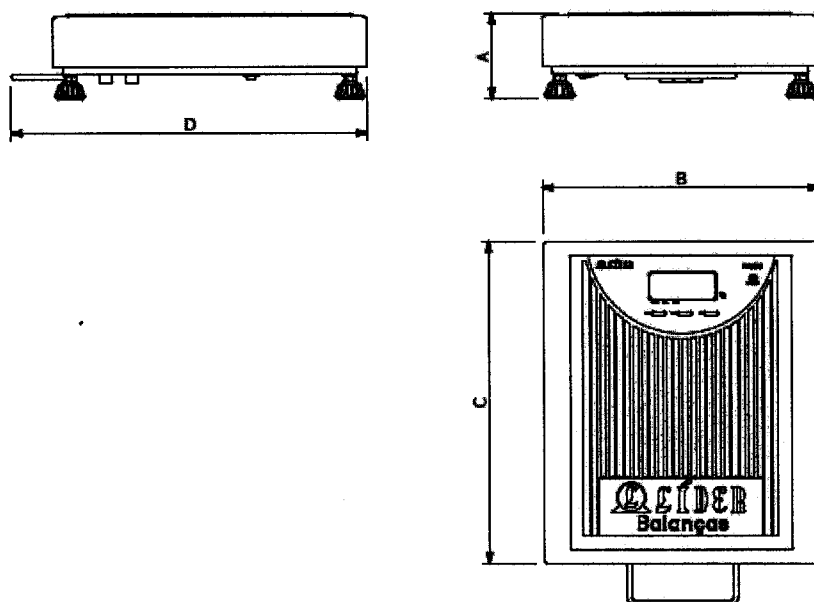Dimensional mecânico detalhado

Dimensões (cm)	Dimensões da plataforma				Capacidade e divisão mínima			
	A (cm)	B (cm)	C (cm)	D (cm)	Peso (kg)	150kg (div.50g)	180kg (div.50g)	200kg (div.50g)
28 x 32	8	28	32	36	4,5	X	X	X
32 x 35	8	30	35	39	5	X	X	X


Outras dimensões e capacidades sob consulta.

Obs: O presente catálogo não comporta todas as possibilidades e especificações disponíveis do produto, sendo que há outras possibilidades, especificações especiais, alterações de acessórios e personalização sob consulta.

Garantia

Garantia de 12 meses, conforme termo existente na proposta comercial.

Detalhes técnicos sobre o produto podem ser obtidos diretamente no site da Líder Balanças, em: <http://www.liderbalancas.com.br>, ou através do e-mail: lider@liderbalancas.com.br.

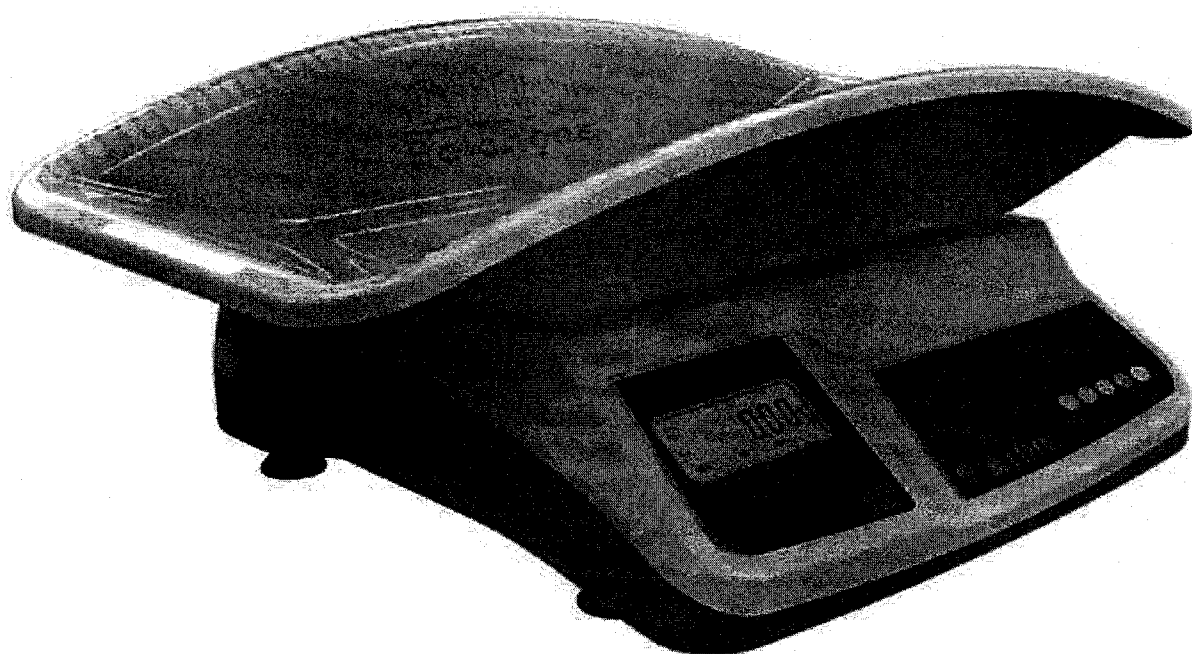

Balança LD230 Baby


Catálogo Técnico

A solução de pesagem perfeita para hospitais, clínicas e consultórios médicos

A Líder Balanças foca seus esforços para produzir soluções em pesagem para suprir as necessidades de seus clientes. Com isso desenvolveu a linha LD230 Baby que possui tecnologia inovadora que agrega agilidade, praticidade e confiabilidade nos processos de pesagem pediátricos. Amplie e melhore a rotina de sua empresa com a nossa balança LD230 Baby.

A balança pediátrica LD230 Baby, garante recursos confiáveis para a pesagem de bebês sendo um equipamento de fácil operação. A balança possui bateria interna, permite a impressão de etiquetas com as informações de peso, conta com a possibilidade de interligação com programas de controle de peso através de protocolos de comunicação RS232 com o computador, além de possuir uma gama de diversas funções desenvolvidas para agilizar o processo de pesagem.

Otimize o potencial de seus funcionários e melhore os processos de sua empresa através da linha LD230 Baby da Líder Balanças.

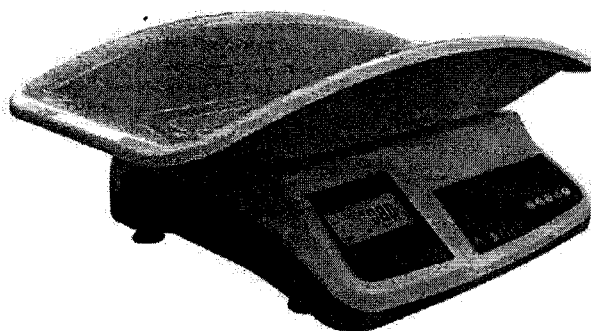



Praticidade de uso;
Facilidade de instalação e operação.




Compacta;
Comodidade para transporte e locomoção por possuir um modelo leve e compacto.

Simplicidade;
Robustez e baixo custo de manutenção, além de contar com assistência técnica especializada em todo o Brasil.


Vista Frontal *LD230 Baby*

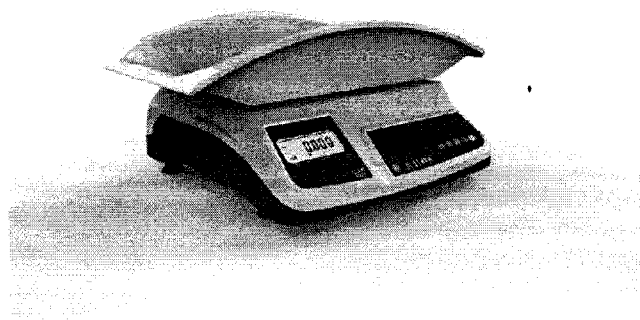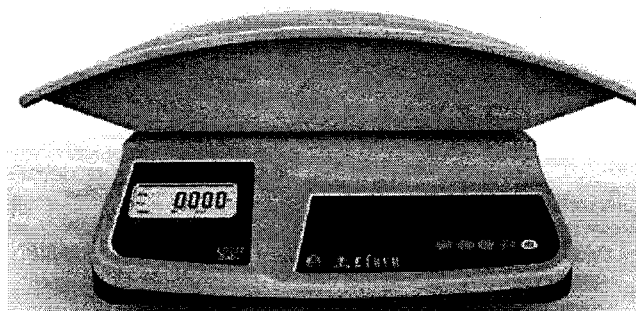

Vista Lateral

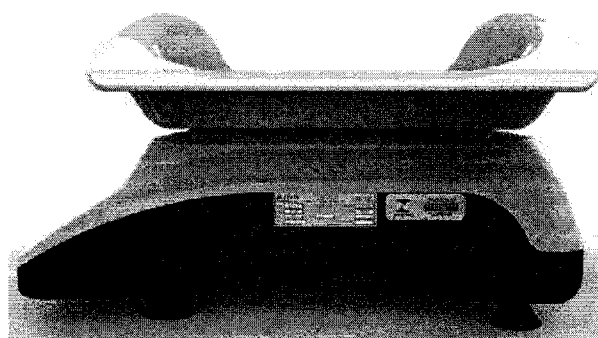


Conexões Externas

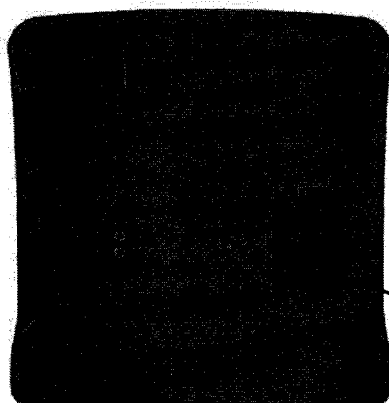


Conector de energia universal
(90 a 240 Vca e 50/60 hz 3 pinos)

Itens Opcionais LD230

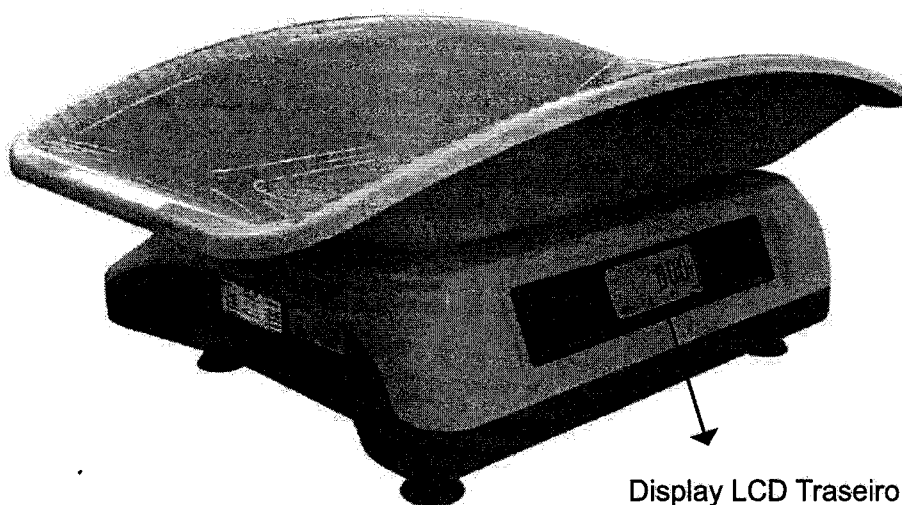

Display LCD Traseiro

Conexões Externas

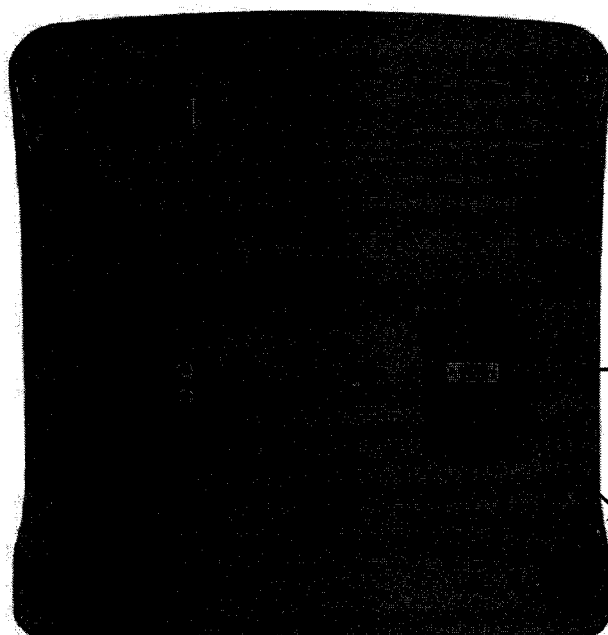

Conector DB9
Comunicação Serial
RS232

Conector de energia universal
(90 a 240 Vca e 50/60 hz 3 pinos)

Linha LD230 Baby

A linha LD230 Baby alia tecnologia de ponta, praticidade, simplicidade e robustez, sendo um sistema eletrônico destinado a operações de pesagem pediátrica em hospitais, clínicas, consultórios médicos, creches e afins.

Principais Características

A balança pediátrica LD230 Baby garante recursos confiáveis para pesagem de bebês, é de fácil operação, possui bateria interna e conta com funções como:



- Diversos tipos de tara;
- Correção automática de zero;
- Correção de zero ao ligar;
- 5 tipos de filtros digitais;
- Comunicação serial com o computador (opcional);
- Backlight inteligente;
- Régua antropométrica gravada diretamente na cuba;
- Almofada acolchoada (opcional)
- Tempo para desligar automaticamente;
- Etiqueta de Impressão do peso.

Características Técnicas

- Bateria interna (opcional);
- Tensão de alimentação: 90 a 240 Vca estável;
- Frequência de alimentação: 50/60 Hz +/- 1 Hz;
- Backlight;
- Display de Cristal líquido com 6 dígitos e com dígito de 14 mm de altura
- Saída para impressora etiquetadora térmica P560 (opcional);
- Este produto foi desenvolvido conforme a portaria 236/94 do INMETRO para classe III.
- Tamanho da embalagem: 61 x 36 x 27,5 cm;
- Peso da embalagem: 5,5 kg;
- Capacidades e divisões:

Carga Máxima (Max)	Valor de Divisão Real (d)	Carga Máxima (Min)	Número de Valores de Divisão de Verificação (n)=Max/e	Dimensões do Dispositivo Receptor de Carga
6kg	2g	40g	3000	600x350mm
10kg	2g	40g	5000	600x350mm
10kg	5g	100g	2000	600x350mm
15kg	5g	100g	3000	600x350mm
16kg	5g	100g	3200	600x350mm
20kg	5g	100g	4000	600x350mm
25kg	5g	100g	5000	600x350mm
30kg	5g	100g	6000	600x350mm

Lixeira aço inox de 30 litros com cesto
removível Healer

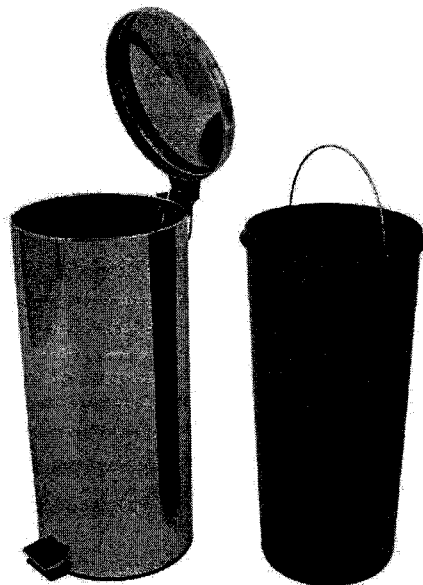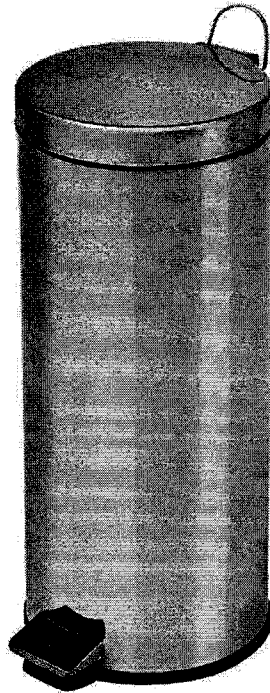

Informações do Produto

Lixeira aço inox de 30 litros com cesto removível Healer

A Lixeira Héaler em inox de 30 litros é ideal para ser utilizada em cozinha, pois, são totalmente flexível, possui balde removível e pedal que facilita o manuseio, evitando assim o contato com as mãos.

Para durabilidade do seu produto evite o contato da lixeira com água em ambientes úmidos ou externos.

Não perca tempo compre agora mesmo e garanta os 90 dias de garantia pela fábrica.

Característica

Lixeira de Aço Inox 30 Litros01

lixeira redonda

Cesto

com

alça

removível

Pedal

com

base

emborrachada

Material:

aço

inox

Capacidade

para

30

litros

Medida: 29,5 x 63cm

Balde com alça	sim
Com pedal	sim
Capacidade em L	30 litros
Balde plástico removível	sim
Altura	63 cm
Largura	29,5 cm

ESCRITÓRIO NT 2000 | NT 2000 OFFICE DESK | COD. NT2000



DIFERENCIAIS | DIFERENCIALES | DIFFERENTIALS

- Tempo de 25mm | Cuberta de 25mm | 25mm top
- Produto compacto | Produto compacto | Compact product
- Puxador em alumínio | Puxador em alumínio | Aluminium handle
- Estrutura de 12, 15 e 25mm | Marco de 12, 15 e 25mm | 12, 15 e 25mm structure

780 mm
 900 mm
 400 mm

Volumes: 1 Caixa | Caja | Box
Cubagem: 0,038 m³
Peso: 16 kg

Preço Sugerido
R\$ 372,00

LINHA DIAGNÓSTICA OMNI 3000 MD®

Otoscópio Omni 3000



O OMNI 3000 É UM OTOSCÓPIO POCKET QUE VERDADEIRAMENTE CABE NO SEU BOLSO!!

- Transmissão da luz por fibra óptica, sem obstruções, sem reflexos e sem aquecimento
- Cabeça em ABS e aço inox, altamente resistente à impactos e corrosões
- Lente giratória permite instrumentação e amplo campo de visão com aumento de 3x
- Conexão para pera de insuflação, possibilita avaliar a mobilidade da membrana timpânica (pera opcional)
- Espéculos disponíveis em diversos tamanhos e modelos, descartáveis e reutilizáveis
- Cabo em aço inox com revestimento termoplástico reforçado
- Clip de metal com interruptor integrado proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso
- Alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo AA
- Lâmpada Xenon Halógena ou LED, proporcionam luz mais branca e brilhante, projetando a verdadeira cor do tecido
 - » Lâmpada Xenon Halógena 2.5V
 - » Lâmpada LED 2.5V com vida útil de 50.000 horas




LED


* coloridos apenas na versão LED

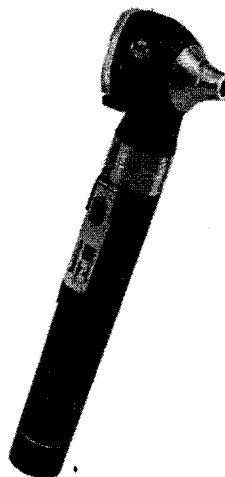

Pera insufladora (opcional)



Espéculos disponíveis em diversos tamanhos




Iluminador de garganta (opcional)

Oftalmoscópio Omni 3000

O OMNI 3000 É UM OFTALMOSCÓPIO POCKET QUE VERDADEIRAMENTE CABE NO SEU BOLSO!!

- 19 lentes de -20 a +20 dioptrias com marcador iluminado
- Óptica selada à prova de poeiras
- Borracha de proteção evita riscar a lente dos óculos
- Cabeça em ABS, resistente à impactos
- Cabo em aço inox com revestimento termoplástico reforçado
- Clip de metal com interruptor integrado proporciona desligamento automático ao ser fixado no bolso
- Alimentação através de 2 pilhas alcalinas tipo AA
- Seleção de 5 aberturas, com filtro verde livre de vermelho
- Lâmpada Xenon Halógena ou LED, proporcionam luz mais branca e brilhante
 - » Lâmpada Xenon Halógena 2.5V
 - » Lâmpada LED 2.5V com vida útil de 50.000 horas

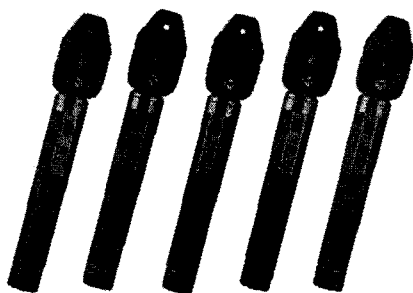


LED

+	0	1	2	3	4	6	8	10	15	20
-	1	2	3	4	6	8	10	15	20	

19 lentes



5 aberturas selecionáveis

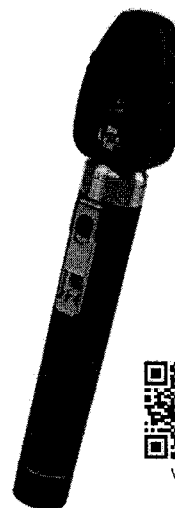


VÍDEO



Renascer
móveis hospitalares

CCL
FLS. 820
A

11A

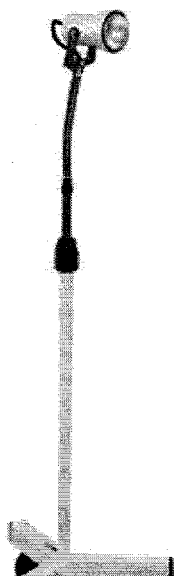

LUMINÁRIA FLEXÍVEL ESMALTADA

DESCRIÇÃO

RN14026R – LUMINÁRIA FLEXÍVEL ESMALTADA


- Base em tripé de tubo de aço carbono quadrado 40x40 x 1.20mm
- Coluna em tubo de aço carbono redondo de 7/8 x 1.20mm
- Haste flexível em tubo de aço carbono redondo, com acabamento cromado
- Altura regulável por meio de manipulador
- Foco protetor em alumínio, com acabamento em pintura epóxi
- Pés com rodízios giratórios de 2" (50mm)
- 110 ou 220 volts (não selecionável)
- Acabamento pintura epóxi, com tratamento ferruginoso
- Acompanha uma lâmpada halógena 50W
- Registro MS: 80430259006

DIMENSÕES

Dimensão aproximada: Alt. Mínima: 1250 mm - Alt. Máxima: 1600 mm

OPCIONAIS

RN14026IR – LUMINÁRIA FLEXÍVEL EM INOX;
04 pés em ferro fundido em forma de (X)

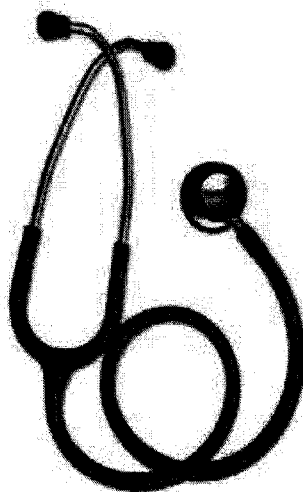

Estetoscópio cardiológico duo sonic Advantive

Constituído por auscultador com diafragma de alta sensibilidade para captação precisa de ruídos. Olivas em formato anatômico, conjunto bi-auricular de armação leve, campânula em aço inoxidável.

Acessórios: 2 pares de olivas para reposição, 1 diafragma sobressalente

Disponível nas cores: verde, vermelho, azul ou preto

Reg. ANVISA: 10296900044

Lanterna Clínica Mikatos®

ref. 022PPR

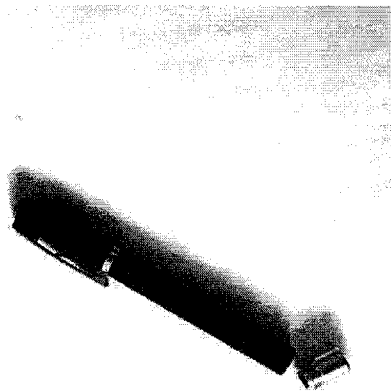


Imagem ilustrativa

A Lanterna Clínica Mikatos® foi desenvolvida para que todos os profissionais da saúde possam auxiliar nos exames clínicos de rotina em Hospitais, Clínicas e Consultórios Médicos em geral.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM


1. LANTERNA CLINICA MIKATOS;
1. MANUAL DE INSTRUÇÕES.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cores:	Prata Preto Roxo Azul Verde Dourado Vermelho
Marca:	Mikatos
Lâmpada:	LED
Temperatura de cor:	5.500K - 6.000K (Kelvin) Branco Frio
Fluxo Luminoso:	4.000 mCd (miliCandelas)
LUX:	5.000 a 10cm
Tensão Elétrica:	3,0V (Volts)
Corrente Elétrica:	25 mA (miliAmpéres)
Vida útil (mínima):	20.000 horas
Funcionamento:	2 Pilhas Alcalinas (Tamanho AAA) *Não acompanha o produto
Material:	Alumínio Anodizado
Dimensões do Produto:	134mm x Ø11,7mm
Dimensões da Embalagem:	190mm x 50mm x 95 mm
Peso com embalagem:	20g
Validade:	Indeterminada
Garantia:	01 Ano contra defeitos de fabricação



Renascer
móveis hospitalares

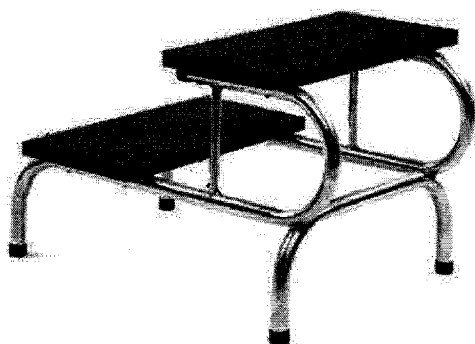

ESCADINHA CLÍNICA DE 02 DEGRAUS EM INOX

DESCRIÇÃO

RN10006R – ESCADINHA CLÍNICA 02 DEGRAUS, INOX

- Estrutura em tubo de aço inox redondo de 7/8 x 1,20mm – 304AISI
- Pisos de madeira, revestidos com borracha antiderrapante
- Pés com ponteiros plásticos

DIMENSÕES

Dimensão aproximada: 390 x 540 x 330 mm – Capacidade Aprox: 110 kg

Dimensão aprox. Degrau: 390 x 200 mm – Alt. 1º Piso: 180 mm

OPCIONAIS

RN10004R – ESCADINHA CLÍNICA DE 02 DEGRAUS ESMALTADA;



Renascer



CCL
FLS. 824


CCL
FLS. 825

CLIQUE E SEJA REVENDA OFICIAL

ACESSAR SMARTLIVE

SEJA REVENDA OFICIAL

CCL	
FLS.	826
135	

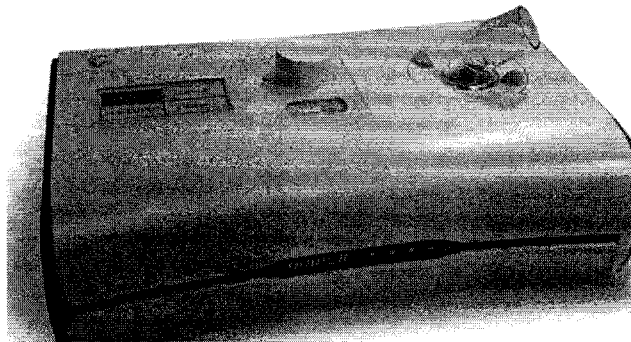

CPAP SLEEPLIVE LT

CÓD. YH-550

O irmão menor da família Gaslive chega com excelente custo-benefício e conectividade Wi-Fi opcional. Telemonitoramento acessível e descomplicado.

- 1 +

ADICIONAR

O botão ADICIONAR é um recurso exclusivo para Revendas Oficiais Gaslive. Faça seu login ou cadastre-se.



Manual CPAP SleepLive LT



Acessar Portal de Monitoramento
(Médico/Revenda)



Baixar Software de Leitura
(Médico/Revenda)



Baixar App de Monitoramento (Paciente)

X

Descrição

Apresentação do Produto: O CPAP SleepLive LT é um dispositivo de pressão positiva contínua nas vias aéreas que tornará suas noites de sono mais confortáveis e eficazes. Com excelente custo benefício, o SleepLive LT é automático com umidificador integrado, leve com interface didática e otimizada na visualização de dados, com módulo de oximetria e a leitura dos dados via cartão de memória.

Indicações do Produto: pacientes diagnosticados com apneia obstrutiva do sono (AOS) acima de 30kg e em condições clínicas estáveis. Pode ser utilizado em ambiente domiciliar e/ou hospitalar.

Modo(s) de Operação: o dispositivo oferece pressão positiva contínua nas vias aéreas de dois modos: modo pressão fixa (CPAP), onde a pressão que o paciente receberá durante seu tratamento é previamente configurada no dispositivo; e modo automático (APAP) onde o dispositivo é programado com uma pressão mínima e uma pressão máxima. Dentro destes limites, o dispositivo fornecerá a pressão necessária ao paciente para que não realize eventos respiratórios.

Parâmetros de conforto: o dispositivo conta com funções clássicas de conforto como rampa, graduada de 0 a 45 minutos, que tem como objetivo fornecer de forma gradual o nível de pressão até que atinja o valor prescrito. E também possui alívio expiratório (denominado de FPS), graduado de 0 a 3 cmH₂O que oferece conforto e alívio no momento da expiração.

Versões SleepLive LT e seus formatos de conectividade:

- SleepLive LT: leitura de relatórios feita exclusivamente pelo SD Card através do portal SmartLive (importar dados) ou software BreathCare instalado no computador.
- SleepLive LT com Wi-Fi: leitura de relatórios pelo portal SmartLive utilizando a conexão Wi-Fi para que os dados subam à nuvem (necessário configuração da rede Wi-Fi no dispositivo, assista ao vídeo tutorial).
- SleepLive LT 4G: leitura de relatórios pelo portal SmartLive por rede sem fio. Conheça aqui!

Para o paciente: nos modelos 4G e com Wi-Fi, os relatórios poderão ser acessados no aplicativo SmartLive, disponível para Android e IOS. Basta fazer o download do app e realizar seu cadastro e vínculo do número de série do seu dispositivo. Baixe aqui!

Diferenciais: o SleepLive LT conta com módulo de oximetria integrado ao dispositivo, sendo necessário apenas adquirir separadamente o sensor e cabo para que enriqueça os dados de terapia do paciente com saturação periférica de oxigênio (SpO₂) e frequência cardíaca (FC). Além desta função, o aprimoramento do algoritmo proporciona leitura de apneia central, dado muito importante na leitura dos relatórios do paciente.

Acessórios que acompanham o produto: dispositivo principal, umidificador com tanque de água, máscara nasal com apoio de testa (YN-02, tamanho M), tubo de ar, adaptador e cabo de energia, manual do usuário, filtro de ar, cartão micro SD e bolsa de transporte.

Orientações adicionais:

- Limpar a parte externa do seu dispositivo ao menos uma vez por semana com um pano seco.

Nota: não use alvejante, cloro, álcool, soluções aromáticas, óleos, sabonetes antibacterianos ou cremes para limpar seu dispositivo.

- Lavar o reservatório de água, máscara e traqueia com sabão neutro em água corrente. Se água morna, não deve

– Enxaguar bem os componentes e deixar secar fora da luz solar direta ou calor (a temperatura não deve ultrapassar os 40 graus). Termine de secá-los com um pano seco, se necessário.


– Troca de filtro: o filtro do SleepLive LT não é lavável e deve ser trocado a cada 4 semanas ou quando notar sujidade considerável. Nunca opere seu equipamento sem filtro e mantenha sempre a unidade seca.

– Transporte: seu dispositivo deve ser transportado na bolsa de transporte com os acessórios acomodados nos respectivos compartimentos.

– Sempre verifique se o tanque de água está vazio antes de guardar seu dispositivo.

– Verifique a compatibilidade das tomadas antes de ligar seu dispositivo.

Garantia: o SleepLive LT possui 2 anos de garantia. O reservatório de água e tubo de ar são 90 dias, exceto mau uso.



Principais Benefícios

PARA OS PACIENTES



- Ótimo custo-benefício com a mesma confiabilidade do modelo Gaslive anterior.
- CPAP automático com umidificador integrado.
- Módulo de oximetria integrado.
- Leitura de relatórios através de SD Card.
- Manuseio intuitivo e tela com informações claras e didáticas.
- Disponível nas versões: com e sem Wi-Fi e 4G.

PARA A REVENDA




- Silencioso e confortável.
- Algoritmo de resposta equivalente ao CPAP Gaslive (YH-560), automático e com todas as funções clássicas.
- Motor de alto desempenho: mais horas de tratamento com qualidade.
- Precisão de dados e relatórios mais completos com a função de oximetria (opcional).
- Assistência técnica feita pela Gaslive Assist.

Especificações

Registro ANVISA:	81278599008
Dimensões do produto:	10 X 27 X 18 cm
Peso:	1,4 kg
Rampa:	0 a 45 minutos (onde zero é desligado e 45 min o tempo máximo de rampa)
Alívio Expiratório (FPS):	0 a 3 (onde zero é desligado e 3 o maior nível de alívio expiratório)

Dermatoscópio 2.5V OMNI LED com Estojo Luxo MD

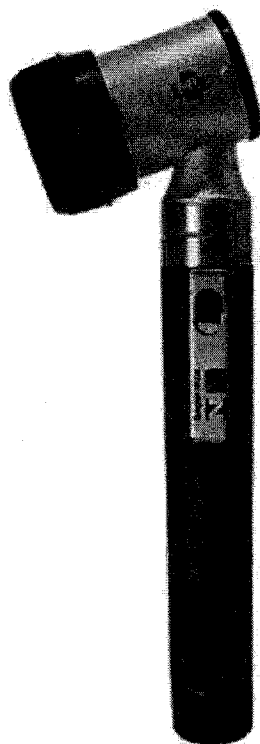

Descrição

Descrição

A lâmpada tipo LED possui expectativa de vida (estimada) de 20.000 horas, mostrando-se superior à lâmpada incandescente ou halógena quanto ao brilho e durabilidade que é de 20 a 30 horas em uso contínuo. Lâmpada LED (Light Emission Diode) de 3,0V x 300mA, ponteira de fibra ótica e lente (dubleto acromático) com aumento de 10 (dez) vezes, que fornece imagens de epiluminação epidérmica cujos resultados são interpretados de acordo com os critérios e sinais dermatológicos, os quais necessitam ser reconhecidos e entendidos pelo examinador para um diagnóstico preciso.


FABRICANTE: MD

CLIQUE E SEJA REVENDA OFICIAL

ACESSAR SMARTLIVE

SEJA REVENDA OFICIAL

CCF
FLS. 837
103

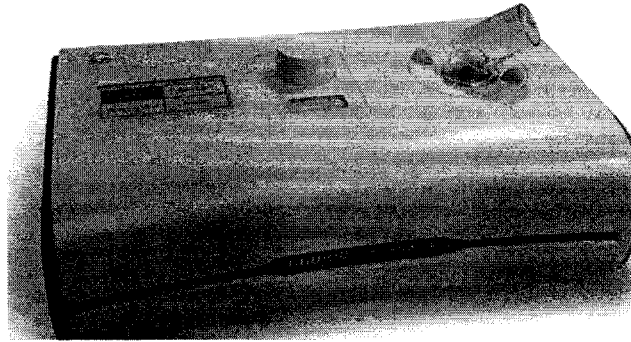

CPAP SLEEPLIVE LT

CÓD. YH-550

O irmão menor da família Gaslive chega com excelente custo-benefício e conectividade Wi-Fi opcional. Telemonitoramento acessível e descomplicado.

- 1 +

ADICIONAR

O botão ADICIONAR é um recurso exclusivo para Revendas Oficiais Gaslive. Faça seu login ou cadastre-se.



Manual CPAP SleepLive LT



Acessar Portal de Monitoramento
(Médico/Revenda)



Baixar Software de Leitura
(Médico/Revenda)



Baixar App de Monitoramento (Paciente)

X

Descrição

Apresentação do Produto: O CPAP SleepLive LT é um dispositivo de pressão positiva contínua nas vias aéreas que tornará suas noites de sono mais confortáveis e eficazes. Com excelente custo benefício, o SleepLive LT é automático com umidificador integrado, leve com interface didática e otimizada na visualização de dados, com módulo de oximetria e a leitura dos dados via cartão de memória.

Indicações do Produto: pacientes diagnosticados com apneia obstrutiva do sono (AOS) acima de 30kg e em condições clínicas estáveis. Pode ser utilizado em ambiente domiciliar e/ou hospitalar.

Modo(s) de Operação: o dispositivo oferece pressão positiva contínua nas vias aéreas de dois modos: modo pressão fixa (CPAP), onde a pressão que o paciente receberá durante seu tratamento é previamente configurada no dispositivo; e modo automático (APAP) onde o dispositivo é programado com uma pressão mínima e uma pressão máxima. Dentro destes limites, o dispositivo fornecerá a pressão necessária ao paciente para que não realize eventos respiratórios.

Parâmetros de conforto: o dispositivo conta com funções clássicas de conforto como rampa, graduada de 0 a 45 minutos, que tem como objetivo fornecer de forma gradual o nível de pressão até que atinja o valor prescrito. E também possui alívio expiratório (denominado de FPS), graduado de 0 a 3 cmH₂O que oferece conforto e alívio no momento da expiração.

Versões SleepLive LT e seus formatos de conectividade:

- SleepLive LT: leitura de relatórios feita exclusivamente pelo SD Card através do portal SmartLive (importar dados) ou software BreathCare instalado no computador.
- SleepLive LT com Wi-Fi: leitura de relatórios pelo portal SmartLive utilizando a conexão Wi-Fi para que os dados subam à nuvem (necessário configuração da rede Wi-Fi no dispositivo, assista ao vídeo tutorial).
- SleepLive LT 4G: leitura de relatórios pelo portal SmartLive por rede sem fio. Conheça aqui!

Para o paciente: nos modelos 4G e com Wi-Fi, os relatórios poderão ser acessados no aplicativo SmartLive, disponível para Android e IOS. Basta fazer o download do app e realizar seu cadastro e vínculo do número de série do seu dispositivo. [Baixe aqui!](#)

Diferenciais: o SleepLive LT conta com módulo de oximetria integrado ao dispositivo, sendo necessário apenas adquirir separadamente o sensor e cabo para que enriqueça os dados de terapia do paciente com saturação periférica de oxigênio (SpO₂) e frequência cardíaca (FC). Além desta função, o aprimoramento do algoritmo proporciona leitura de apneia central, dado muito importante na leitura dos relatórios do paciente.

Acessórios que acompanham o produto: dispositivo principal, umidificador com tanque de água, máscara nasal com apoio de testa (YN-02, tamanho M), tubo de ar, adaptador e cabo de energia, manual do usuário, filtro de ar, cartão micro SD e bolsa de transporte.

Orientações adicionais:

- Limpar a parte externa do seu dispositivo ao menos uma vez por semana com um pano seco.

Nota: não use alvejante, cloro, álcool, soluções aromáticas, óleos, sabonetes antibacterianos ou cremes para limpar seu dispositivo.

- Lavar o reservatório de água, máscara e traqueia com sabão neutro em água corrente. Se água morna, não deve

– Enxaguar bem os componentes e deixar secar fora da luz solar direta ou calor (a temperatura não deve ultrapassar os 40 graus). Termine de secá-los com um pano seco, se necessário.

CCL
FLS. 833

- Troca de filtro: o filtro do SleepLive LT não é lavável e deve ser trocado a cada 4 semanas ou quando notar sujidade considerável. Nunca opere seu equipamento sem filtro e mantenha sempre a unidade seca.
- Transporte: seu dispositivo deve ser transportado na bolsa de transporte com os acessórios acomodados nos respectivos compartimentos.
- Sempre verifique se o tanque de água está vazio antes de guardar seu dispositivo.
- Verifique a compatibilidade das tomadas antes de ligar seu dispositivo.

Garantia: o SleepLive LT possui 2 anos de garantia. O reservatório de água e tubo de ar são 90 dias, exceto mau uso.

Principais Benefícios

PARA OS PACIENTES



- Ótimo custo-benefício com a mesma confiabilidade do modelo Gaslive anterior.
- CPAP automático com umidificador integrado.
- Módulo de oximetria integrado.
- Leitura de relatórios através de SD Card.
- Manuseio intuitivo e tela com informações claras e didáticas.
- Disponível nas versões: com e sem Wi-Fi e 4G.


PARA A REVENDA

- Silencioso e confortável.
- Algoritmo de resposta equivalente ao CPAP Gaslive (YH-560), automático e com todas as funções clássicas.
- Motor de alto desempenho: mais horas de tratamento com qualidade.
- Precisão de dados e relatórios mais completos com a função de oximetria (opcional).
- Assistência técnica feita pela Gaslive Assist.

Especificações

Registro ANVISA:	81278599008
Dimensões do produto:	10 X 27 X 18 cm
Peso:	1,4 kg
Rampa:	0 a 45 minutos (onde zero é desligado e 45 min o tempo máximo de rampa)
Alívio Expiratório (FPS):	0 a 3 (onde zero é desligado e 3 o maior nível de alívio expiratório)

Umidificador integrado?	Sim
Tubo aquecido?	Não
Faixa de umidificação:	0 a 6 (onde zero é desligado e 6 o maior nível de umidificação)
Permite a leitura de cartão de memória?	Sim
Ruído:	28dB
Garantia:	2 anos para o dispositivo, 90 dias para tanque de água e tubo de ar (exceto mau uso).



Informação Adicional

Peso (com embalagem)	1.6 Kg
Dimensões (da embalagem)	27 x 18 x 10 cm

FAQ – Principais Dúvidas

- + O SleepLive LT possui conectividade?
- + O SleepLive LT é um CPAP automático?

Se a sua dúvida não foi respondida, fale com o nosso atendimento →

Manuais do Usuário



Manual – YH-550 - CPAP SleepLive LT

Você pode baixar os Manuais do Usuário de todos os produtos Gaslive de uma única vez, para atender ainda melhor os seus clientes. Seja uma Revenda Oficial Gaslive e faça o download gratuito.


Seja uma Revenda Oficial

Baixar Imagens Desse Produto

X



Gaslive



ir para home

CONCENTRADOR DE OXIGÊNIO **AIRLIVE 8F**


A tecnologia que você já conhece
e confia recebe um novo nome,
AirLive 8F.

Principais Diferenciais


Durabilidade e Baixo
Custo de Manutenção



Design Moderno
e Leveza

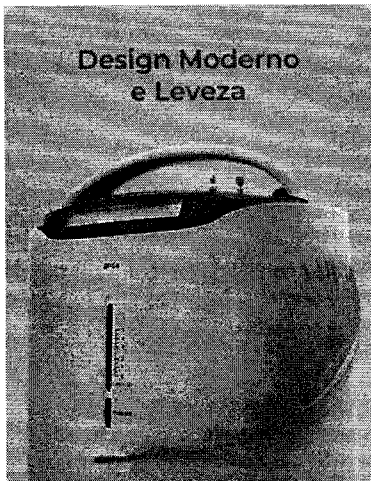

Sistema de Alarmes

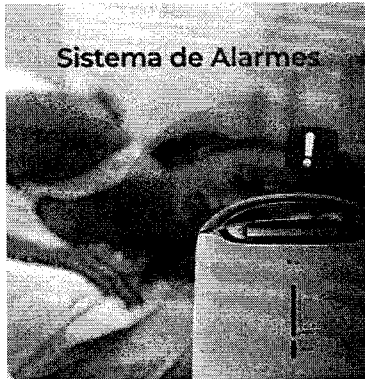

Saída de O2 e
Nebulização Simultânea



Exclusiva
Função Breaker



Ajustes por
Controle Remoto



Silencioso, duas terapias simultâneas e disjuntor protetivo: O líder de vendas pós-pandemia!


Concentrador AirLive 8F Gaslive, silencioso e com recursos, como nebulização integrada, controle remoto e exclusivo disjuntor protetivo. Fácil interação pelo paciente e profissional da saúde. Equipamento sucesso de venda no Brasil e com o ótimo custo benefício!




CCL
837
A

AirLive 8F Gaslive, sua melhor solução!

O Concentrador AirLive 8F Pro Gaslive é essencial para tratar diversas condições respiratórias, como DPOC, Fibrose Cística, Enfisema Pulmonar e Bronquite Crônica. Promove melhora da oxigenação e da qualidade de vida dos pacientes que necessitam de oxigênio suplementar.

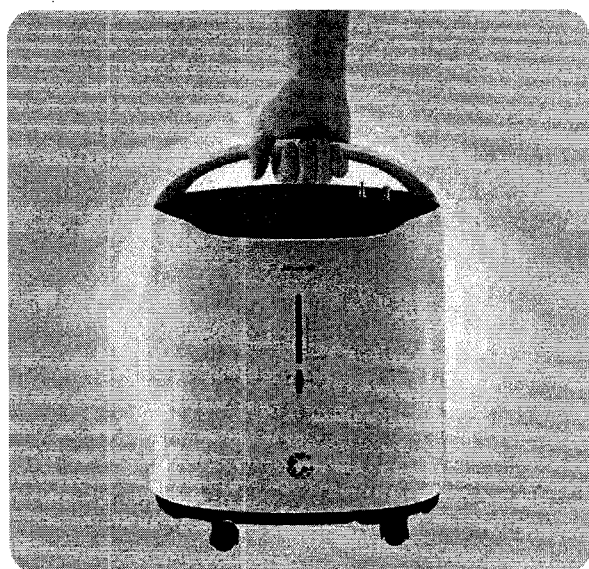


Facilidade e Praticidade

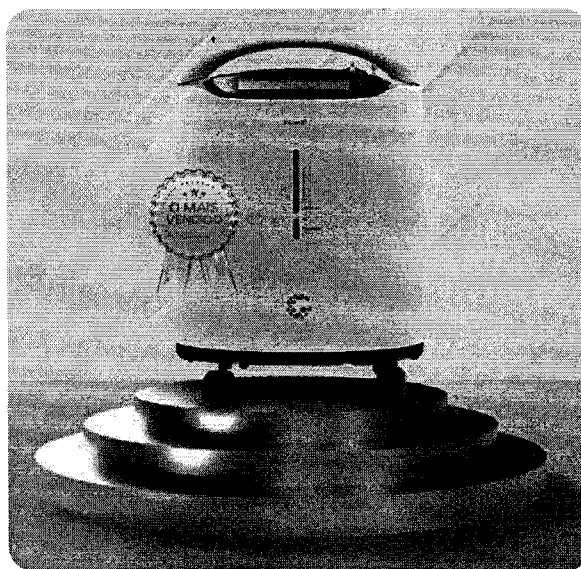

O sucesso de vendas no Brasil pós-pandemia

Com apenas 15kg, seu design moderno oferece praticidade ao paciente. Ajuste o equipamento com apenas um toque no controle remoto. Terapia facilitada e cômoda: escolha a Gaslive! Controle seu tempo com precisão: Visor com temporizador integrado para uma experiência ainda mais personalizada.

Este fenômeno de vendas conquistou o país, oferecendo uma solução versátil para uma terapia mais segura e confiável. Com sua leveza e praticidade, proporciona conforto e tranquilidade durante a terapia.



Confira outros diferenciais



Peneira molecular

A peneira molecular assegura alta estabilidade na concentração de oxigênio na saída do dispositivo.



Mais econômico da categoria

O concentrador mais econômico do mercado consumo de apenas 267 Watts de energia.



Compress


Possui uma e conta com proteção contra superaquecimento aumentando do concentrador.

Função Nebulizadora

Desfrute de versatilidade com nosso concentrador oxigênio.

Durante a nebulização a concentração de oxigênio se mantém estável, permitindo o uso simultâneo com a oxigenoterapia sem comprometer a eficácia da terapia. Seja para a oxigenoterapia ou para a nebulização de medicamentos, nosso equipamento oferece conveniência e eficácia.



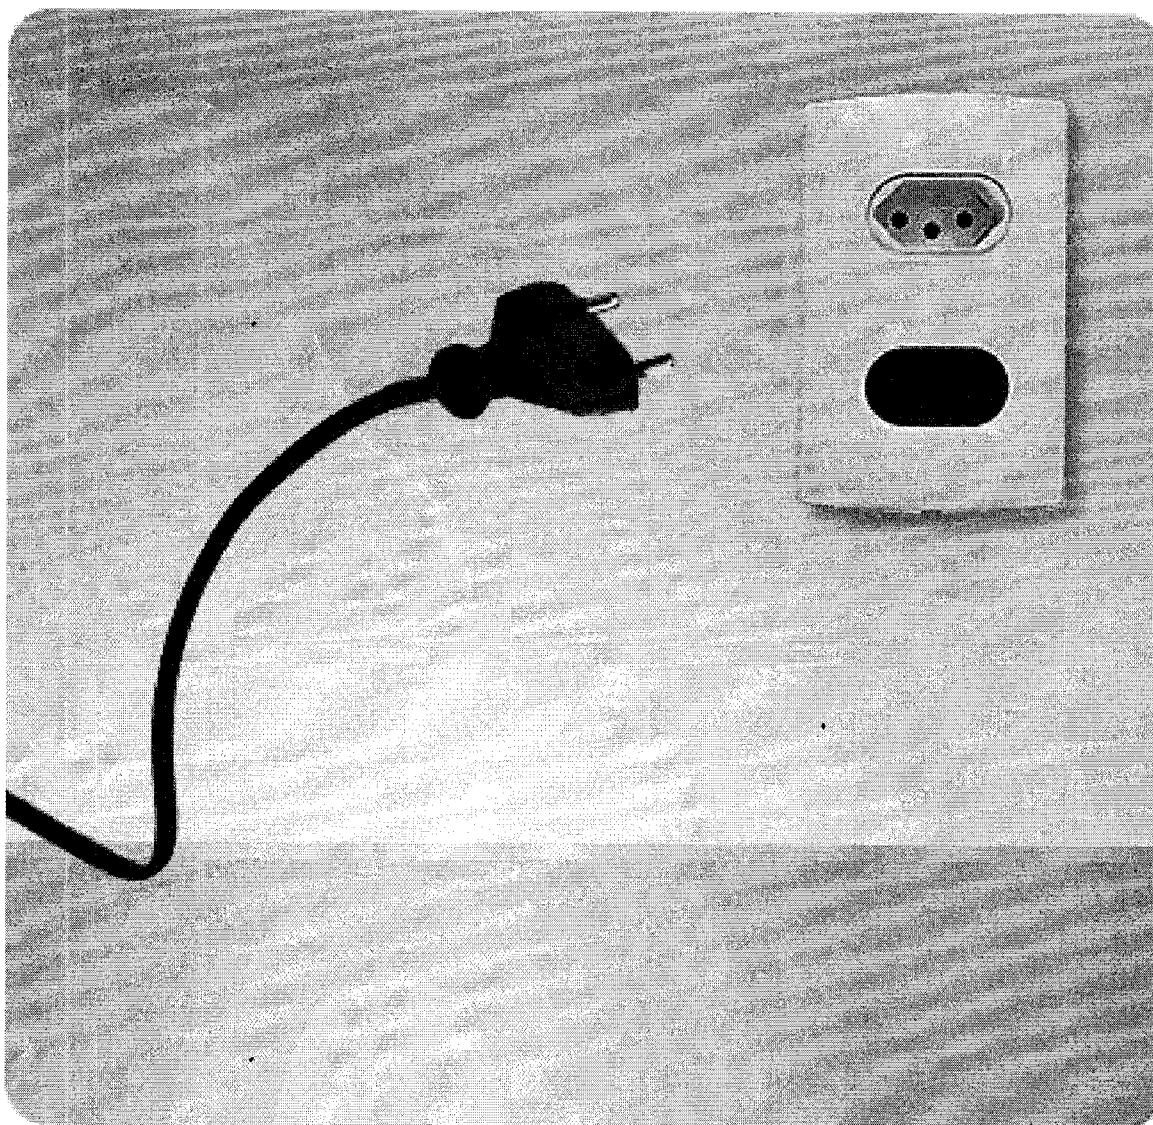

Função Breaker


Proteja o concentrador AirLive 8F da Gaslive. Equipado com Função Breaker para proteção contra super-voltagens e desligamento automático em caso de voltagem incorreta. Caso o paciente conecte o concentrador a uma voltagem inadequada, a função breaker será ativada para evitar danos e prejuízos ao equipamento.



Sistema de Alarmes


Equipado com alarmes sonoros e visuais, o concentrador detecta e alerta sobre situações críticas, como baixa concentração de oxigênio, obstrução na entrega de fluxo e interrupção de energia.

Esses recursos garantem não apenas a segurança do paciente, mas também a proteção e integridade do equipamento.

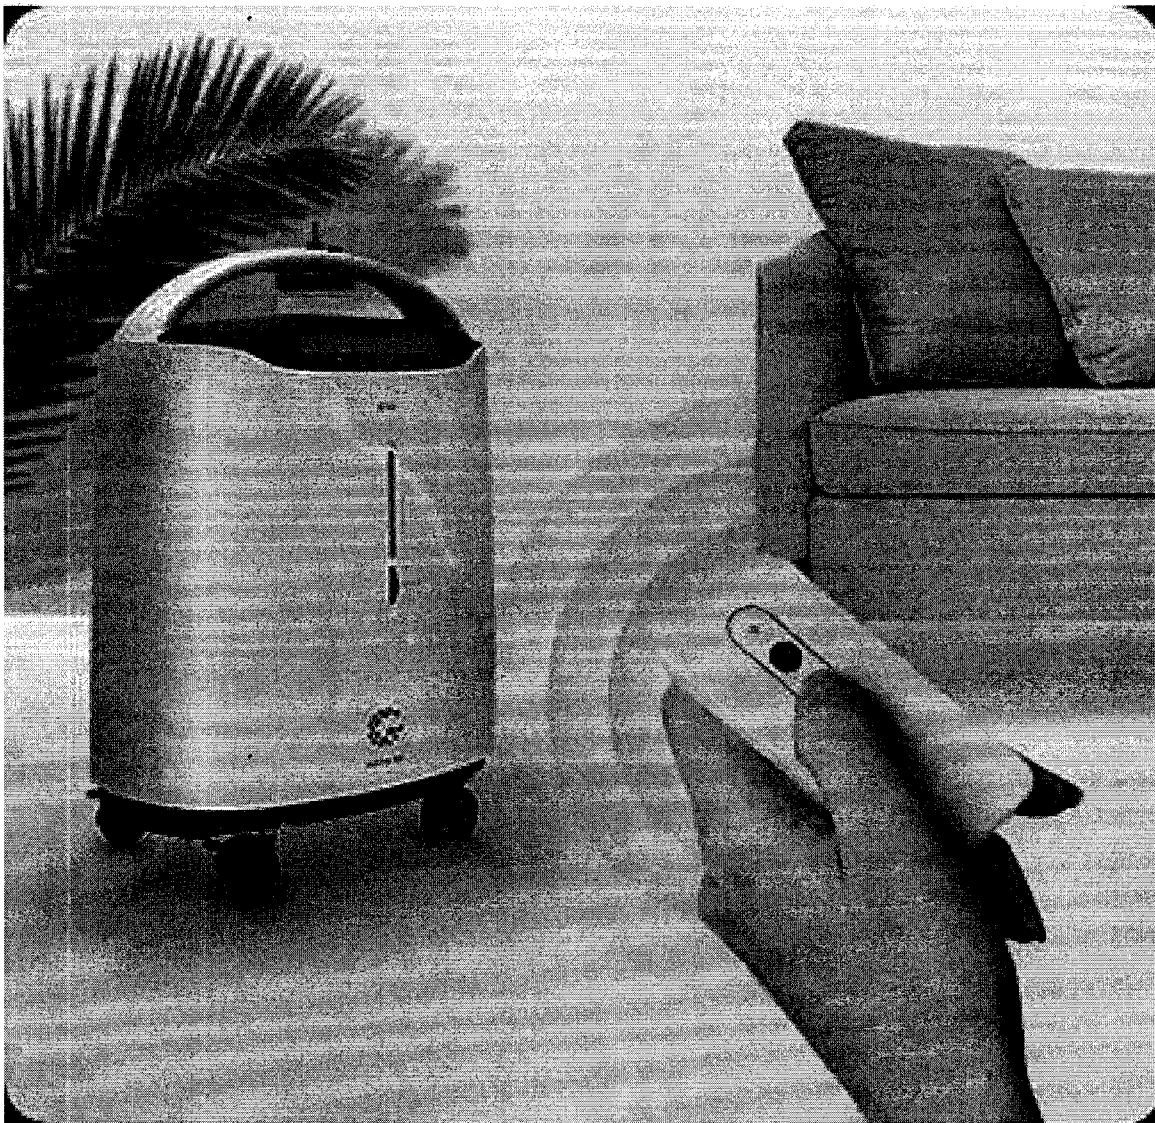


Ajustes por Controle Remoto

É possível ligar e desligar o concentrador, além de aumentar ou diminuir o temporizador utilizando apenas o controle remoto. Para sua utilização, o controle remoto deve apontar para o receptor no painel de controle do concentrador de oxigênio. Sempre que o concentrador for desligado, as configurações de terapia anteriores ficarão salvas, sendo retomadas automaticamente para o próximo uso, permitindo que a terapia se mantenha ajustada de acordo com o indicado pelo profissional de saúde.

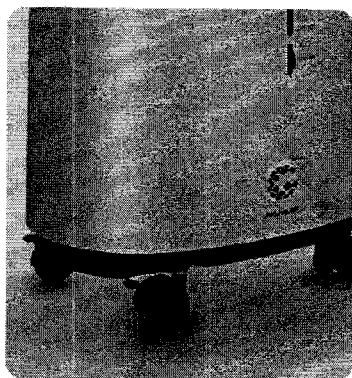

Facilidade com os rodízios

O paciente pode levar seu concentrador de um cômodo para outro com facilidade e sem esforço. E quando encontrar o local ideal, basta travar os rodízios para garantir estabilidade durante o uso.

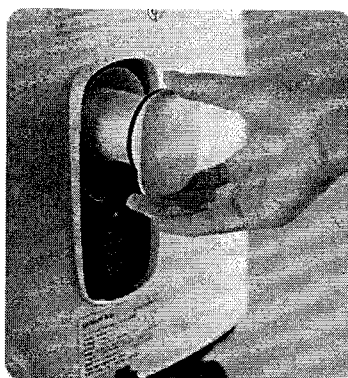

Higienização e troca fácil e rápida do filtro de ar

Na região posterior do equipamento, remova a tampa e retire o filtro para a limpeza. Recomenda-se fazer a limpeza do filtro uma vez por mês e substituí-lo a cada três meses para proteger o compressor e prolongar a vida útil do equipamento.



Tecnologia avançada e qualidade

Desenvolvido com tecnologia avançada e qualidade, promove oxigenoterapia de maneira efetiva e silenciosa, promovendo o uso de forma mais confortável ao paciente.

Dermatoscópio 2.5V OMNI LED com Estojo Luxo MD

621

**Descrição****Descrição**

A lâmpada tipo LED possui expectativa de vida (estimada) de 20.000 horas, mostrando-se superior à lâmpada incandescente ou halógena quanto ao brilho e durabilidade que é de 20 a 30 horas em uso contínuo. Lâmpada LED (Light Emission Diode) de 3,0V x 300mA, ponteira de fibra ótica e lente (dubleto acromático) com aumento de 10 (dez) vezes, que fornece imagens de epiluminação epidérmica cujos resultados são interpretados de acordo com os critérios e sinais dermatológicos, os quais necessitam ser reconhecidos e entendidos pelo examinador para um diagnóstico preciso.

FABRICANTE: MD



R S DOS SANTOS COMERCIO DE MOVEIS LTDA

CNPJ 23.303.250/0001-1

IE 15.500.183-3

IBAMA 6449520


DESDE 2015

CCL

ELS.

845

BIOMBO TRIPLO GIRATÓRIO COM RODÍZIOS

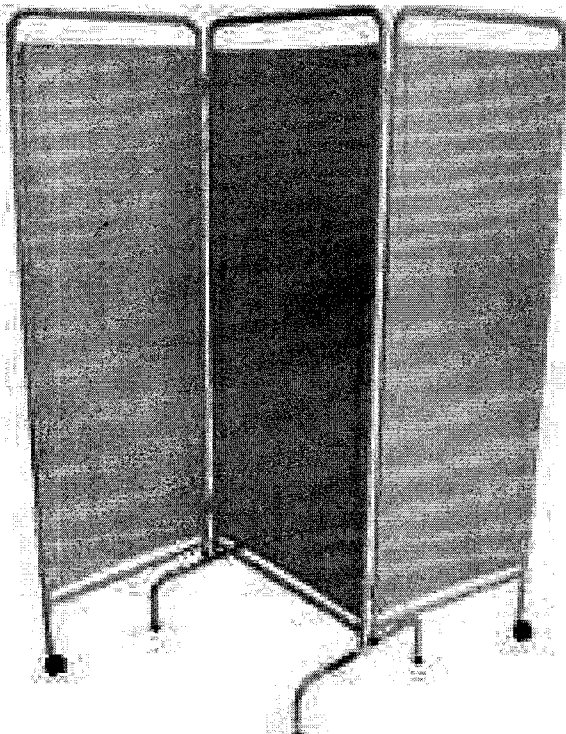



**. Marca: RS MOVEIS.
Nomenclatura: BIO.
Código: 0103AI**

Especificações: Marca RS MOVEIS; Nomenclatura: BIO; Modelo MH – Moveis Hospitalar Biombo Triplo Giratório em Aço Inox. .

A RS MOVEIS é fabricante de referência no segmento de mercado, onde possui sua própria logística para o produto ; Biombo Triplo Fixo/Giratório com 02 Rodízios , e toda a variedade de Moveis Hospitalar produzidos com eficiência e qualidade.

Desempenho e Funcionabilidade: É um tipo de mobiliário funcional, de mobilidade flexível com giro de 360 graus, com durabilidade do Ferro Aço que é uma liga metálica composta e de alta resistência, satisfatória, durável e de médio custo de manutenção e boa estética.

DOPPLER

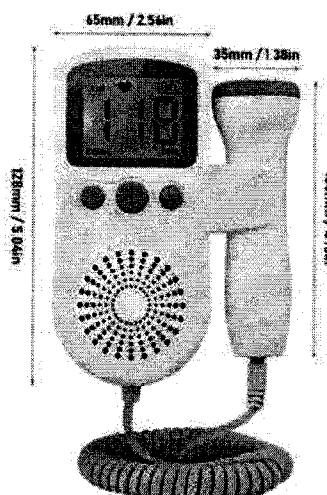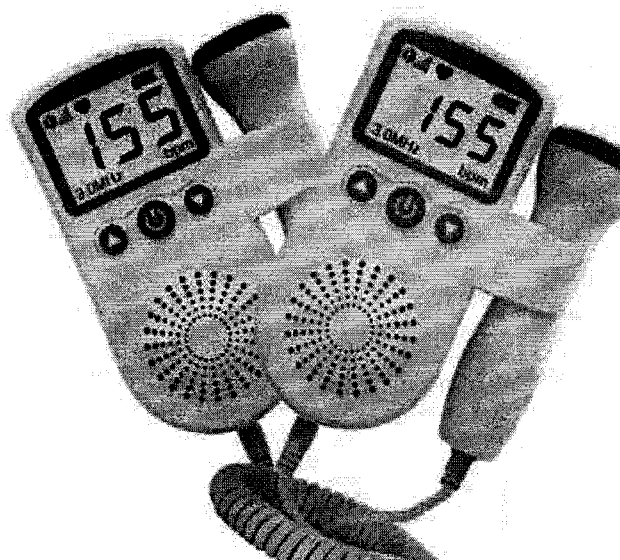

Detector Fetal também conhecido como Sonar ou Doppler Fetal é o equipamento médico indicado para ausculta dos batimentos cardíacos do feto e fluxo sanguíneo do cordão umbilical, com o Detector Fetal é possível fazer a localização da placenta a partir da 12ª semana de gestação.

DOPPLER

CCL
FLS. 847

Sua finalidade principal é possibilitar à avaliação através da ausculta a vitalidade fetal, números de fetos e sofrimento fetal.

A tecnologia integrada de alta sensibilidade permite uma rápida localização do coração fetal desde as primeiras semanas até o final da gravidez.

O detector fetal ultra-sônico digital é de fácil manuseio, indicado para verificação diária do feto e exame de rotina em hospitais, clínicas e consultórios.

Aparelho com excelente áudio, permite escuta coletiva.

Este aparelho apresenta excelente custo-benefício, sendo uma ótima opção tanto para uso pessoal, profissional, estudantes ou entusiastas da área!

=====

CARACTERÍSTICAS

=====


- Operação simples e intuitiva;
- Proporciona excelente audição, com som de alta fidelidade;
- Transdutor de alta sensibilidade;
- Display de LCD com iluminação de fundo;
- "Design" Exclusivo e ergonômico;
- Frequência do ultrassom de 2MHz;
- Ultrassom de baixa intensidade: $<10\text{mW/cm}^2$;
- Faixa de medida do BCF: 50~240bpm;
- Resolução do BCF de 1 bpm;
- Precisão do BCF de $\pm 1\text{bpm}$;

Especificações Técnicas

MODELO: DPR CL BABY 15KGX5G PESADORA CRISTAL BRANCA
CÓDIGO: 4026
Código EAN: 7898579862197
NCM: 8423.1000
Garantia: 12 Meses

CARACTERÍSTICAS E BENEFÍCIOS:

- Balança Pesadora BABY - 15kg/5g - 1500g/100g/50g - São Paulo - Ramuza
- Possui a capacidade de pesagem de 15kg
- Visor para peso
- Display Cristal Líquido - Ideal para ambientes externos
- Balança totalmente injetada em ABS niquê e com um acabamento resistente e lavável, economizando no tempo
- Acabamento esmerado
- Caisa baby com dimensões: C 340 x L 500 x A 100 (mm)
- Fácil higienização
- Teclado com design garantido e de fácil operação
- Possui 4 teclas de fácil digitação e um símbolo configurado a operação

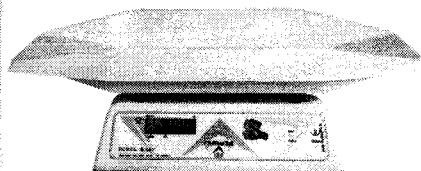

Capacidade (kg)	15 kg
Divisão (g)	5 g
Mínimo de pesagem (g)	100 g
Dimensão da base (mm) - Completa	C 620 x L 420 x A 250
Tara	9,995 kg
Display	6 Dígitos
Alimentação	Ponte Externa - Entrada Bivolt Automático para 110/220 VCA com tolerância de -15% a +10%; Saída de 7,7 VDC/500mA - Comprimento cabo de alimentação: 1 metro
Frequência	50/60Hz
Consumo (Watt ou VA)	4W
Interface de Comunicação	Não se aplica
Temperatura de Operação	De 0° a 40°C
Teclado	4 Teclas de Fácil Digitação
INMETRO	Modelo aprovado pela Portaria 236
AFERIÇÃO	AFERIDA POR: Instituto de Pesos e Medidas do Estado de S. Paulo - IPEM
OBSERVAÇÃO	Pés reguláveis revestidos de material antiderrapante; Medida Régua Antropométrica: 540mm; Medida Colchão: 540mm x 265mm;
Tamanho e peso da caixa (CxLxA) (mm)	C 370 x L 350 x A 160 - 5 kg

RAMUZA IND COM BALANÇAS LTDA - C.N.P.J. 49.716.616/0001-52 - I.E. 623.002.413.112
Estrada Marica Marques, 746 - Santana de Parnaíba - SP - CEP 06529-210
E-mail ramuza@ramuza.com.br - Fone: 11 4156-9797
VISITE www.ramuza.com.br

16

P.E. 053/24

CCL
FLS. 879



DOPPLER FETAL PORTÁTIL FD-200

Manual de Instruções

1. SEGURANÇA GERAL	4
1.1 AVISOS	4
2. VISÃO GERAL	6
3. CARACTERÍSTICAS	6
4. INDICAÇÃO DE USO.....	7
5. APRESENTAÇÃO GERAL	7
6. VISORES.....	7
6.1. VISOR MODELO FD-200A	7
6.2. VISOR MODELO FD-200C	8
6.3. VISOR MODELOS FD-200B E FD-200D	8
7. TECLAS E LUZES INDICADORAS.....	8
7.1. AJUSTE DO VOLUME	8
7.2. LIGA/DESLIGA	8
7.3. MODO DE CONFIGURAÇÃO	8
7.4. SELECIONANDO O MODO	8
7.5. LUZ DE INDICAÇÃO	9
7.6. TRANSDUTORES	9
8. INSTRUÇÕES DE USO	9
8.1. UTILIZANDO A PILHA OU BATERIA.....	9
8.1.1.SUBSTITUINDO OU CARREGANDO A BATERIA.....	9
8.2. OPERANDO O TRANSDUTOR	9
8.3. LIGANDO O EQUIPAMENTO	10
8.4. CONFIGURANDO OS MODOS DE OPERAÇÃO	10

8.4.1. MODOS DE OPERAÇÃO	10
8.4.2. SELECIONANDO OS MODOS	10
8.5. CONFIGURANDO PARÂMETROS	10
9. INSPECIONANDO A FHR.....	11
9.1. USO DO GEL	11
9.2. ENCONTRANDO A POSIÇÃO DO FETO	11
9.3. INSPECIONANDO A FHR	11
9.4. LIMPEZA APÓS O USO	11
9.5. GRAVAR, REPRODUZIR E TRANSFERIR	12
10. LIMPEZA	12
10.1. DESINFECÇÃO	12
11. MANUTENÇÃO	12
12. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS	12
13. ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO	13
13.1 CONDIÇÕES AMBIENTAIS	13
14. GARANTIA	13
15. ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA	14
16. ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO	14
17. SENSIBILIDADE GERAL	15
18. SIMBOLOGIA	16
18.1 SIMBOLOGIA NO EQUIPAMENTO	16
18.2. SIMBOLOGIA NA EMBALAGEM	17
19. DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE ELETROMAGNÉTICA	18

Antes de utilizar o Doppler Fetal Portátil FD-200 MD, leia cuidadosamente este manual e certifique-se de estar familiarizado com os controles, exibições do visor, recursos e técnicas de operação.

Examine cuidadosamente o Doppler Fetal Portátil FD-200 MD (referido adiante somente como equipamento) e seus acessórios para certificar que a unidade principal e acessórios não possuem nenhum dano visível que possa afetar a segurança do paciente e o desempenho do equipamento. O período recomendado para examiná-lo é uma vez por semana.

O equipamento não é compatível para uso em ambientes com equipamentos cirúrgicos elétricos.

O equipamento é usado para detecção da frequência cardíaca fetal e não é indicado para nenhum tratamento. Se o resultado do teste de FHR não for confiável ou útil, utilize outro método.

A instalação, ajuste, manutenção ou reparo somente pode ser realizado por equipe qualificada ou autorizada pelo fabricante.

1.1 AVISOS

ATENÇÃO

Contém informações importantes sobre um possível perigo para o operador do equipamento, ou para o paciente que está presente durante a operação normal do equipamento.

CUIDADO

Fornece informações ou instruções que devem ser seguidas para garantir a operação e desempenho do equipamento adequadamente.

NOTA

Apresenta uma informação que ajudará a operar o equipamento ou os dispositivos conectados a ele.

ATENÇÃO!

- O Doppler Fetal Portátil FD-200 MD utiliza doppler ultrassônico de muito baixa energia. Isto é confirmado pelo projeto de cálculo, teste de laboratório, teste clínico e aplicação clínica que a energia do doppler é segura para fetos, gestantes e demais pessoas.
- Este equipamento não é à prova de explosão e não pode ser utilizado na presença de equipamentos anestésicos inflamáveis.
- Não jogue a bateria no fogo visto que pode explodir e causar dano.
- Não tente recarregar pilhas normais visto que podem vaziar e causar incêndio ou mesmo explosão.
- Utilize somente adaptadores em conformidade com a IEC 60950.
- Não toque simultaneamente na entrada/saída de sinal do conector e no paciente para evitar danos ao equipamento.
- Acessórios e equipamento conectados à interface analógica e digital devem ser certificados de acordo com a respectiva norma IEC.
- A bateria deve ser retirada do equipamento se este não for utilizado por um longo período de tempo.
- O operador não deve entrar em contato com o paciente quando estiver trocando a bateria ou abrindo a tampa de cobertura da bateria.

- O equipamento é um instrumento para auxiliar na detecção de FHR e não deve ser utilizado no lugar de monitoramento fetal normal.
 - A substituição da bateria deve ser realizada somente em ambiente distante do paciente (pelo menos 1,5m de distância).
 - Por favor, utilize somente transdutores fornecidos pelo fabricante.
 - Não estenda o fio do transdutor mais que 2 metros visto que o transdutor pode se desprender do equipamento.
 - O equipamento está projetado para operação contínua e em condições habituais. Não imergir em nenhum líquido (não é à prova de gotejamento ou respingos).
 - Mantenha o equipamento limpo. Evite vibrações.
 - Não utilize nenhum processo de esterilização por alta temperatura ou esterilização por radiação gama.
 - O equipamento não está sujeito a nenhuma fonte de interferência eletromagnética forte, como transmissores de rádio e telefones móveis devido à interferência eletromagnética.
 - O usuário deve verificar se o equipamento não apresenta nenhum dano visível de modo que possa afetar a segurança do paciente ou capacidade de monitoramento antes do uso. O intervalo recomendado para inspeção é uma vez ao mês ou antes. Se o dano está evidente, é recomendada a substituição antes do uso.
 - O equipamento não deve ser usado quando alguns equipamentos estão em uso como gerador elétrico de alta frequência, forno de micro-ondas e telefone móvel.
 - Não use o equipamento na presença de mistura de anestésicos inflamáveis com oxigênio ou outros gases inflamáveis.
 - O equipamento está projetado para operação em curto intervalo de tempo.
 - Por favor, pare de utilizar o equipamento para arrumar adequadamente se alguma parte do equipamento não está apropriadamente fixada, como por exemplo, a cobertura da bateria.
 - O equipamento é adequado para uso domiciliar e instituições que não possuem responsáveis com habilidades especiais, treinamento e conhecimento.
- O manual de operação está escrito em um nível descomplicado, de fácil compreensão, para pessoas que não possuem treinamento ou conhecimento especial. Para utilização em hospitais e clínicas, o operador precisa ter certificado de qualificação. Para uso doméstico, quando as informações são usadas para diagnóstico, é necessário que a análise seja feita por um médico pessoal especializado.
- Esta qualificação mínima de serviço deve ser familiar para a operação do aparelho e técnicas de serviço.
 - A seguinte lista de verificação de segurança deve ser realizada a cada 6 (seis) meses ou como especificado nos testes e protocolos de inspeção da instituição por pessoal qualificado, com treinamento adequado, conhecimento e experiência prática para realização.
1. Inspeção o equipamento para possíveis danos mecânicos e funcionais.
 2. Inspeção as etiquetas de segurança e legitimidade.
 3. Verifique se o equipamento funciona apropriadamente como descrito no manual de operação.
 4. O teste de corrente de fuga do paciente de acordo com a IEC 60601-1 é limitado até 100µA. A corrente de fuga nunca deve exceder o limite. Se o equipamento não funcionar adequadamente ou falhar em qualquer dos testes acima, o equipamento deve ser reparado.

- As pilhas devem ser adequadamente descartadas de acordo com os regulamentos locais após o uso.
- As pilhas devem ser retiradas do equipamento se o mesmo não for utilizado por um longo período.
- O equipamento só deve ser usado quando a cobertura do compartimento da pilha estiver fechada.
- As pilhas devem ser armazenadas em lugar seco e fresco.
- Se utilizar baterias recarregáveis, certifique-se da capacidade e vida útil, carregue-as totalmente antes do primeiro uso. Normalmente as baterias podem ser carregadas continuamente por 2 horas ou conforme orientações dispostas na própria bateria.
- Por favor, não coloque os polos negativo e positivo da bateria incorretamente.
- As informações deste manual estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
- Não utilize solventes fortes (acetona, por exemplo) e materiais abrasivos para limpar o equipamento.
- Não permita que nenhum líquido penetre no equipamento e não emergir nenhuma parte do equipamento em nenhum líquido.
- Por favor, escolha acessórios e extensões autorizados pelo fabricante.
- Nunca tente esterilizar o transdutor ou o equipamento por vapor a baixa temperatura ou outros métodos.

2. VISÃO GERAL

O Doppler Fetal Portátil FD-200 MD é um detector da frequência cardíaca fetal de alta performance que satisfaz as exigências para exame de FHR em hospitais, clínicas, comunidades e uso domiciliar.

O equipamento consiste em um emissor e receptor de sinal ultrassônico, unidade de processamento de computador, visor LCD, alto-falante, teclas operacionais e fonte de alimentação.

3. CARACTERÍSTICAS

Cada modelo do Doppler Fetal possuem diferentes características como indicadas abaixo.

Função	FD-200A	FD-200B	FD-200C	FD-200D
Visor de LCD	Não	P/B	Colorido	P/B
Luz de Fundo	Não	Sim	Sim	Sim
Alto-falante	Sim	Sim	Sim	Sim
Modos de Visualização	Não	Não	Sim	Não
Ajuste de Volume	Sim	Sim	Sim	Sim
Indicador de carga da bateria / pilha	Não	Sim	Sim	Sim
Visor da FHR	Não	Sim	Sim	Sim
Curva da FHR	Não	Não	Sim	Não
Desligamento automático	Não	Sim	Sim	Sim
Modos de operação	Não	Sim	Sim	Sim
Pilhas	Sim	Sim	Sim	Sim
Bateria recarregável	Não	Não	Sim	Sim
Carregador interno	Não	Não	Sim	Sim
Fones de ouvido				Opcional
Bolsa de transporte				Opcional
Transdutor 2.0 Mhz				Incluso
Transdutor 2.5 Mhz				Opcional
Transdutor 3.0 Mhz				Opcional

4. INDICAÇÃO DE USO

O **Doppler Fetal Portátil FD-200 MD** é utilizado para detecção da frequência cardíaca fetal. O equipamento pode ser utilizado por profissionais da saúde com técnicas especializadas em hospitais, clínicas, comunidades e domiciliar.

Troca fácil do transdutor através da conexão de engate rápido. Transdutores de 2.0MHz, 2.5MHz e 3.0MHz são utilizados para detecção da FHR.

5. APRESENTAÇÃO GERAL

A Doppler Fetal

B Visor

C Indicador de funcionamento

D Tecla Liga/Desliga

E Altoparlante

F Transdutor

G Indicador de carga*

H Tecla diminuir volume


I Tecla aumentar volume

J Entrada DC*

K Entrada para fones de ouvido

L Conector do transdutor

*disponíveis em alguns modelos, consultar modelo em tabela de características

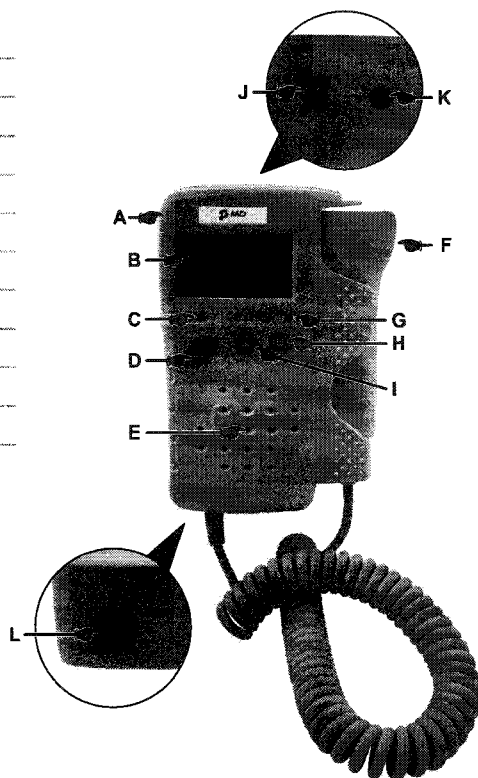


6. VISORES

6.1. VISOR MODELO FD-200A

O modelo **Doppler Fetal Portátil FD-200A MD**, não possui visor com função.


6.2. VISOR MODELO FD-200C

- A Volume da Voz
- B Batimento por minuto da FHR.
- C Alarme Ligado/Desligado
- D Sinal da FHR. Este sinal pisca com o batimento cardíaco
- E Modo de trabalho
- F Frequência do transdutor
- G Carga da bateria

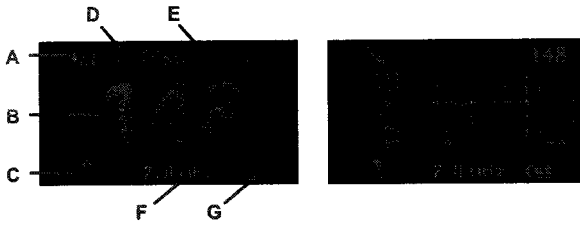


6.3. VISOR MODELOS FD-200B E FD-200D


- A Sinal da FHR. Este sinal pisca com o batimento cardíaco
- B Modo de trabalho
- C Quantidade de movimento por minuto da FHR
- D Carga da bateria
- E Intensidade de sinal da FC
- F Alarme Ligado/Desligado
- G Batimento por minuto da FHR.

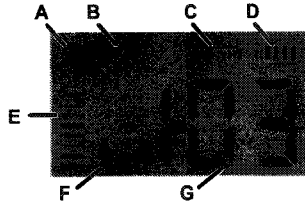

7. TECLAS E LUZES INDICADORAS

7.1. AJUSTE DO VOLUME


Diminuir Volume: Quando o equipamento está ligado, se o som está muito alto, pressione a tecla , o volume será reduzido.

Aumentar Volume: Quando o equipamento está ligado, se o som está muito baixo, pressione a tecla , o volume será aumentado.


7.2. LIGA/DESLIGA

Pressione a tecla  para ligar o equipamento e pressione a mesma tecla por 3 segundos para desligar.

7.3. MODO DE CONFIGURAÇÃO

Quando o equipamento é ligado, pressione a tecla  uma vez, o símbolo do código do modo de operação piscará, isso significa que o modo pode ser selecionado.

7.4. SELECIONANDO O MODO

Quando o símbolo do modo estiver piscando, pressione a tecla  uma vez para selecionar o modo. O equipamento vai operar sob o modo configurado e exibido.

7.1 LUZ DE INDICAÇÃO

Luz indicadora de carga da bateria: Há uma luz indicadora de carga abaixo do visor com a indicação de uma pilha ao lado. Quando a bateria é carregada, a luz indicadora é exibida na cor laranja. Quando a carga da bateria está completa, a luz indicadora torna-se verde.

Luz indicadora de funcionamento: Quando o equipamento for ligado acenderá uma luz indicadora verde ou azul, dependendo do modelo, acima do botão Liga/Desliga.

7.2 TRANSDUTORES

A frequência básica do transdutor é 2.0MHz ($\pm 10\%$). As frequências de 2.5 MHz e 3.0MHz ($\pm 10\%$) são opcionais.

8. INSTRUÇÕES DE USO

Cuidadosamente verifique se o equipamento não tem nenhum dano e os acessórios estão íntegros. Se encontrar algum dano, contate imediatamente o fabricante ou distribuidor local autorizado.

8.1 UTILIZANDO A PILHA OU BATERIA

Retirada das Pilhas ou Bateria: Vire o painel posterior para cima. Segure a unidade principal com uma das mãos. Pressione a tampa do compartimento da bateria com o polegar da outra mão. Deslize a tampa ao longo da unidade de modo a permitir a retirada das pilhas ou bateria.

Insira as Pilhas ou Bateria na porta de entrada,

Coloque a tampa da bateria, deslize a tampa em direção ao topo do corpo do dispositivo até fechar o compartimento.

8.1.1 SUBSTITUINDO OU CARREGANDO A BATERIA

Quando a carga da bateria do equipamento estiver baixa desligue o dispositivo e substitua ou carregue a bateria.

Para carregar a bateria recarregável, insira o plugue DC do carregador na porta de entrada de carga do equipamento e conecte o plugue AC na fonte de alimentação de 100-240 VAC, 50/60 Hz.


O tempo para a carga total da bateria levará cerca de 2 horas. Enquanto estiver carregando, a luz LED do carregador ficará laranja; quando a bateria estiver totalmente carregada a luz de LED ficará verde.

ATENÇÃO!

- Quando em funcionamento, as baterias recarregáveis não podem ser recarregadas. Quando as baterias recarregáveis estiverem recarregando o equipamento não pode operar.
- O equipamento somente pode ser utilizado quando o carregador for desconectado do equipamento.

8.2 OPERANDO O TRANSDUTOR

Segure a unidade principal do equipamento com uma das mãos, segure a parte de cima do transdutor e retire-o por completo do compartimento.



8.3. LIGANDO O EQUIPAMENTO

Ligue ao pressionar a tecla , a luz indicadora de funcionamento irá brilhar.

8.4. CONFIGURANDO OS MODOS DE OPERAÇÃO

8.4.1. MODOS DE OPERAÇÃO

Para o modelo FD-200A a FHR é calculada manualmente.

Para os modelos FD-200D, FD-200B e FD-200E os modos de operação são:

1. Modo Tempo Real
2. Modo Média
3. Modo Manual
4. Modo Congelar
5. Modo Onda

Para os modelos FD-200, FD-200G e FD-200P os modos de operação são Modo Tempo Real, Modo Média, Modo Manual, Modo Congelar e Modo Onda.

1. Modo Tempo Real: Neste modo, o símbolo  piscará no visor e a FHR em tempo real será exibida simultaneamente.

2. Modo Média: Este modo é utilizado para obter o valor de FHR mais estável. O visor exibe o símbolo  piscando quando a FHR é exibida.

3. Modo Manual: Ao final da seleção deste modo, pressione a tecla  para iniciar a contagem da FHR até a tecla  seja pressionada novamente. A FHR será automaticamente calculada e exibida no visor.

4. Modo Congelar: Quando estiver operando por algum dos modos Tempo Real, Modo Média, Modo Manual e Modo Onda, selecione o Modo Congelar, e a FHR ou a curva da FHR será congelada no visor. Este modo será mantido até o início da próxima medição ou quando o modo for alterado.

5. Modo Onda: Neste modo o visor exibirá a curva da FHR e parâmetros relacionados.

8.4.2. SELECIONANDO OS MODOS

Pressione a tecla  sequencialmente e os modos são alterados para cada operação.


Os parâmetros de alarme e luz de fundo para os modelos FD-200D, FD-200B e FD-200E são configurados ao pressionar as teclas  e .

8.5. CONFIGURANDO PARÂMETROS

Pressione as teclas  e  simultaneamente, o menu será exibido, para os modelos FD-200C, FD-200G e FD-200P.

Pressione as teclas  ou  para selecionar o item e parâmetro desejados; pressione a tecla  para confirmar.

Selecione "RETURN" e pressione a tecla  para retornar ao estado da operação.



Parâmetro	Definição	Valor Seleccionável	Configuração Padrão
ALARME-SUP-FHR (FHR-ALM-HI)	Limite superior de alarme para a FHR	50-240 bpm	160 bpm
ALARME-INF-FHR (FHR-ALM-LOW)	Limite inferior de alarme para a FHR	50-240 bpm	120 bpm
MODO (ALARM SWITCH)	Altera alarme de voz	LIGA ou DESLIGA	LIGA
VOLTAR (RETURN)	Retorna ao estado de operação	/	/

9. INSPECIONANDO A FHR

9.1. USO DO GEL

A aplicação do gel ultrassônico aplicada corretamente na superfície acústica do transdutor diminui ruídos e otimiza o resultado do teste.

9.2. ENCONTRANDO A POSIÇÃO DO FETO

Primeiramente, procure a posição do feto pelas mãos. Coloque a superfície operacional do transdutor no abdômen com um contato firme e adequado. Ajuste a posição do transdutor de modo a obter um ótimo sinal audível.



NOTA:

- Não comprima o transdutor com muita força na superfície do abdômen para evitar comprometer o sinal.
- Quando estiver procurando os batimentos cardíacos do feto, não deslize o transdutor ao longo da superfície abdominal para evitar ruídos.
- Não posicione o transdutor onde há forte som do sangue placentário ou forte som umbilical.

9.3. INSPECIONANDO A FHR

Após finalizada a configuração do modo e parâmetros, pressione a tecla Liga/Desliga para iniciar a operação, pressione a tecla Liga/Desliga novamente para terminar a operação.



NOTA:


- Não avalie a FHR enquanto não escutar um som fetal identificável e audível, usualmente isso acontece em 5 segundos.
- A faixa de valor normal para a frequência cardíaca fetal é 120-160 bpm. Os valores compreendidos entre 100-120 bpm e 160-180 bpm são valores críticos e devem ser investigados com atenção.

9.4. LIMPEZA APÓS O USO

Após finalizar o uso do equipamento, desligue-o e remova o gel da superfície do transdutor e da pele de modo a limpá-los, coloque o transdutor no seu compartimento de fixação no equipamento.

9.5. GRAVAR, REPRODUZIR E TRANSFERIR

O sinal do som fetal pode ser transferido para o computador e gravado por um gravador de som. O arquivo do som pode ser reproduzido, transferido para CD ou enviado por e-mail. Siga as instruções correspondentes do software.



10. LIMPEZA

Antes de limpar o equipamento desligue-o e remova a bateria da unidade principal.

Mantenha a superfície externa do equipamento limpa, livre de sujeira e poeira com um pano macio e seco. Se necessário, limpe a placa de identificação com um pano macio umedecido com solução detergente ou água e pano seco.

Limpe o transdutor com pano macio para remover qualquer remanescente do gel ultrassônico. Limpe somente com água e sabão.

11. DESINFECÇÃO

Limpe o estojo do equipamento, sonda e demais partes como indicado acima. Em seguida, limpe o transdutor com pano umedecido com álcool etílico 70%.

Limpe o transdutor com pano limpo e seco para remover qualquer umidade remanescente.

11. MANUTENÇÃO

O dispositivo é um equipamento de precisão e a superfície acústica do transdutor é frágil, assim você deve cuidar o equipamento e especialmente o transdutor com cuidado suficiente.

A camada de poeira e gel deve ser removida e limpa do transdutor antes e após cada uso. Essas precauções prolongam a vida útil da unidade e mantêm a precisão do equipamento.

Antes do uso, o usuário deve certificar que o equipamento não tem nenhuma evidência de dano que possa afetar a segurança do paciente ou a capacidade do dispositivo. O intervalo recomendado para a inspeção é uma vez por semana. Se houver evidência de algum dano, é recomendada a reparação antes do uso.

O equipamento deve ser submetido a testes periódicos de segurança para assegurar a isolamento apropriada do paciente de corrente de fuga do equipamento. Estes testes devem incluir a medição da corrente de fuga. O intervalo recomendado para os testes é uma vez a cada 2 (dois) anos ou conforme o protocolo de inspeção e testes padronizados pela instituição.

A precisão da FHR é controlada pelo equipamento e não pode ser ajustada pelo usuário. Se o resultado da FHR não for confiável, favor utilize outro método como um estetoscópio e verifique imediatamente ou contate o distribuidor local autorizado ou o fabricante para auxílio.

12. SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Quando em funcionamento, se aparecer os seguintes problemas, favor siga estas instruções. Se houver falha na resolução do problema contate o distribuidor local autorizado ou Suporte Técnico.

	Possível Causa	Solução
Sem Som	(1) Carga da bateria insuficiente; (2) O equipamento está danificado; (3) O cabo de conexão da bateria está danificado.	(1) Carregue ou substitua a bateria; (2) Inspeção o equipamento; (3) Contate o distribuidor autorizado ou fabricante.
Som Fraco	(1) Volume de voz está muito baixo; (2) Carga da bateria baixa; (3) Gel insuficiente ou sem gel.	(1) Aumente o volume de voz; (2) Carregue ou substitua a bateria; (3) Adicione gel suficiente na superfície do transdutor.
Problema	(1) O transdutor está muito próximo da unidade principal; (2) Interferência por sinais externos; (3) Carga da bateria baixa.	(1) Mantenha distância suficiente entre o transdutor e a unidade principal; (2) Mantenha distância dos sinais externos; (3) Carregue ou substitua a bateria.
Sensibilidade	(1) A posição do transdutor está incorreta; (2) Gel insuficiente ou sem gel.	(1) Mantenha o transdutor em posição correta; (2) Mantenha camada suficiente de gel.



13. ARMAZENAMENTO E CONSERVAÇÃO

Evite que o aparelho **Doppler Fetal Portátil FD-200 MD** entre em contato com líquidos ou receba choques mecânicos, isso pode prejudicar a funcionalidade do aparelho.

Armazene o **Doppler Fetal Portátil FD-200A MD** em local limpo e seco e em condições de temperatura adequadas (ambiente).

Evite armazenar o equipamento em ambiente com alta umidade ou salinidade (maresia).

13.1 CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Condições de Operação	Temperatura: 5°C a 40°C; Umidade Relativa: 25% a 80%; Pressão Atmosférica: 86 a 106 kPa.
Condições de Armazenamento e Transporte:	Temperatura: -25°C a 70°C; Umidade Relativa: 0% a 93%; Pressão Atmosférica: 70 a 106 kPa.

13.2 GARANTIA

Garantimos que o produto quando novo está isento de defeitos originais de material ou mão-de-obra e funciona segundo as especificações do fabricante sob condições normais de uso e serviço. O período de garantia legal do equipamento é de:

- ✓ 01 (um) ano para o dispositivo **Doppler Fetal Portátil FD-200 MD** (sendo 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do Art. 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor + 9 meses de garantia concedida pelo detentor);
- ✓ 06 (seis) meses para os acessórios e para o transdutor doppler (sendo 3 meses referentes à garantia legal, nos termos do Art. 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor + 3 meses de garantia concedida pelo detentor);

tendo início na data de compra do produto. Na eventualidade de uma avaria ou falha dentro do período de garantia, o cliente deverá entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada e informar o produto, o número de lote, a data de compra e uma breve explicação do defeito identificado. A obrigação do fabricante ou distribuidor autorizado limita-se ao reparo ou substituição dos componentes que o mesmo considerar como defeituosos dentro do período de garantia.

Essas garantias são atribuídas ao comprador original e não podem ser cedidas ou transferidas a terceiros. Essa garantia não se aplica a danos ou defeitos considerados terem sido causados por uso indevido, acidente (inclusive danos de transporte), defeitos por calamidades naturais, negligência, manutenção inadequada, modificação ou reparo por outras pessoas além dos técnicos autorizados.

15. ASSISTÊNCIA TÉCNICA AUTORIZADA

Consulte o nosso Suporte Técnico sobre quaisquer dúvidas sobre o funcionamento ou operação do dispositivo, bem como reparos ou manutenção corretiva que venham ser necessárias.

Consulte o nosso Suporte Técnico e Assistências Técnicas Autorizadas:

Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda.

R. Júlio Bartolomeu Tabora Luiz, 270 – Bairro: Atuba – CEP 82600-070 – Curitiba, PR.

Tel.: (41) 2102-8344

E-mail: Suporte Técnico: suporte@macrosul.com

Serviço de Atendimento ao Cliente: sac@macrosul.com



16. ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

Nome Técnico do Produto: Doppler Fetal Portátil FD-200 MD

Modelos: FD-200A, FD-200B, FD-200C, FD-200D, FD-200E, FD-200G e FD-200P.

Normas de Segurança: IEC 60601-1; IEC 60601-1-2; IEC 60601-1-11; IEC 61266; IEC 60601-2-37; IEC 60601-1-6; IEC 60601-1-9.

Classificação:

- Grau de Proteção Elétrica: Equipamento Tipo BF
- Grau de Proteção contra Líquidos: Equipamento: IPX0;
Transdutor de ultrassom: IPX1 (protegido contra a entrada vertical de pingos d'água ou condensação).
- ✓ Grau de Segurança na Presença de Gases Inflamáveis: Não apropriado para uso em presença de gases inflamáveis.
- Sistema de Operação: Equipamento de Operação Contínua
- Compatibilidade Eletromagnética (EMC): Grupo I Classe B

Características Físicas:

- Dimensões: 135mm x 95mm x 35mm
- Peso: aprox. 500g (com pilhas)

Sensibilidade: A partir de 10-12 semanas.

Visor LCD: 45mm x 25mm - 1,9"

Performance FHR:

- Faixa de Medição: 50-240 bpm
- Resolução: 1 bpm
- Precisão: ± 1 bpm
- Filtro minimizador de interferências e redução de ruídos durante a utilização
- Saída de Energia: <20mW
- Desligamento automático: o dispositivo desliga-se automaticamente após 1 minuto sem sinal (exceto o modelo FD-200A).

Fonte de Alimentação Recomendada:

- Para os modelos FD-200D e FD-200C: Duas (2) unidades de baterias recarregáveis NI-MH 1.2V DC. Bateria recarregável 9V DC opcional.
- Para os modelos FD-200A e FD-200B: Duas (2) unidades de pilhas 1.5V DC tamanho AA LR6. Pilha alcalina 9V DC opcional.

Autonomia da Bateria

- Autonomia da pilha AA: 7 horas de uso contínuo.
- Autonomia da bateria recarregável NI-MH: 5 horas de uso contínuo.

Transdutor:

- Frequência Nominal: 2.0MHz
- Frequência de Operação: 2.0MHz $\pm$ 10%
- P: <1Mpa
- Iob: <20 mW/cm²
- Ispta: <100 mW/cm²
- Intensidade de Saída de Ultrassom: Isata <10 mW/cm²
- Área de Radiação Efetiva do Transdutor: 154mm²

Ambiente de Contato Recomendado:

- Estimulação na pele: Não
- Quantidade total de micro-organismos: <1000 un/g
- Sem metabólitos residuais de Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa e Staphylococcus aureus
- Velocidade acústica: 1520-1620 m/s
- Impedância acústica: 1.5 – 1.7x10⁶ Pa.s/m
- Atenuação acústica: <0.05dB/(cm.MHz)
- Viscosidade: >15Pa.s
- Valor de pH: 5,5–8

Modo de Trabalho: Doppler de Onda Contínua

17. SENSIBILIDADE GERAL

Distância da área acústica do transdutor	200 mm	100 mm	75 mm	50 mm
Frequência Acústica Nominal de Operação	2.0 Mhz	2.0 Mhz	2.0 Mhz	2.0 Mhz
Frequência do Doppler	332 Hz	332 Hz	332 Hz	332 Hz
Velocidade alvo	4.8 cm/s	4.8 cm/s	4.8 cm/s	4.8 cm/s
A(d). Perda do alvo por reflexão	44.5 dB	44.5 dB	44.5 dB	44.5 dB
B: Atenuação bidirecional ao longo do percurso acústico	45.1 dB	45.1 dB	45.1 dB	45.1 dB
C: Relação Sinal/Ruído	Vs: 188mV Vr: 60mV C=9.9dB	Vs: 192mV Vr: 60mV C=10.1dB	Vs: 196mV Vr: 61mV C=10.1dB	Vs: 199mV Vr: 62mV C=10.2dB
S: Sensibilidade Geral	S=99.5dB	S=101dB	S=101dB	S=106.5dB
Informações complementares: --				

18. SÍMBOLOGIA

18.1 SÍMBOLOGIA NO EQUIPAMENTO

CCL
FLS. 864

Símbolo	Descrição
	Equipamento Energizado internamente, parte aplicada Tipo BF.
	O equipamento deve ser descartado adequadamente de acordo com os regulamentos locais para descarte de lixo eletrônico. Procure o centro de coleta mais próximo de sua região.
	Atenção.
	Consulte as Instruções no manual do usuário.
	Proteja da chuva/mantenha seco.
	Referência do Produto.
	Número de Série.
	Indicação de potencia.
	Dados do Fabricante.
	Data de Fabricação.
	Informações do Representante Autorizado no Brasil.
	Entrada para fone de ouvido.
	Marca de polaridade do conector (FD-200C e FD200D).
	Indicador de funcionamento.
	Indicador de carga da bateria / pilha.
	Conexão do transdutor.
IPX1	Protegido contra a entrada vertical de pingos d'água ou condensação.
	Selo de Conformidade de equipamento eletromédico certificado pelo INMETRO. Certificação compulsória para a avaliação da segurança elétrica.

Símbolo	Descrição
	Equipamento Energizado internamente, parte aplicada Tipo B.
	Consulte as Instruções no manual do usuário.
	O equipamento deve ser descartado adequadamente de acordo com os regulamentos locais para descarte de lixo eletrônico. Procure o centro de coleta mais próximo de sua região.
BR REP	Informações do Representante Autorizado no Brasil.
	Dados do Fabricante.
	Data de Fabricação.
NS	Número de Série.
REF	Referência do Produto.
	Indicação de validade.
	Selo de Conformidade de equipamento eletromédico certificado pelo INMETRO. Certificação compulsória para a avaliação da segurança elétrica.
	Indicação temperatura de armazenamento.
	Indicação umidade relativa de armazenamento.
	Indicação pressão atmosférica de armazenamento.
	Proteja da chuva/mantenha seco.
	Proteger do sol e luz.
	Quantidade de empilhamento.

Diretrizes e Declarações de Conformidade Eletromagnética para o Doppler Fetal Portátil FD-200 MD		
O Doppler Fetal Portátil FD-200 MD é destinado para uso em ambiente eletromagnético especificado abaixo. O cliente ou o usuário do Doppler Fetal Portátil FD-200 MD deve assegurar que ele seja utilizado conforme o ambiente.		
Teste de emissão	Conformidade	Ambiente Eletromagnético – Orientação
CISPR 11 - Emissões de Radiofrequência (RF)	Grupo 1	O Doppler Fetal Portátil FD-200 MD utiliza energia de RF apenas para o seu funcionamento interno. Portanto, suas emissões de RF são muito baixas e é improvável que causem qualquer interferência em equipamentos eletrônicos próximos.
CISPR 11 - Emissões de Radiofrequência (RF)	Classe B	O Doppler Fetal Portátil FD-200 MD é adequado para uso em todos os estabelecimentos, incluindo ambientes domésticos e locais conectados diretamente à rede elétrica de baixa tensão que fornece energia a edifícios usados para fins domésticos.
IEC 61000-3-2 - Emissões Harmônicas	Classe A	
IEC 61000-3-3 - Flutuações de tensão/ Emissões com tremulação	Conforme	

Tabela 2 - Diretrizes de Conformidade Eletromagnética para o Doppler Fetal Portátil FD-200 MD			
O Doppler Fetal Portátil FD-200 MD é destinado para uso em ambiente eletromagnético especificado abaixo. O usuário do Doppler Fetal Portátil FD-200 MD deve assegurar que ele seja utilizado conforme o ambiente.			
Teste de Imunidade	Nível de Teste IEC 60601	Nível de Conformidade	Ambiente Eletromagnético-Guia
IEC 61000-4-2 Descarga Eletrostática (ESD).	± 6 kV contato ± 8 kV ar	± 6 kV contato ± 8 kV ar	O piso deve ser de madeira, concreto ou cerâmica. Se o piso for coberto com material sintético, a umidade relativa deve ser de pelo menos 30%.
IEC 61000-4-4 Imunidade Elétrica a Exposição.	± 2kV para linhas de corrente elétrica	± 2kV para linhas de corrente elétrica	A qualidade da corrente elétrica deve ser semelhante à de um ambiente comercial ou hospitalar típico.
IEC 61000-4-5 Surto de Tensão.	± 1kV linha(s) para linha(s) (modo diferencial) ± 2kV linha(s) para terra (modo comum)	± 1kV linha(s) para linha(s) (modo diferencial) ± 2kV linha(s) para terra (modo comum)	A qualidade da corrente elétrica deve ser semelhante à de um ambiente comercial ou hospitalar típico.
IEC 61000-4-11 Quedas, Curtas Interrupções e Variações de Tensão nas linhas de alimentação.	<5% UT(>95% de queda em UT) para 0,5 ciclo 40% UT(60% de queda em UT) para 5 ciclos 70% UT(30% de queda em UT) para 25 ciclos <5% UT(>95% de queda em UT) para 5 seg	<5% UT(>95% de queda em UT) para 0,5 ciclo 40% UT(60% de queda em UT) para 5 ciclos 70% UT(30% de queda em UT) para 25 ciclos <5% UT(>95% de queda em UT) para 5 seg	A qualidade da corrente elétrica deve ser semelhante à de um ambiente comercial ou hospitalar típico. Se o usuário do Doppler Fetal Portátil FD-200 MD necessitar de funcionamento contínuo durante as interrupções de energia, recomenda-se que o Doppler Fetal Portátil FD-200 MD seja alimentado por uma fonte de alimentação contínua ou por bateria.
IEC 61000-4-8 Campo Magnético da Frequência da Corrente (50/60 Hz).	30 A/m	30 A/m	Os campos magnéticos da frequência de alimentação devem estar em níveis característicos de um ambiente hospitalar ou comercial típico.

NOTA: UT é a tensão CA da rede elétrica antes da aplicação do nível de teste.

Tabela 3 - Diretrizes e separação de equipamentos

O Doppler Fetal Portátil FD-200 MD deve ser utilizado em ambientes eletromagnéticos conforme especificados abaixo.
O Doppler Fetal Portátil FD-200 MD deve assegurar que o equipamento seja utilizado conforme o ambiente.

Nível de Imunidade	Nível de teste IEC 60601	Nível de Conformidade	Ambiente Eletromagnético - Guia
IEC 61000-4-6 RF Transmitida	3 Vrms 150 KHz a 80 Mhz	Não Aplicável	Equipamentos de comunicação de RF portáteis e móveis não devem ser utilizados próximos a qualquer parte do Aparelho, incluindo cabos, menor que o afastamento recomendado calculado a partir da equação aplicável à frequência do transmissor. Afastamento recomendado: $d = 1,2 \sqrt{P}$ $d = 1,2 \sqrt{P}$ 80 MHz a 800MHz $d = 2,3 \sqrt{P}$ 800MHz a 2,5GHz Onde "P" é a potência nominal máxima de saída do transmissor em Watts (W) de acordo com o fabricante do transmissor e "d" o afastamento recomendado em metros. A intensidade de campo de transmissores RF fixos determinadas por uma inspeção eletromagnética deverão ser menor que o nível de conformidade para cada faixa de frequência b. Poderão ocorrer interferências em áreas próximas a equipamentos marcados com o seguinte símbolo: 
IEC 61000-4-3 RF Radiada	3 V/m 80MHz a 2,5 Ghz	3 V/m	

NOTA 1: A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a maior gama de frequência.

NOTA 2: Estas diretrizes podem não ser aplicáveis em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.

a. A intensidade de campo a partir de transmissores fixos, como por exemplo, estações base para telefone por ondas de rádio (celulares/sem fio) e rádios móveis terrestres, rádio amador, transmissores de radiodifusão (AM e FM) e televisão não pode ser prevista teoricamente com exatidão. Para avaliar o ambiente eletromagnético causado por transmissores RF fixos, uma inspeção eletromagnética deverá ser considerada. Se a intensidade do campo magnético no local em que o Doppler Fetal Portátil FD-200 MD for utilizado ultrapassar o nível de conformidade de RF aplicável mencionada acima, deverá ser observado se o Doppler Fetal Portátil FD-200 MD está funcionando normalmente. Se um desempenho anormal for observado, poderá ser necessário tomar medidas adicionais, como a alteração da posição do Doppler Fetal Portátil FD-200 MD.

b. Na faixa de frequência 150kHz a 80MHz, a intensidade do campo deverá ser menor que 3V/m.

Tabela 4 - Distância de separação recomendada entre o SISTEMA - Doppler Fetal Portátil e equipamentos de comunicação RF portáteis e móveis

Distância de separação recomendada entre equipamentos de comunicação RF portáteis e móveis e o Doppler Fetal Portátil FD-200 MD.

O Doppler Fetal Portátil FD-200 MD é destinado ao uso em um ambiente eletromagnético no qual perturbações de RF irradiadas são controladas. O cliente ou o usuário do Doppler Fetal Portátil FD-200 MD pode ajudar a prevenir interferência eletromagnética mantendo uma distância mínima entre equipamentos de comunicação RF portátil e móvel (transmissores) e o Doppler Fetal Portátil FD-200 MD conforme recomendado abaixo, de acordo com a potência máxima de saída do equipamento de comunicação.

Potência de saída nominal máxima do transmissor / W	Distância de separação de acordo com a frequência do transmissor / m.		
	150 kHz to 80 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$	80 MHz to 800 MHz $d = 1,2 \sqrt{P}$	800 MHz to 2,7 GHz $d = 2,3 \sqrt{P}$
0,01	0,12	0,12	0,23
0,1	0,38	0,38	0,73
1	1,2	1,2	2,3
10	3,8	3,8	7,3
100	12	12	23

Para transmissores com uma potência máxima de saída não listada acima, a distância d de separação recomendada em metros (m) pode ser estimada usando a equação aplicável à frequência do transmissor, onde P é a potência máxima de saída do transmissor em watts (W) de acordo com o fabricante do transmissor.

NOTA 1: A 80 MHz e 800 MHz, aplica-se a distância de separação para a maior gama de frequência.

NOTA 2: Estas diretrizes podem não ser aplicáveis em todas as situações. A propagação eletromagnética é afetada pela absorção e reflexão de estruturas, objetos e pessoas.



Vcomin Technology Limited
3 Fl., No. 1, Kangzheng Road,
Buji Town, Shenzhen
China



Comércio de Materiais Médicos Hospitalares Macrosul Ltda
CNPJ: 95.433.397/0001-11
Rua Júlio Bartolomeu Taborda Luiz, 270, Atuba - CEP 82600-070
Curitiba - PR
Resp. Técnica Carolina Verônica da Cruz Cebola CRF/PR 21294
Registro ANVISA n° 80070210067

Suporte Técnico

e-mail: suporte@macrosul.com
Site: www.macrosul.com
Telefone: (41) 2102-8344

Serviço de Atendimento ao Cliente

e-mail: sac@macrosul.com
Telefone: (41) 2102-8300

PARECER TÉCNICO

Nº 015 / 2025

Para: Departamento de licitações e contratos

Assunto: Aquisição de equipamento e material permanente para atender as necessidades das unidades básicas de saúde de Caxias Maranhão.

B.D.R COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA, CNPJ 52.496.119/0001-09 - PREGÃO ELETRÔNICO 053/2024

Analizamos a descrição do item 08, 049, 050, 094 e 131

FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

Avaliação técnica é uma alternativa de que dispõe o gestor público, para assegurar a qualidade, tendo como objetivo verificar a descrição do produto ofertado aos requisitos de qualidade e desempenho estabelecidos no instrumento convocatório.

Decido pela APROVAÇÃO DO ÍTENS 08, 049, 050, 094 e 131 Produtos atendem as necessidades solicitadas.

É o parecer.

Caxias Ma, 21 de Janeiro de 2025

Eli Marcos Santana Farias
Coordenador Administrativo
Mat. 9598-2

Coordenador Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde

PARECER TÉCNICO

Nº 016 / 2025

Para: Departamento de licitações e contratos

Assunto: Aquisição de equipamento e material permanente para atender as necessidades das unidades básicas de saúde de Caxias Maranhão.

VIMASI - DISTRIBUIDORA, CNPJ 29.576.243/0001-54 - PREGÃO ELETRÔNICO 053/2024

Analizamos a descrição do item 17, 25 e 31


FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

Avaliação técnica é uma alternativa de que dispõe o gestor público, para assegurar a qualidade, tendo como objetivo verificar a descrição do produto ofertado aos requisitos de qualidade e desempenho estabelecidos no instrumento convocatório.

Decido pela APROVAÇÃO DO ÍTENS 17, 25 e 31 Produtos atendem as necessidades solicitadas.

É o parecer.

Caxias Ma, 21 de Janeiro de 2025

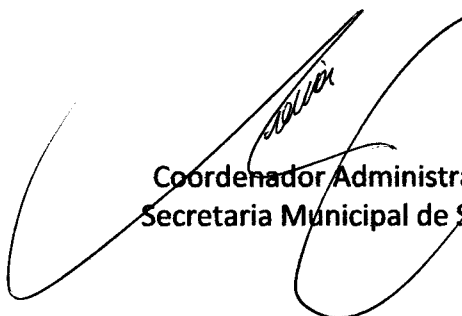
Eli Marcos Santana Farias
Coordenador Administrativo
Mat. 9598-2

Coordenador Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde

PARECER TÉCNICO

Nº 017 / 2025

Para: Departamento de licitações e contratos

Assunto: Aquisição de equipamento e material permanente para atender as necessidades das unidades básicas de saúde de Caxias Maranhão.

K.D.N. COMERCIO ATACADISTA LTDA, CNPJ 39.346.590/0001-44 - PREGÃO ELETRÔNICO 053/2024

Analisamos a descrição do item 61, 66, 68, 69, 74, 106, 114, 115, 118, 124 e 129.

FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

Avaliação técnica é uma alternativa de que dispõe o gestor público, para assegurar a qualidade, tendo como objetivo verificar a descrição do produto ofertado aos requisitos de qualidade e desempenho estabelecidos no instrumento convocatório.

Decido pela APROVAÇÃO DO ÍTENS 61, 66, 68, 69, 74, 106, 114, 115, 118, 124 e 129, produtos atendem as necessidades solicitadas.

É o parecer.

Caxias Ma, 21 de Janeiro de 2025



Coordenador Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde

Eli Marcos Santana Farias
Coordenador Administrativo
Mat. 9598-2

PARECER TÉCNICO

Nº 018 / 2025

Para: Departamento de licitações e contratos

Assunto: Aquisição de equipamento e material permanente para atender as necessidades das unidades básicas de saúde de Caxias Maranhão.

EQUIPSUL COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE EQUIPAMENTOS A SAUDE EIRELI,
CNPJ 39.346.590/0001-44- PREGÃO ELETRÔNICO 053/2024

Analisamos a descrição do item 07 e 16.

FUNDAMENTAÇÃO E CONCLUSÃO

Avaliação técnica é uma alternativa de que dispõe o gestor público, para assegurar a qualidade, tendo como objetivo verificar a descrição do produto ofertado aos requisitos de qualidade e desempenho estabelecidos no instrumento convocatório.

Decido pela APROVAÇÃO DO ÍTENS 07 e 16 produtos atendem as necessidades solicitadas.

É o parecer.

Caxias Ma, 21 de Janeiro de 2025


Coordenador Administrativo
Secretaria Municipal de Saúde

Eli Marcos Santana Farias
Coordenador Administrativo
Mat. 9598-2

